

KÚPNA ZMLUVA

na „Nákup laboratórneho nábytku“

Číslo zmluvy kupujúceho
Číslo zmluvy predávajúceho

uzatváraná podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a § 56 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Kupujúci:

Obchodné meno: **Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV**
Adresa organizácie: Moyzesova 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Zastúpený: RNDr. Ľubor Košťál, CSc., riaditeľ
IČO: 00 586 960
DIČ: 2020686943
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK41 8180 0000 0070 0000 8514
Telefón: 02 4594 3052
Fax: 02 4594 3932

(ďalej len „Kupujúci“)

a

Predávajúci:

Obchodné meno: **ITES Vranov, s. r. o.**
Adresa: Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Topľou
Zastúpený: Ing. Michal Fedor, Slavomír Fedor, konatelia spoločnosti
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný v: Obchodnom registri OS Prešov, Odd. Sro, vložka č. 1365/P
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu: SK65 0900 0000 0001 0789 0672
IČO: 31680259
DIČ: 2020527817
IČ DPH: SK2020527817
Tel.: 057 4462139
e-mail: ites@ites.sk

(ďalej len „Predávajúci“)

(spolu označovaní ako „Zmluvné strany“)

Preambula

1. Táto kúpna zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

2. Kupujúci zabezpečil realizáciu procesu verejného obstarávania ako verejnú súťaž na dodanie tovaru pre predmet zákazky „Nákup laboratórneho nábytku“, v ktorej Predávajúci podal svoju ponuku.
3. Predávajúci bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač verejnej súťaže podľa bodu 2 tohto článku na dodávku tovaru, ktorý bol predmetom zákazky.

Čl. I Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je dodanie tovaru: laboratórneho nábytku. Predmet zmluvy je podrobne špecifikovaný v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu predmet kúpy v rozsahu uvedenom bode 1 tohto článku zmluvy.
3. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy spolu s potrebnou technickou dokumentáciou, vyhlásením o zhode resp. inými potrebnými certifikátmi, pravidlami bezpečného používania.
4. Predmetom zmluvy je aj záväzok Predávajúceho poskytnúť Kupujúcemu súvisiace služby, a to najmä dopravu predmetu kúpy na miesto dodania, inštaláciu predmetu kúpy, overenie funkčnosti, uvedenie do prevádzky, zabezpečenie skúšobnej prevádzky, validácie, zaškolenia obsluhujúceho personálu Kupujúceho, ako aj opravu a údržbu predmetu kúpy v rámci záručného servisu resp. ďalšiu nevyhnutnú podporu pre užívanie predmetu kúpy.
5. Predávajúci poskytuje záručnú dobu na predmet kúpy podľa Čl. V tejto zmluvy.
6. Predmet kúpy sa bude považovať za riadne dodaný po jeho úplnom dodaní a prevzatím Kupujúcim na základe preberacieho protokolu bez výhrad.
7. Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy po riadnom dodaní prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu podľa Čl. II tejto zmluvy.

Čl. II Kúpna cena

1. Kúpna cena za dodanie celého predmetu zákazky je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako pevná cena za dodanie predmetu kúpy podľa Čl. I bod 1 zmluvy a je stanovená vo výške:

Cena bez z DPH	98 250,00 EUR
DPH	19 650,00 EUR
Celková cena s DPH	117 900,00 EUR

2. Presná špecifikácia cien podľa jednotlivých výrobkov je uvedená v Prílohe č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
3. Všetky náklady na dodanie predmetu kúpy, vrátane dopravného, colných a iných poplatkov, nákladov na inštaláciu, zaškolenie a záručný servis sú zahrnuté v kúpnej cene podľa bodu 1 tohto článku.
4. Akákoľvek zmena ceny, napr. pri vzniku nepredvídateľných okolností, ako je zmena výšky zákonnej sadzby DPH, je možná iba na základe písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného oboma zmluvnými stranami, pričom dodatok musí obsahovať zdôvodnenie takejto zmeny ceny.

Čl. III Čas plnenia a miesto dodania, dodacie podmienky

1. Čas plnenia tejto zmluvy je stanovený na dobu dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v súlade s požadovanými technickými a funkčnými charakteristikami podľa ponuky Predávajúceho, v súlade s platnými právnymi predpismi, technickými normami a podmienkami tejto zmluvy. Miestom dodania je sídlo kupujúceho.
3. Presný termín dodania predmetu kúpy alebo jeho častí, t.j. jednotlivých výrobkov oznámi Predávajúci písomne alebo elektronicky Kupujúcemu najmenej 5 dní vopred.
4. Dodanie predmetu kúpy do miesta dodania bude potvrdené dodacím listom. Nebezpečenstvo vzniku škody na predmete dodania kúpy prechádza na Kupujúceho až momentom podpísania preberacieho protokolu, ibaže sa preukáže, že Predávajúci nemohol škodu zabrániť a škodu jednoznačne zavinil Kupujúci.
5. Kupujúci je pri podpise dodacieho listu povinný bez zbytočného odkladu písomne upozorniť Predávajúceho na zjavné porušenie balenia predmetu kúpy resp. jeho častí a na vady zrejmé už pri doručení tovaru.
6. Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť podmienky vhodné pre inštaláciu, odskúšanie a prevádzku predmetu kúpy podľa tzv. predinštalčných manuálov a písomných pokynov Predávajúceho, ktoré mu Predávajúci poskytne pri podpise tejto zmluvy.
7. Predávajúci po bezvadnej skúšobnej prevádzke zaškolí obsluhujúci personál Kupujúceho na bezpečné používanie výrobkov, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.
8. Deň protokolárneho preberania predmetu kúpy oznámi Predávajúci písomne alebo elektronicky Kupujúcemu, a to najneskôr 3 dni vopred. Predávajúci je povinný sa protokolárneho preberania predmetu kúpy zúčastniť. Kupujúci je oprávnený neprevziať ktorúkoľvek časť predmetu kúpy, alebo celý predmet kúpy pokiaľ ktorákoľvek časť predmetu kúpy, alebo celý predmet kúpy nebude spĺňať technické a/alebo funkčné charakteristiky uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
9. Po prevzatí predmetu kúpy alebo jeho častí vystaví Kupujúci preberací protokol, ktorý Kupujúci podpíše. V prípade odmietnutia prevzatia predmetu kúpy alebo jeho častí vystaví Kupujúci protokol o odmietnutí prevzatia. Preberací protokol a protokol o odmietnutí prevzatia môžu byť súčasťou jedného dokumentu. Predávajúci je povinný podpísať Kupujúcim podpísaný preberací protokol ako aj Kupujúcim podpísaný protokol o odmietnutí prevzatia a jedno vyhotovenie takéhoto protokolu prevziať. V prípade ak Predávajúci nesplní ktorúkoľvek z povinností uvedených v prechádzajúcej vete preberací protokol ako aj protokol o odmietnutí prevzatia nadobudnú právne účinky dňom ich podpisu Kupujúcim.
10. V prípade výhrad k jednotlivým prevzatým častiam predmetu kúpy Kupujúci uvedie tieto výhrady do preberacieho protokolu, vrátane návrhu na odstránenie väd. V protokole o odmietnutí prevzatia Kupujúci uvedie časti predmetu kúpy, ktoré odmietol prevziať spolu s dôvodmi tohto odmietnutia.
11. Predávajúci je povinný odstrániť v preberacom protokole uvedené vady Kupujúcim prevzatého predmetu kúpy alebo jeho častí ako aj dodať Kupujúcemu v súlade s touto zmluvou predmet kúpy alebo jeho časť, ktoré Kupujúci odmietol prevziať, do 10 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu, resp. protokolu o odmietnutí prevzatia Kupujúcim, pokiaľ Kupujúci v preberacom protokole, resp. v protokole o odmietnutí prevzatia výslovne neuvedie dlhšiu lehotu. V prípade, že Predávajúci riadne a včas nesplní ktorúkoľvek povinnosť podľa predchádzajúcej vety dopustí sa podstatného porušenia zmluvy v dôsledku čoho vznikne Kupujúcemu právo odstúpiť od tejto zmluvy alebo jej časti. Kupujúcemu v takom prípade vznikne aj nárok na zmluvnú pokutu podľa čl. VII bod 3 tejto zmluvy.

12. Zmluvné strany sa dohodli na možnosti realizácie dodávok predmetu kúpy a fakturácii aj po častiach, t.j. po dodaní jednotlivých výrobkov aj osobitne.
13. V prípade ak Predávajúci bude opakovane dodávať (zo strany Kupujúceho pôvodne odmietnutý) predmet kúpy alebo jeho časť, budú platiť ustanovenia bodov 4 až 10 tohto článku tejto zmluvy obdobne. Ak v takomto prípade nastane dôvod na odstúpenie od zmluvy alebo jej časti zo strany Kupujúceho podľa bodu 11 tohto článku tejto zmluvy a Kupujúci toto svoje právo nevyužije, je Kupujúci oprávnený stanoviť opakovanú lehotu na odstránenie nedostatkov, resp. na dodanie tovaru podľa bodu 11 tohto článku tejto zmluvy. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho na zmluvnú pokutu podľa čl. VII bod 3 tejto zmluvy. Bod 11 tohto článku tejto zmluvy platí v takom prípade následne obdobne.
14. V prípade ak Predávajúci bude odstraňovať vady predmetu kúpy alebo jeho časti uvedené v preberacom protokole je povinný písomne informovať Kupujúceho o odstránení vád. Kupujúci následne vyhotoví dodatok k preberaciemu protokolu, v ktorom uvedie či vytýkané vady boli odstránené alebo nie. Čl. III bod 9 veta štvrtá a piata tejto zmluvy platia obdobne. V prípade ak vady nebudú čo i len čiastočne odstránené a Kupujúci neodstúpi od tejto zmluvy alebo jej časti je Kupujúci oprávnený v dodatku k preberaciemu protokolu poskytnúť Predávajúcemu dodatočnú lehotu na odstránenie vád v trvaní najmenej 5 dní. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho na zmluvnú pokutu podľa čl. VII bod 3 tejto zmluvy. Neodstránenie vád Predávajúcim v dodatočnej lehote bude znamenať podstatné porušenie zmluvy.
15. Preberací protokol bez výhrad podľa bodu 9 tohto článku zmluvy, resp. preberací protokol s výhradami k predmetu kúpy alebo jeho časti s dodatkom o odstránení všetkých vytýkaných vád predmetu kúpy alebo jeho časti podľa bodu 14 tohto článku tejto zmluvy bude prílohou faktúry Predávajúceho za predmet zákazky resp. jeho časti.

Čl. IV

Platobné a fakturačné podmienky

1. Predávajúcemu zaplatí Kupujúci kúpnu cenu v zmysle Čl. II tejto zmluvy bezhotovostným prevodom na jeho účet na základe doručenej faktúry vystavenej v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Prílohou faktúry musí byť dodací list a preberací protokol bez výhrad k preberanému predmetu kúpy alebo jeho časti alebo preberací protokol s výhradami k predmetu kúpy alebo jeho časti s dodatkom o odstránení všetkých vytýkaných vád predmetu kúpy alebo jeho časti podpísaný oboma zmluvnými stranami.
2. Predávajúci nemá nárok na uhradenie preddavku.
3. Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa preukázateľného doručenia riadne vystavenej faktúry s dohodnutými prílohami Kupujúcemu. Pre spôsob fakturácie môže Kupujúci vyhotoviť pre Predávajúceho usmernenie, ktoré bude pre neho záväzné a bude tvoriť prílohu k tejto zmluve.
4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátane označenia čísla tejto kúpnej zmluvy podľa evidencie Kupujúceho a názov predmetu kúpy podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe 1 projektu.

5. Kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť faktúru v lehote splatnosti, ak táto nemá náležitosti uvedené v bode 4 tohto článku, resp. ak k nej nebudú pripojené dohodnuté prílohy a to bez jej uhradenia a bez následkov z omeškania. Nová lehota splatnosti začne plynúť po preukázateľnom doručení opravenej faktúry Kupujúcemu.
6. Faktúru je potrebné doručiť osobne alebo poslať doručenou poštovou zásielkou Kupujúcemu.

Čl. V

Záručná doba, servis a zodpovednosť za vady

1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpy podľa Čl. 1 tejto zmluvy má v čase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, a že nemá vady, ktoré by znížovali jeho hodnotu alebo schopnosť jeho využitia.
2. Predávajúci poskytuje záručnú dobu 24 mesiacov na predmet kúpy. Záručná doba začína plynúť odo dňa podpísania preberacieho protokolu bez výhrad k predmetu kúpy alebo jeho časti, resp. dodatku k preberaciemu protokolu o odstránení všetkých vytykaných väd predmetu kúpy alebo jeho časti Kupujúcim. Záručná doba sa pritom nevzťahuje na náhradné diely, ak je ich doba použiteľnosti kratšia ako záručná doba (napr. tesnenia, lampy, piesty, membrány).
3. Predávajúci je počas záručnej doby povinný poskytovať bezplatný servis dodaného predmetu kúpy, údržbu a opravy. Osobitne počas záručnej doby bude Predávajúci poskytovať telefonické, e- mailové a osobné konzultácie k prevádzke výrobkov.
4. Predávajúci sa zaväzuje v prípade vady jednotlivých častí predmetu kúpy zabezpečiť ich opravu do 7 pracovných dní odo dňa oznámenia vady. V prípade, že danú vadu nie je možné odstrániť do stanoveného termínu (napr. z dôvodu nevyhnutného dodania náhradného dielu a pod.) dohodnú zmluvné strany písomne náhradný termín alebo iný postup pri riešení odstránenia zistenej vady.
5. Ak Predávajúci poruší ustanovenia tejto zmluvy spojené s odstránením vady predmetu kúpy, Kupujúcemu vzniká nárok na náhradu škody, ktorá mu v dôsledku takéhoto konania vznikla v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
6. Záručná doba sa predlžuje o dobu poruchy a jej opravy v tomto období.
7. V prípade vady predmetu kúpy počas jeho záručnej doby má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie väd a Predávajúci povinnosť vady odstrániť na vlastné náklady. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli poškodením predmetu kúpy z dôvodov nesprávneho zaobchádzania s predmetom kúpy Kupujúcim.
8. Kupujúci sa zaväzuje vady predmetu počas záručnej doby bez zbytočného odkladu, ihneď po zistení vady, písomne oznámiť Predávajúcemu.
9. Kupujúci je oprávnený od Predávajúceho po oznámení vady predmetu kúpy požadovať najmä:
 - a) odstránenie väd predmetu kúpy, ak sú odstrániteľné
 - b) dodanie a výmenu časti s vadou
 - c) výmenu chybného predmetu kúpy za rovnaký bez väd

Čl. VI Ostatné dojednania

1. Predávajúci vyhlasuje, že predmet kúpy nie je zaťažený právami tretích osôb, Predávajúci je výlučným vlastníkom predmetu kúpy a je oprávnený dodať predmet kúpy v súlade s touto zmluvou.
2. Predávajúci je povinný:
 - a) dodať predmet zmluvy Kupujúcemu v dohodnutom množstve, rozsahu, kvalite, v požadovaných technických parametroch, v bezchybnom stave a v dohodnutom termíne,
 - b) pred odovzdaním predmetov zmluvy zabezpečiť vykonanie predpredajného servisu, zabezpečiť ich inštaláciu, inštruktaž obsluhy a predviesť funkčnosť,
 - c) strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom a službami oprávnenými osobami. Oprávnenými osobami sú:
 - i. Najvyšší kontrolný úrad SR,
 - ii. príslušná Správa finančnej kontroly a
 - iii. Certifikačný orgán a ním poverené osoby.
3. Predávajúci sa zaväzuje pri realizácii inštalácie a skúšobnej prevádzky výrobkov Kupujúceho dodržiavať predpisy o ochrane pred požiarom, ako aj predpisy v oblasti bezpečnosti práce a iné bezpečnostné predpisy Kupujúceho, s ktorými bol oboznámený.
4. Údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v súlade s § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uvádza Predávajúci v Prílohe č. 3 Zmluvy.
5. Predávajúci je povinný Kupujúcemu písomne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, zmenu subdodávateľa. Predávajúci je povinný Kupujúcemu písomne oznámiť aj údaje o navrhovanom novom subdodávateľovi (vrátane informácie o jeho zástupcovi) a súvisiace informácie o predmete plnenia navrhovaného subdodávateľa tak ako sú požadované v Prílohe č. 3 Zmluvy.
6. Navrhovaný nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Predávajúci je povinný k písomnému oznámeniu o navrhovanom novom subdodávateľovi pripojiť dôkazy o splnení všetkých podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia. Oprávnenie dodávať tovar sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.
7. Predávajúci je oprávnený plniť túto zmluvu alebo jej časť ním navrhnutým novým subdodávateľom ak ho Kupujúci písomne schválil. V prípade, že Kupujúci do 21 dní odo dňa, v ktorom obdrží od Predávajúceho všetky údaje o navrhovanom novom subdodávateľovi podľa bodu 5 tohto článku tejto zmluvy so všetkými potrebnými podkladmi podľa bodu 6 tohto článku tejto zmluvy, písomne Predávajúcemu neoznámí či schvaľuje alebo zamietla návrh nového subdodávateľa platí, že nového subdodávateľa schvaľil.
8. Predávajúci nemá nárok na schválenie nového subdodávateľa Kupujúcim. Ak Kupujúci zamietne návrh na nového subdodávateľa je Predávajúci povinný zmluvu plniť pôvodným subdodávateľom alebo sám. Proces schvaľovania subdodávateľa nemá vplyv na plynutie lehôt podľa tejto zmluvy.
9. Ustanovenia ods. 5 až 8 tohto článku tejto zmluvy platia aj v prípade ak v čase účinnosti tejto zmluvy Predávajúci v prílohe č. 3 neuviedol žiadneho subdodávateľa.

Čl. VII

Sankcie a trvanie zmluvy

1. Nárok na zmluvné sankcie a úrok z omeškania nevzniká, ak dôvodom porušenia povinností zmluvných strán bolo pôsobenie vyššej moci alebo omeškanie nebolo možné zmluvnou stranou žiadnym spôsobom ovplyvniť.
2. V prípade omeškania Predávajúceho s riadnym dodaním akejkoľvek časti celého predmetu kúpy Kupujúcemu v lehote do 7 dní je Kupujúci oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,25 % z ceny časti v predmetu kúpy, s ktorého dodaním je Predávajúci v omeškaní, a to za každý deň omeškania. Tým nie je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu škody. Kupujúci je v takom prípade oprávnený požadovať náhradu škody aj vo výške prevyšujúcej zmluvnú pokutu.
3. V prípade, ak Predávajúci nedodá predmet kúpy resp. jeho časť v súlade s touto zmluvou ani v náhradnej lehote (čl. III bod 11 tejto zmluvy) je Kupujúci oprávnený požadovať od Predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 60 % ceny (bez DPH) hnuťelnej veci, resp. hnuťelných vecí, ktoré Predávajúci riadne nedodal, resp. neodstránil a nich vady ani v náhradnej lehote. Tým nie je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu škody. Kupujúci je v takom prípade oprávnený požadovať náhradu škody aj vo výške prevyšujúcej zmluvnú pokutu.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu alebo jej časť je možné ukončiť:
 - na základe vzájomnej dohody zmluvných strán
 - okamžitým odstúpením od zmluvy alebo jej časti:
 - a) v prípade podstatného porušenia zmluvy
 - b) v prípade ak nastane niektorá z okolností predvídaných v § 19 zákona o verejnom obstarávaní,
 - výpoveďou zmluvy alebo jej časti Kupujúcim.
5. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomného uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane. Podstatným porušením zmluvy je najmä nedodanie predmetu kúpy resp. jeho časti v súlade s touto zmluvou ani v písomne určenej náhradnej lehote, opakované nedodržanie spôsobu fakturácie Predávajúcim, neposkytnutie záručného servisu, omeškanie Kupujúceho s úhradou faktúry o viac ako 30 dní.
6. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
7. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme výpovede zo zmluvy. Túto zmluvu alebo jej časť je oprávnený vypovedať výlučne Kupujúci, a to do 30 dní odo dňa účinnosti zmluvy. Kupujúci vo výpovedi uvedie či sa týka celej zmluvy alebo iba jej časti. Ak sa výpoveď týka iba časti zmluvy Kupujúci vo výpovedi uvedie, ktorých konkrétnych hnuťelných vecí (výrobkov) sa výpoveď týka. Doručením výpovede Predávajúcemu táto zmluva v Kupujúcim stanovenom rozsahu zaniká, čo znamená, že Predávajúcemu v rozsahu, v ktorom bola táto zmluva vypovedaná, zanikne nárok na zaplatenie kúpnej ceny ako aj jeho povinnosť dodať v tomto rozsahu Kupujúcemu tovar.
8. Zmluvné strany sa dohodli na dodržiavaní mlčanlivosti o informáciách, ktoré tvoria obchodné tajomstvo zmluvných strán, alebo majú byť inak chránené pre tretími osobami.

Čl. VIII

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva vzniká dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

2. Táto zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci pracovný deň po jej zverejnení v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
3. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov odsúhlasených a podpísaných oboma zmluvnými stranami a to iba v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
4. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých dva obdrží Predávajúci a štyri Kupujúci.
5. Strany sa zaväzujú riešiť prípadné sporné situácie predovšetkým zmierne. V prípade, že nedôjde k dohode zmluvných strán môže sa ktorákoľvek zo strán obrátiť na príslušný všeobecný súd.
6. Strany zmluvy budú navzájom komunikovať písomne pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak. Doručovanie písomností sa vykonáva na adresy zmluvných strán uvedené záhlaví tejto zmluvy. Pokiaľ nie je možné doručiť písomnosť na takúto adresu a ak zmluvná strana písomne neoznámila druhej zmluvnej strane korešpondenčnú, resp. doručovaciu adresu odlišnú od adresy uvedenej v tejto zmluve, písomnosť sa považuje za riadne doručenú prevzatím druhou zmluvnou stranou, odmietnutím písomnosť prevziať alebo uplynutím lehoty 5 dní od odoslania písomnosti, a to tým momentom, ktorý nastane ako prvý. Výpoveď prípadne odstúpenie od zmluvy sa vykonáva zásadne osobným doručením prípadne doporučenou poštovou zásielkou.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť svoju pohľadávku z tejto zmluvy na tretiu osobu bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
8. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia slovenským právom a to ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a jej obsahom súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Ivanke pri Dunaji dňa 30.12.2016

[Redacted signature]

Za Kupujúceho

RNDr. Ľubor Košťál, CSc.
riaditeľ UBGŽ SAV

[Redacted signature]

Vo Vranove nad Topľou dňa 30.12.2016

[Redacted signature]

Za Predávajúceho

Ing. Michal Fedor Slavomír Fedor
konatelia spoločnosti

[Redacted signature]

Prílohy: Príloha č. 1 – Technická špecifikácia predmetu kúpy
Príloha č. 2 – Položkový rozpočet predložený Predávajúcim vo verejnom obstarávaní,
ktorý vychádza z výsledkov elektronickej aukcie
Príloha č. 3 – Údaje o všetkých známych subdodávateľoch

Príloha č. 1 Technická špecifikácia predmetu kúpy

Predmetom zákazky je laboratórny nábytok, pričom tento zahŕňa dodanie a montáž nasledovných výrobkov, ktorých opis uvádzame.

Technický opis predmetu obstarávania obsahuje všeobecné technické parametre výrobkov a ostatné technické parametre výrobkov. Ostatné technické parametre výrobkov sú detailne rozpísané pri každom jednotlivom výrobku. Pokiaľ je niektorý technický parameter výrobkov uvedený medzi všeobecnými technickými parametrami výrobkov a súčasne aj medzi ostatnými technickými parametrami výrobkov pri danom výrobku, platný je technický parameter výrobkov uvedený medzi ostatnými technickými parametrami pri danom výrobku.

Technický opis predmetu obstarávania obsahuje minimálne požiadavky verejného obstarávateľa, sú pre dodávateľa záväzné a sú nasledovné:

A) Všeobecné technické parametre:

Technický opis predmetu obstarávania:

V tejto časti sú uvedené všeobecné parametre laboratórneho nábytku. Ostatné technické parametre sú detailne rozpísané pri každom jednotlivom výrobku.

Laboratórne pracovné stoly musia mať certifikát podľa EN 13150. Úložné skrine a skrinky musia mať certifikát podľa normy EN 14727 a EN 14056.

Všetky drevené časti nábytku ako sú korpusy skriniek, dvierka, police, zásuvky a pod. sú vyrobené z drevotrieskovej dosky hrúbky min. 18 mm, obojstranne pokrytej vrstvou lamina.

Všetky kontaktné hrany korpusov skriniek, dvierok a políc sú chránené ABS hranou hrúbky 2 mm. Z dôvodu zvýšenia odolnosti voči vlhkosti ABS hrany budú aplikované technológiou inou ako lepením napr. natavením laserovou technológiou.

Úchytky na dvierkach a na zásuvkách všetkých skriniek sú kovové.

Pracovné dosky z kompaktného vysokotlakého laminátu (HPL), ktorý spĺňa normu EN 438. HPL musí byť v monolitckej hrúbke 16mm alebo hrúbke min. 5mm s kombináciou DTD minimálne hrúbky 18mm. Pracovné dosky z HPL musia byť určené pre laboratórne aplikácie (napr. TrespaTopLAB⁺, FunderMAX Resistance² resp. iné, ktoré sú určené pre použitie v laboratóriách).

Pracovné dosky POSTFORMING sú dosky na báze drevotriesky, ktorá je povrchovo upravená vrstvou vysokotlakého laminátu (HPL). Hrúbka pracovnej dosky POSTFORMING musí byť minimálne 38mm, pričom hrúbka HPL vrstvy musí byť minimálne 0,6mm.

Kovové podstavy majú tvar „C“ alebo „H“ a sú zhotovené z jaskľových profilov, ktorých minimálne parametre sú 60x20x2 mm.

Dvierka všetkých skriniek majú kvalitné dverové závesy, každý záves s tlmením (typ BLUM, HETTICH, HÄFELE alebo ich ekvivalent).

Závesy na inštalačných skrinkách a skrinkách pod digestormi sú otvárateľné na 170 stupňov, čím sa zabráňuje ich vylomeniu.

Všetky inštalačné skrinky majú polypropylénové dno vo vaničkovom prevedení alebo ekvivalentnom s bezpečnostným prepacom na podlahu, aby sa zabránilo náhodnému vylitiu tekutín na dno skrinky a tým jej poškodeniu.

Všetky spodné skrinky majú nožičky s nastaviteľnou výškou 150 mm podľa požiadaviek normy EN 13150.

Skrinky v kontajnerovom prevedení sú na kovových alebo plastových kolieskach s pogumovaním, 2 kolieska sú vybavené brzdou.

Použité elektroinštalačné prvky – zásuvky, vypínače, prúdové chrániče musia byť s ochranou minimálne IP 44.

Všetky elektrické zásuvky sú samozhášavé, z odolného, prach odpudivého termoplastu.

B) Ostatné technické parametre:

Ostatné technické parametre sú špecifickými parametrami pre jednotlivý výrobok označený poradovým číslom výrobku, rozmermi, požadovaným počtom a jeho umiestnením v miestnosti na mieste dodania predmetu zákazky.

Rozmery (šírka, hĺbka a výška) laboratórnych a pracovných stolov sú záväzné. V rozmeroch skriniek, skriň, drezov (okrem šírky jednodrezov veľkých nerezových), atď. je prípustná tolerancia 5%.

Miestnosť č. 1.05

1/ Laboratórny digestor (odsávací box)

1200x900x2350 mm

1 ks

S certifikátom podľa EN 14175. Kovová nosná konštrukcia digestora zabezpečuje pevnosť digestora. Vnútrotný korpus digestora steny, zadný chrbát a strop sú zhotovené z kompaktného vysokotlakového laminátu (HPL). Rám čelnej clony je vybavený samočinnou bezpečnostnou poistkou, ktorá zabráňuje samovoľnému pádu rámu a tak možnému ohrozeniu obsluhy. Rám má výplň z bezpečnostného 2 vrstvového skla. Posuv rámu je vertikálny. Manuálne ovládaný rám je vybavený samočinnou bezpečnostnou poistkou, ktorá slúži k tomu, aby v prípade napr. pretrhnutia vodiacich elementov nedošlo k pádu rámu a tým k ohrozeniu zdravia obsluhy. Elektrické zásuvky majú ochranu IP 55. Pracovná doska digestora je vyrobená z HPL. Pracovná doska je fixne uchytená na kovovej podstave. Súčasťou je aj kovová výstuha pracovnej dosky, ktorá umožňuje postaviť do digestora aj ťažké prístroje

Minimálne rozmery vnútornej komory digestora:

- 1 000 mm (šírka) x 750 mm (hĺbka) x 1 000 mm (výška).

Výbava digestora:


- 1 x pracovná doska podľa vyššie uvedeného popisu so zvýšeným okrajom,
- 1 x rám čelnej clony s 2 vrstvovým bezpečnostným sklom a samočinnou bezpečnostnou poistkou,
- min. 2 x elektrická zásuvka 230 V, IP 55,
- 2 x žiarivkové trubicové osvetlenie 1 300 lumen/ks, kryté 2 vrstvovým bezpečnostným sklom hrúbky 4 mm,
- 1 x vypínač osvetlenia,
- 1 x prúdový chránič 16 A/30 mS,
- 1 x signalizácia výšky zdvihu čelnej clony v zmysle požiadaviek EN 14175,
- 1 x signalizácia rýchlosti prúdenia odsávaného vzduchu s vizuálnou indikáciou dostatočnej rýchlosti prúdenia odsávaného vzduchu,
- 1 x signalizácia rýchlosti prúdenia odsávaného vzduchu s vizuálnou indikáciou nedostatočnej rýchlosti prúdenia odsávaného vzduchu,
- 1 x signalizácia rýchlosti prúdenia odsávaného vzduchu s akustickou indikáciou nedostatočnej rýchlosti prúdenia odsávaného vzduchu s možnosťou vypnutia,
- 1 x predpríprava na pripojenie digestora na odsávacie potrubie.
- samostatný odťahový ventilátor, regulácia rýchlosti prúdenia odsávaného vzduchu, dĺžka potrubia 17 900 mm, priemer potrubia 315 mm, počet ohybov 4
- spodná skrinka pre kyseliny a lúhy s dvierkami

2/ Laboratórny stôl jednostranný

3600x750x900 mm

1ks

Pracovný stôl laboratórny jednostranný je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola POSTFORMING podľa technickej špecifikácie vyššie. Skrinky pod pracovnou doskou sú fixne spojené s pracovnou doskou. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava skriniek: **1x skrinka 4-zásuvková š. 600 mm pod laboratórny stôl** hlboký 750 mm a vysoký 900 mm, **1x podvesná plnovýsuvná zásuvka** pod pracovnou doskou š. 600 mm, **1x skrinka dverová s polohovateľnou policou š. 600 mm** pod laboratórny stôl hlboký 750 mm a vysoký 900 mm, **2x skrinka 4-zásuvková š. 450 mm** pod laboratórny stôl hlboký 750 mm a vysoký 900 mm, **1x skrinka 2-dverová s polohovateľnou policou š. 900 mm** pod laboratórny stôl hlboký 750 mm a vysoký 900 mm, **1x skrinka závesná 2-dverová presklená 1200x340x900mm**, **1x skrinka závesná dverová presklená 600x340x900mm**, **1 x skrinka závesná 2-dverová presklená 900x340x900mm**. Všetky spodné skrinky majú kovové alebo plastové nožičky s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností. Všetky závesné skrinky presklenené majú 2-vrstvové bezpečnostné sklo v ráme a 2 polohovateľné police.

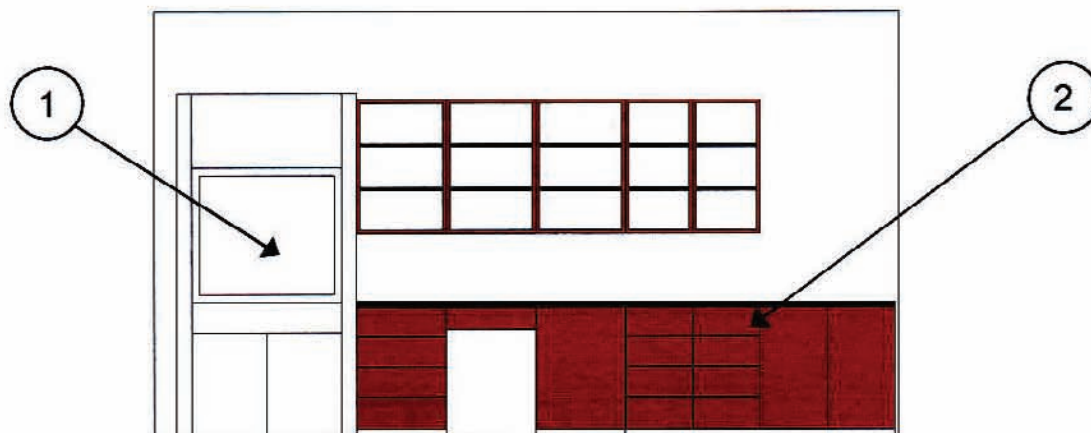


3/ Laboratórny stôl obojstranný mokrý

3600x1500x900 mm


1ks

Pracovný stôl laboratórny obojstranný je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola je z HPL, podľa technickej špecifikácie vyššie. Skrinky pod pracovnou doskou sú fixne spojené s pracovnou doskou. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava skriniek: **6x skrinka zásuvková š. 600 mm pod laboratórny stôl** hlboký 750 mm a vysoký 900 mm, **4 x podvesná plnovýsuvná zásuvka pod pracovnou doskou š. 600 mm**, **1x inštalačná skrinka pod drez š. 600 pod laboratórny stôl** hlboký 750 mm a vysoký 900 mm, **1x skrinka dverová s polohovateľnou policou š. 600** pod laboratórny stôl hlboký 750 mm a vysoký 900 mm. Inštalačná skrinka pod drez má ochranu dna prostredníctvom vyberateľnej vane, ktorá pokryje celé dno inštalačnej skrinky s výlevkou. Všetky spodné skrinky majú kovové alebo plastové nožičky s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností. Vo výbave stola je **1x polypropylénový drez** o rozmeroch napríklad 467x467x350 mm / 500x460x300 s ochranným prepacom vody proti pretečeniu. Drez je osadený do pracovnej dosky podľa technickej špecifikácie vyššie. Vo výbave stola je aj **1x zmiešavacia armatúra** na teplú a studenú vodu z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom. Súčasťou výbavy stola je **nadstavba**, ktorá pozostáva z 3 x mediálny stĺp a 2 x mediálna polica a zahŕňa: 12x elektrickú zásuvku 230V/IP 44 a 2x istič 16A. Mediálne stĺpy musia byť odolné voči vplyvu vody, vlhkosti. Hĺbka police min. 250 mm. Časti polic medzi mediálnymi stĺpmi majú kovovú výstuhu s povrchom upraveným technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. Povrch police je z vysokotlakového laminátu. Armatúry na vodu majú ventily, ktorých značenie zodpovedá norme EN 13792.

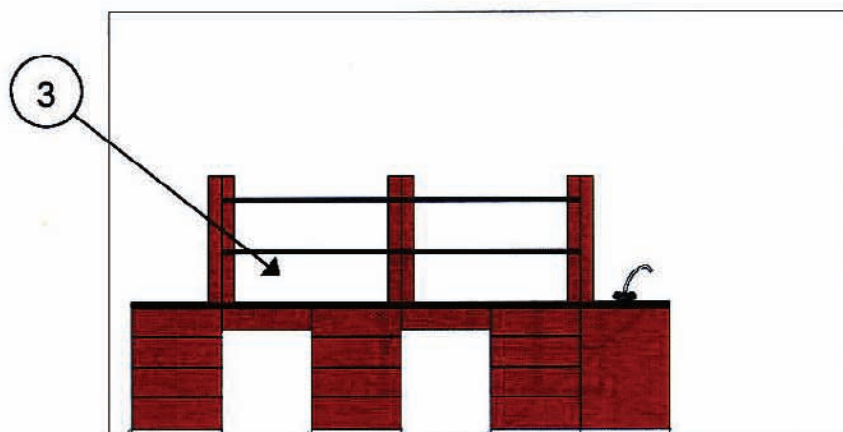


4/ Laboratórny stôl jednostranný**2700x750x900 mm****1ks**

Pracovný stôl laboratórny jednostranný je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola je z HPL, podľa technickej špecifikácie vyššie. Skrinky pod pracovnou doskou sú fixne spojené s pracovnou doskou. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava skriniek: **2x skrinka 4-zásuvková š. 450 mm pod laboratórny stôl** hlboký 750 mm a vysoký 900 mm, **2x podvesná plnovýsuvná zásuvka pod pracovnou doskou** š. 600 mm, **1x skrinka 4-zásuvková š. 600 mm** pod laboratórny stôl hlboký 750 mm a vysoký 900 mm, **1x skrinka závesná dverová presklená 450x340x900mm**, **1x skrinka závesná 2-dverová presklená 1200x340x900mm**. Všetky spodné skrinky majú kovové alebo plastové nožičky s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností. Všetky závesné skrinky presklené majú 2-vrstvové bezpečnostné sklo v ráme a 2 polohovateľné police.

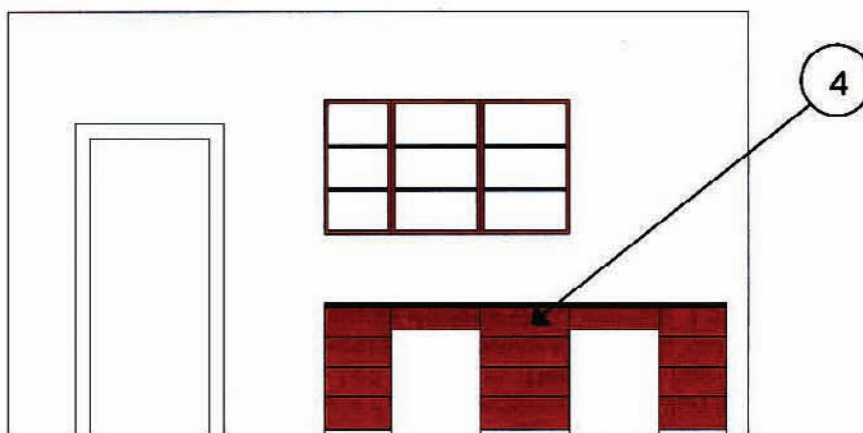**Miestnosť č. 1.06****5/ Laboratórny stôl jednostranný mokrý****1635x750x900 mm****1ks**

Pracovný stôl laboratórny jednostranný je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola je z HPL, podľa technickej špecifikácie vyššie. Skrinky pod pracovnou doskou sú fixne spojené s pracovnou doskou. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava skriniek: **1x skrinka 2-dverková š. 900 mm pod laboratórny stôl** hlboký 750 mm a vysoký 900 mm, **1x skrinka inštalačná pod drez š. 600 mm pod laboratórny stôl** hlboký 750 mm a vysoký 900 mm, **1x skrinka závesná 2-dverová presklená 900x340x900mm**, **1x skrinka závesná dverová presklená 600x340x900mm**. Všetky spodné skrinky majú kovové alebo plastové nožičky s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností. Všetky závesné skrinky presklené majú 2-vrstvové bezpečnostné sklo v ráme a 2 polohovateľné police. Vo výbave stola je **1x nerezový drez** o rozmeroch napríklad 400x400x300mm s ochranným prepacom vody proti pretečeniu. Vo výbave stola je aj **1x nástenná zmiešavacia armatúra chróm (150mm)** na teplú a studenú vodu.

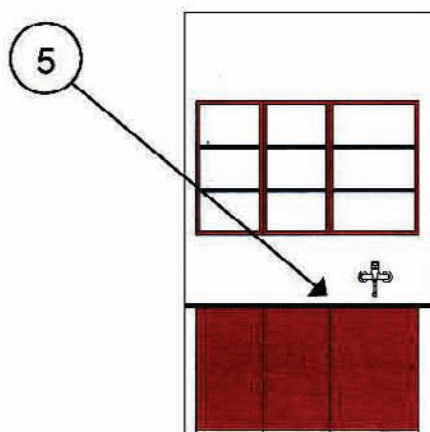


Miestnosť č. 1.07

6/ Zostava pracovných stolov laboratórnych prístrojových

1ks

Pracovné stoly laboratórne prístrojové sú certifikované podľa EN 13150. Pracovná doska stola je z HPL, podľa technickej špecifikácie vyššie. Zostava stolov: **2x laboratórny stôl mobilný** 1500x750x750. Pracovná doska je fixne uchytená na kovovej podnoži. Typ kovovej podnože „H“. Súčasťou je aj kovová výstuha pracovnej dosky a spodná výstuha. Kovová podstava je vybavená nožičkami s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností podlahy. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava skriniek: **2x skrinka kontajnerová zásuvková š. 450** pod laboratórny stôl s hĺbkou 750 mm výškou 750 mm, **1x skrinka závesná 2-dverová presklená** 900x340x900mm, **1x skrinka závesná 2-dverová presklená** 600x340x900mm. Všetky kontajnerové skrinky sú na kovových alebo plastových kolieskach s pogumovaním, 2 kolieska sú vybavené brzdou. Všetky závesné skrinky presklené majú 2-vrstvové bezpečnostné sklo v ráme a 2 polohovateľné police.

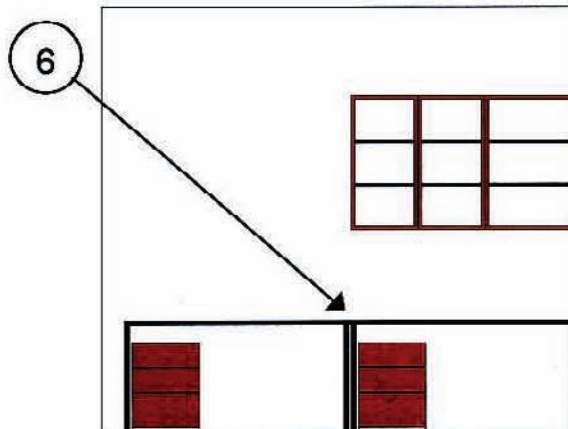

7/ Zostava pracovných stolov laboratórnych prístrojových

1ks

Pracovné stoly laboratórne prístrojové sú certifikované podľa EN 13150. Pracovná doska stola je z HPL, podľa technickej špecifikácie vyššie. Zostava stolov: **1x pracovný stôl laboratórny mobilný** 1500x750x750mm, **1x pracovný stôl laboratórny mobilný** 1200x750x750mm. Pracovná doska je fixne uchytená na kovovej podstavě. Tvar kovovej podstavy „H“. Súčasťou je aj kovová výstuha pracovnej dosky a spodná výstuha. Kovová podstava je vybavená nožičkami s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností podlahy. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava skriniek: **2x skrinka kontajnerová zásuvková š. 450** pod laboratórny stôl s hĺbkou 750 mm výškou 750 mm. Všetky kontajnerové skrinky sú na kovových alebo plastových kolieskach s pogumovaním, 2 kolieska sú vybavené brzdou. Úchytky na dvierkach a na zásuvkách všetkých skriniek sú kovové.


8/ Laminárny box

š. 1200 mm

1ks

Laminárny box certifikovaný podľa EN12469:2000. Pracovný box zabezpečujúci sterilné podmienky pre prácu s bunkami a kultúrami. Minimálne parametre:

- trieda bezpečnosti II.
- pracovná plocha min. 1100x500 mm, $\pm 5\%$ tolerancia,
- hlučnosť max. 55 dBA
- min. 99% účinnosť HEPA filtra pre častice väčšie ako 0,3 μm - UV svetlo
- el. zásuvka vo vnútri pracovného priestoru
- vybavený automatickou reguláciou rýchlosti prúdenia,
- bezšpárový plášť pre zabezpečenie ľahkého čistenia,
- konštrukcia ventilátorov musí zabezpečovať homogénny tlak nad filtrom,
- vybavený vnútorným osvetlením pracovnej plochy bez nebezpečenstva oslňovania,
- neperforovaná pracovná plocha, predné okno z netrieštivého skla s manuálnym posuvom,

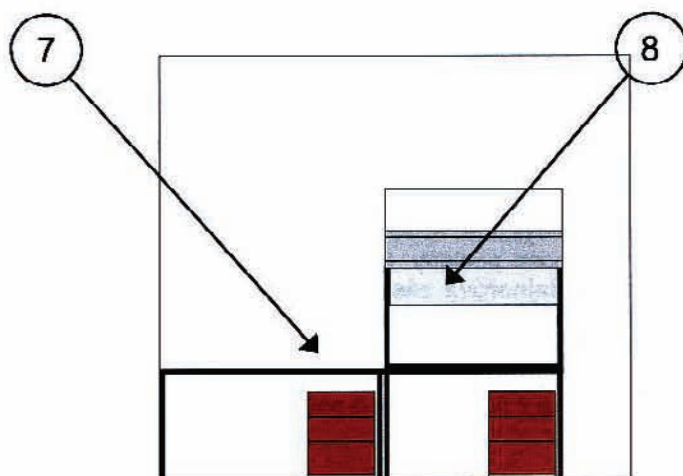


Miestnosť č. 1.08

9/ Laboratórny stôl jednostranný mokrý

1620x750x900 mm

1ks

Pracovný stôl laboratórny jednostranný je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola je z HPL, podľa technickej špecifikácie vyššie. Skrinky pod pracovnou doskou sú fixne spojené s pracovnou doskou. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava skriniek: **1x skrinka inštalácia pod drez š. 600 mm pod laboratórny stôl** hlboký 750 mm a vysoký 900 mm, **1x skrinka 2-dvierková š. 900 mm pod laboratórny stôl** hlboký 750 mm a vysoký 900 mm, **1x skrinka závesná dverová presklená** 600x340x900mm, **1x skrinka závesná 2-dverová presklená** 900x340x900mm. Všetky spodné skrinky majú kovové alebo plastové nožičky s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností. Všetky závesné skrinky presklené majú 2-vrstvové bezpečnostné sklo v ráme a 2 polohovateľné police. Vo výbave stola je **1x nerezový drez** o rozmeroch napríklad 400x400x300mm s ochranným prepacom vody proti pretečeniu. Vo výbave stola je aj **1x nástenná zmiešavacia armatúra** chróm (150mm) na teplú a studenú vodu.

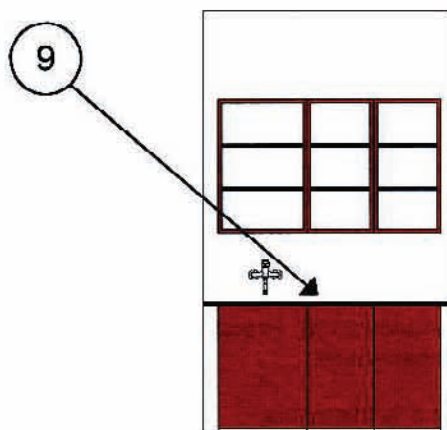

Miestnosť č. 1.09

10/ Zostava pracovných stolov laboratórnych prístrojových


1ks

Pracovné stoly laboratórne prístrojové sú certifikované podľa EN 13150. Pracovná doska stola je z HPL, podľa technickej špecifikácie vyššie. Zostava stolov: **2x laboratórny stôl mobilný** 1200x750x900. Pracovná doska je fixne uchytená na kovovej podnoži. Typ kovovej podnože „H“. Súčasťou je aj kovová výstuha pracovnej dosky a spodná výstuha. Kovová podstava je vybavená nožičkami s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností podlahy. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava skriniek: **2x skrinka kontajnerová zásuvková š. 450** pod laboratórny stôl s hĺbkou 750 mm výškou 900 mm, **1x skrinka závesná 2-dverová presklená** 1200x340x900mm. Všetky kontajnerové skrinky sú na kovových alebo plastových kolieskach s pogumovaním, 2 kolieska sú vybavené brzdou. Všetky závesné skrinky presklené majú 2-vrstvové bezpečnostné sklo v ráme a 2 polohovateľné police.


11/ Laminárny box**š. 1200 mm****1ks**

Laminárny box certifikovaný podľa EN12469:2000. Pracovný box zabezpečujúci sterilné podmienky pre prácu s bunkami a kultúrami. Minimálne parametre:

- trieda bezpečnosti II.
- pracovná plocha min. 1100x500 mm, $\pm 5\%$ tolerancia,
- hlučnosť max. 55 dBA
- min. 99% účinnosť HEPA filtra pre častice väčšie ako 0,3 μm - UV svetlo
- el. zásuvka vo vnútri pracovného priestoru
- vybavený automatickou reguláciou rýchlosti prúdenia,
- bezšpárový plášť pre zabezpečenie ľahkého čistenia,
- konštrukcia ventilátorov musí zabezpečovať homogénny tlak nad filtrom,
- vybavený vnútorným osvetlením pracovnej plochy bez nebezpečenstva oslňovania,
- neperforovaná pracovná plocha, predné okno z netrieštivého skla s manuálnym posuvom,

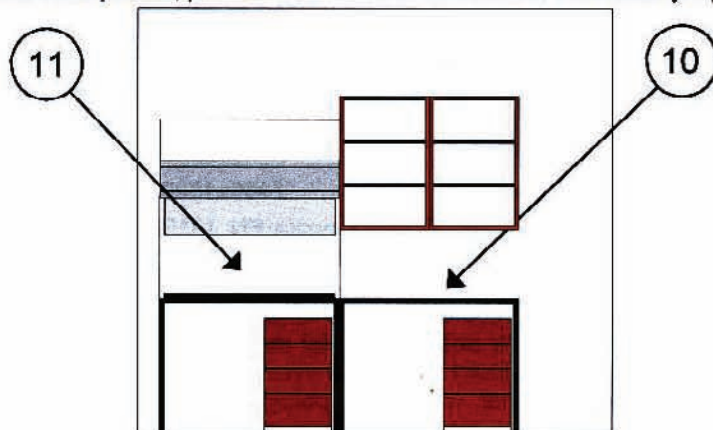
**12/ Pracovný stôl laboratórny prístrojový****1200x750x900 mm****1ks**

Pracovný stôl laboratórny prístrojový certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola je z HPL, podľa technickej špecifikácie vyššie. Zostava stolov: **1x laboratórny stôl mobilný 1200x750x900**. Pracovná doska je fixne uchytená na kovovej podnoži. Typ kovovej podnože „H“. Súčasťou je aj kovová výstuha pracovnej dosky a spodná výstuha. Kovová podstava je vybavená nožičkami s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností podlahy. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava skriniek: **1x skrinka kontajnerová zásuvková š. 450** pod laboratórny stôl s hĺbkou 750 mm výškou 750 mm. Všetky kontajnerové skrinky sú na kovových alebo plastových kolieskach s pogumovaním, 2 kolieska sú vybavené brzdou.

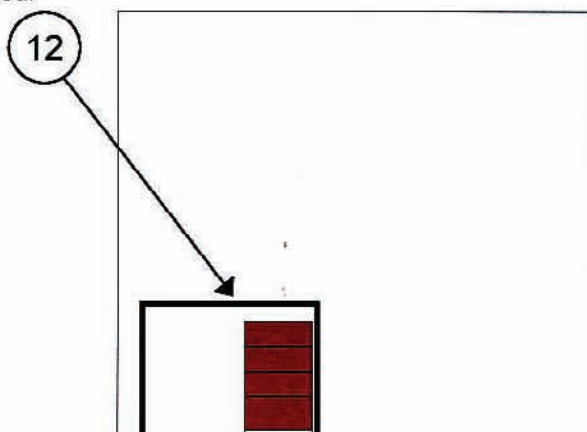**Miestnosť č. 1.10****13/ Laboratórny stôl jednostranný****3000x750x900 mm****1ks**

Pracovný stôl laboratórny jednostranný je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola POSTFORMING, podľa technickej špecifikácie vyššie. Skrinky pod pracovnou doskou sú fixne spojené s pracovnou doskou. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava skriniek: **2x skrinka dvierková š. 600 mm pod laboratórny stôl** hlboký 750 mm a vysoký 900 mm, **2x podvesná plnovýsuvná zásuvka pod pracovnou doskou š. 600 mm**, **1x skrinka 4-zásuvková š. 600 mm pod**

laboratórny stôl hlboký 750 mm a vysoký 900 mm, **1x skrinka závesná dverová presklená** 600x340x900mm, **1x skrinka závesná 2-dverová presklená** 1200x340x900mm. Všetky spodné skrinky majú kovové alebo plastové nožičky s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností. Všetky závesné skrinky presklené majú 2-vrstvové bezpečnostné sklo v ráme a 2 polohovateľné police.

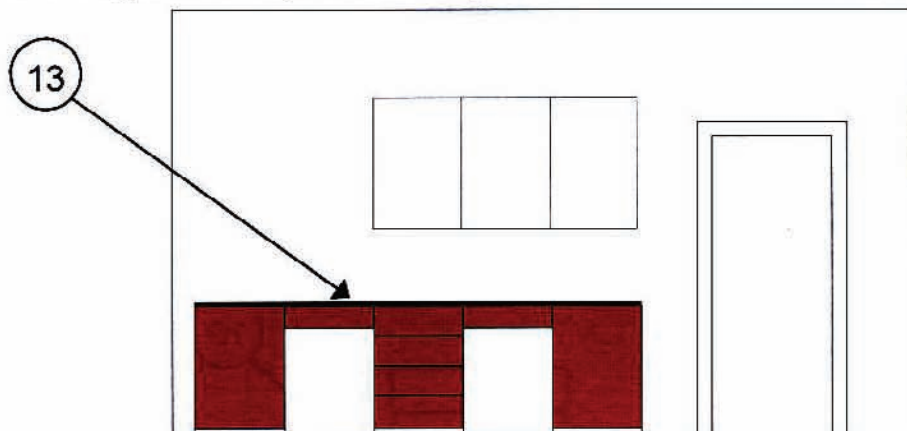


14/ Laboratórny stôl obojstranný mokrý

2400x1500x900 mm

1ks

Pracovný stôl laboratórny obojstranný je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola je z HPL, podľa technickej špecifikácie vyššie. Skrinky pod pracovnou doskou sú fixne spojené s pracovnou doskou. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava skriniek: **4x skrinka dverová s polohovateľnou policou š. 600** pod laboratórny stôl hlboký 750 mm a vysoký 900 mm; **2x skrinka zásuvková š. 600 mm** pod laboratórny stôl hlboký 750 mm a vysoký 900 mm, **2x inštalačná skrinka pod drez š. 600** pod laboratórny stôl hlboký 750 mm a vysoký 900 mm. Inštalačná skrinka pod drez má ochranu dna prostredníctvom vyberateľnej vane, ktorá pokryje celé dno inštalačnej skrinky s výlevkou. Všetky spodné skrinky majú kovové alebo plastové nožičky s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností. Vo výbave stola je **2x polypropylénový drez** o rozmeroch napríklad 467x467x350 mm / 500x460x300 s ochranným prepadom vody proti pretečeniu. Drez je osadený do pracovnej dosky podľa technickej špecifikácie vyššie. Vo výbave stola je aj **2x zmiešavacia armatúra na teplú a studenú vodu** z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom. Súčasťou výbavy stola je **nadstavba**, ktorá pozostáva z 3 x mediálny stĺp a 2 x mediálna polica a zahŕňa: 8x elektrickú zásuvku 230V/IP 44 a 2x istič 16A. Mediálne stĺpy musia byť odolné voči vplyvu vody, vlhkosti. Hĺbka police min. 250 mm. Časti políc medzi mediálnymi stĺpmi majú kovovú výstuhu s povrchom upraveným technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. Povrch police je z vysokotlakového laminátu. Armatúry na vodu majú ventily, ktorých značenie zodpovedá norme EN 13792.

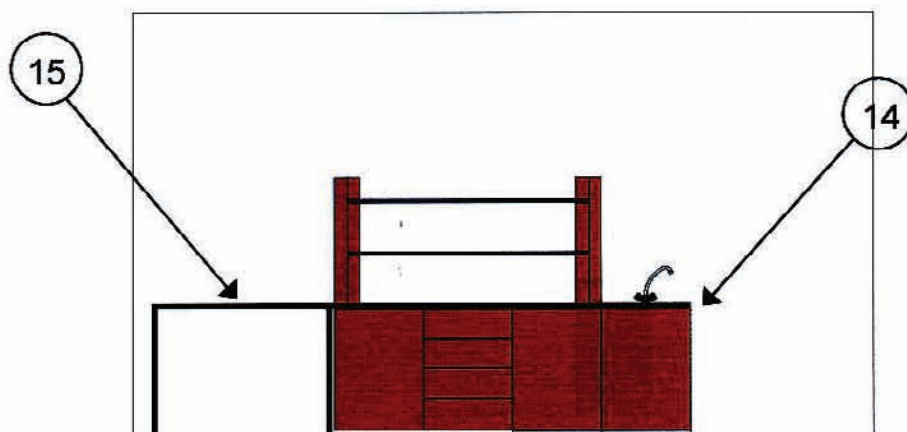


15/ Pracovný stôl laboratórny prístrojový**1200x750x900 mm****2ks**

Pracovný stôl laboratórny prístrojový certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola je z HPL, podľa technickej špecifikácie vyššie. Zostava stolov: **2x laboratórny stôl mobilný** 1500x750x900. Pracovná doska je fixne uchytená na kovovej podnoži. Typ kovovej podnože „H“. Súčasťou je aj kovová výstuha pracovnej dosky a spodná výstuha. Kovová podstava je vybavená nožičkami s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností podlahy.

16/ Zostava pracovných stolov laboratórnych prístrojových**1ks**


Pracovný stôl laboratórny prístrojový certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola POSTFORMING, podľa technickej špecifikácie vyššie. Zostava stolov: **2x laboratórny stôl mobilný** 1500x750x900. Pracovná doska je fixne uchytená na kovovej podstave. Typ kovovej podnože „H“. Kovová podstava je vybavená nožičkami s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností podlahy. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava skriniek: **2x skrinka kontajnerová zásuvková š. 450** pod laboratórny stôl s hĺbkou 750 mm výškou 900 mm. Všetky kontajnerové skrinky sú na kovových alebo plastových kolieskach s pogumovaním, 2 kolieska sú vybavené brzdou. Úchytky na zásuvkách všetkých skriniek sú kovové.

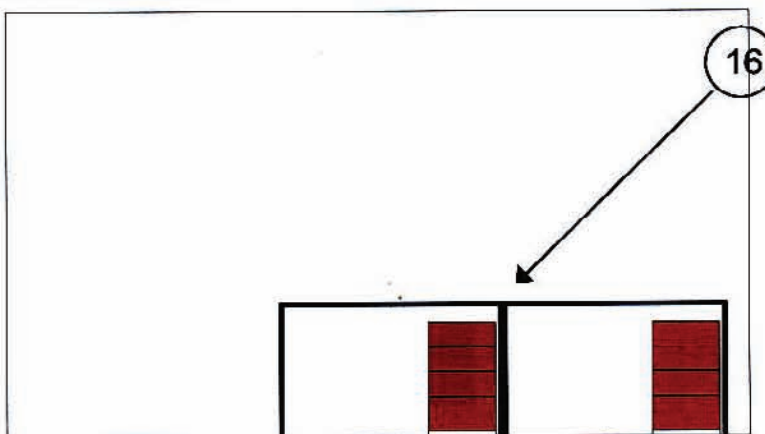**Miestnosť č. 1.14****17/ Pracovný stôl laboratórny****2965x750x900 mm****1ks**

Pracovný stôl laboratórny certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola je z HPL, podľa technickej špecifikácie vyššie. Pracovná doska je fixne uchytená na kovovej podstave. Typ kovovej podnože „H“. Súčasťou je aj kovová výstuha pracovnej dosky a spodná výstuha. Kovová podstava je vybavená nožičkami s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností podlahy. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava skriniek: **2x skrinka závesná otvorená** 1200x340x900 mm.

18/ Jednodrez veľký nerezový**1100x700x850 - hĺbka 400 mm****1ks**

Nerezový jednodrez s ochranným prepacom vody proti pretečeniu. Vo výbave stola je aj **1x nástenná zmiešavacia armatúra** chróm (150mm) na teplú a studenú vodu

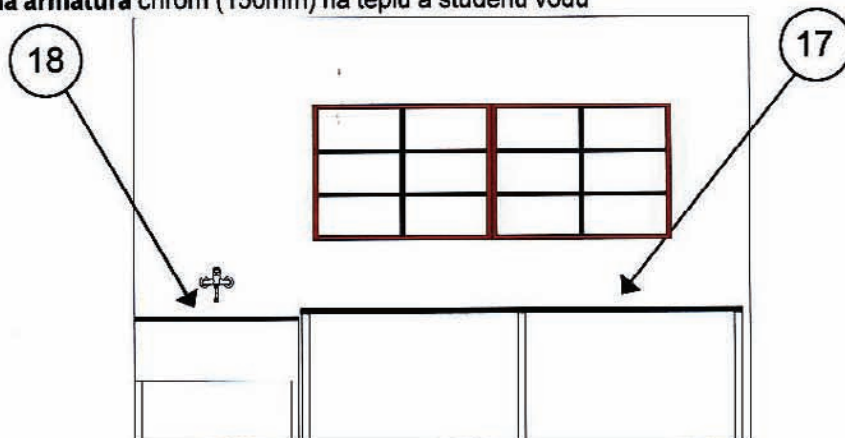


Miestnosť č. 1.18

19/ Laboratórny stôl jednostranný mokrý

3000x750x900 mm

1ks

Pracovný stôl laboratórny jednostranný je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola je z HPL, podľa technickej špecifikácie vyššie. Skrinky pod pracovnou doskou sú fixne spojené s pracovnou doskou. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava skriniek: **1x inštalačná skrinka pod drez š. 600 pod laboratórny stôl** hlboký 750 mm a vysoký 900 mm, **1x skrinka dverová s polohovateľnou policou š. 600** pod laboratórny stôl hlboký 750 mm a vysoký 900 mm; **1x skrinka zásuvková š. 600 mm** pod laboratórny stôl hlboký 750 mm a vysoký 900 mm, **2x skrinka závesná presklená 2-dverová 1200x340x900 mm**. Inštalačná skrinka pod drez má ochranu dna prostredníctvom vyberateľnej vane, ktorá pokryje celé dno inštalačnej skrinky s výlevkou. Všetky spodné skrinky majú kovové alebo plastové nožičky s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností. Všetky závesné skrinky presklené majú 2-vrstvové bezpečnostné sklo v ráme a 2 polohovateľné police. Vo výbave stola je **1x nerezový drez** o rozmeroch napríklad 400x400x300mm s ochranným prepacom vody proti pretečeniu. Vo výbave stola je aj **1x nástenná zmiešavacia armatúra** na teplú a studenú vodu (150 mm). Armatúry na vodu majú ventily, ktorých značenie zodpovedá norme EN 13792.

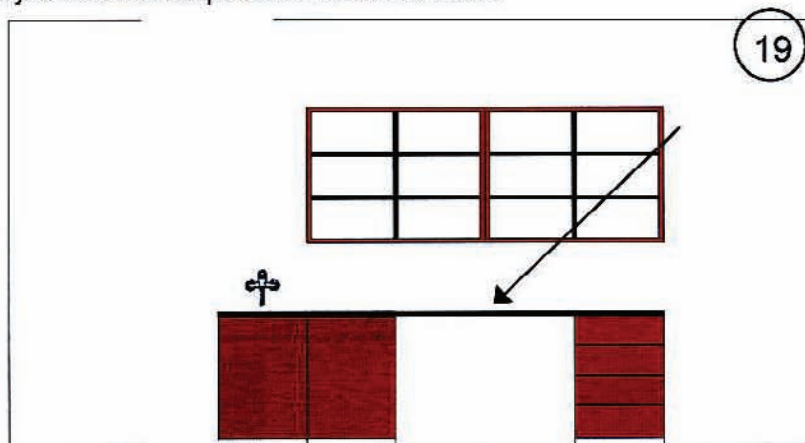

20/ Pracovný stôl nerezový

1200x700x850 mm

3ks

Pracovný stôl nerezový, bez lemu, s nerezovou podnožou „H“, stredový.




Miestnosť č. 1.34

21/ Zostava pracovných stolov laboratórnych prístrojových

1ks

Pracovné stoly laboratórne prístrojové sú certifikované podľa EN 13150. Pracovná doska stola je z HPL, podľa technickej špecifikácie vyššie. Zostava stolov: **2x laboratórny stôl mobilný 1500x750x750**, **2x laboratórny stôl mobilný 1200x750x750**. Pracovná doska je fixne uchytená na kovovej podstave. Typ

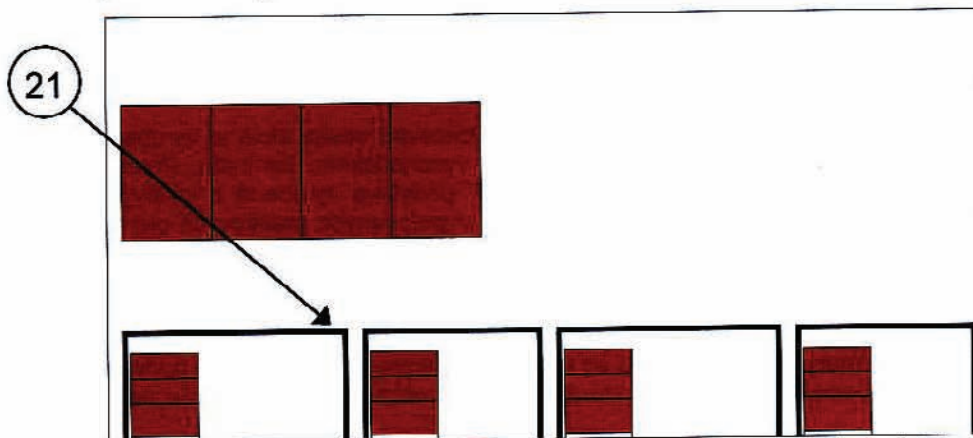

kovovej podnože „H“. Súčasťou je aj kovová výstuha pracovnej dosky a spodná výstuha. Kovová podstava je vybavená nožičkami s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností podlahy. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava skriniek: **4x skrinka kontajnerová zásuvková š. 450** pod laboratórny stôl s hĺbkou 750 mm výškou 750 mm, **2 x skrinka závesná 2-dverová 1200x340x900mm**. Všetky kontajnerové skrinky sú na kovových alebo plastových kolieskach s pogumovaním, 2 kolieska sú vybavené brzdou. Všetky závesné skrinky majú 2 polohovateľné police.

Miestnosť č. 1.35

22/ Skriňa bezpečnostná na horľaviny

1200x500x2000 mm

1ks

Skriňa s certifikátom podľa EN 14470-1 a DIN 12925-1, 90 minútová odolnosť voči požiaru. Konštrukcia skrine z elektro galvanizovanej ocele, vonkajší monolitický rám v kyselinovzdornom prevedení, nehorľavé bezpečnostné prvky. Vo výbave skrine je: 4x polica, 1x záchytné dno, 1x perforovaný kryt záchytného dna, 1x aretácia otvorených dverí, odsávanie. Skriňa je vybavená systémom samovoľného uzatvorenia otvorených dverí v prípade, ak teplota okolitého prostredia prekročí 50°C.

23/ Skriňa bezpečnostná na chemikálie

600x500x2000 mm

2ks


Skriňa s certifikátom podľa EN 14470-1 a DIN 12925-1, 90 minútová odolnosť voči požiaru. Konštrukcia skrine z elektro galvanizovanej ocele, vonkajší monolitický rám v kyselinovzdornom prevedení, nehorľavé bezpečnostné prvky. Vo výbave skrine je: 4x polica, 1x záchytné dno, 1x perforovaný kryt záchytného dna, 1x aretácia otvorených dverí, predpríprava na ventiláciu, predpríprava na karbónový filter.

24/ Skrinka na jedy

600x500x200 mm

1ks

Uzamykatelná skrinka z galvanizovanej ocele. Vo výbave skrine je: 2x polica, zámok.

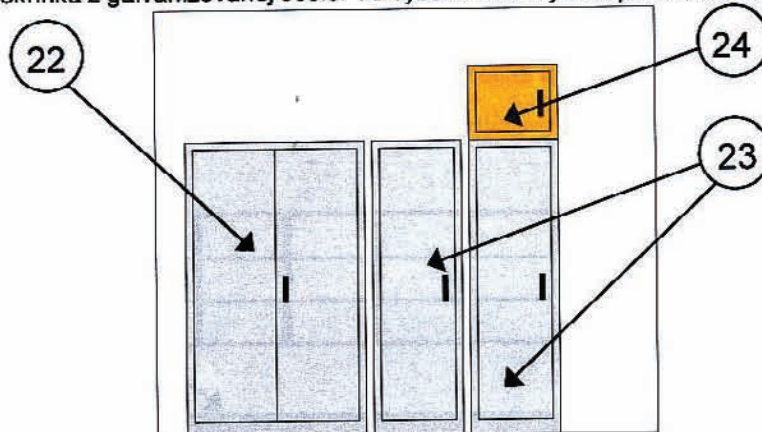

Miestnosť č. 1.37

25/ Laboratórny stôl jednostranný

3000x750x900 mm


1ks

Pracovný stôl laboratórny jednostranný je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola POSTFORMING, podľa technickej špecifikácie vyššie. Skrinky pod pracovnou doskou sú fixne spojené s pracovnou doskou. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava skriniek: **3x skrinka 4-zásuvková š. 600 mm pod laboratórny stôl hlboký 750 mm a vysoký 900 mm, 2x podvesná plnovýsuvná zásuvka** pod pracovnou doskou š. 600 mm. Všetky spodné skrinky majú kovové alebo plastové nožičky s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností.

26/ Pracovný stôl váhový

800x800x800 mm alebo 600x600x900 mm 1ks

Stôl váhový pracovný je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola je vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 38mm s 0,8mm vrstvou vysokotlakého laminátu. Prevedenie pracovnej dosky POSTFORMING. Podstavu stola tvorí kovová „H“ podstava vyrobená z jaklových profilov min. 60x20x2mm, ktoré sú povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. Súčasťou výbavy stola sú kovové výstuhy pracovnej dosky vyrobené z jaklových profilov, ktoré sú povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov a zabezpečujú vysokú nosnosť stola. Kovová „H“ podstava stojí na stabilných nožičkách s možnosťou rektifikácie výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností. Súčasťou výbavy je integrovaný váhový blok s povrchom z prírodného lešteného kameňa hrúbky min. 20mm, rozmery váhového bloku sú min. 400x400mm. Váhový blok je oddelený od pracovnej dosky a uložený na špeciálnej konštrukcii, ktorá zamedzí prenosu vibrácií z okolia na citlivé analytické váhy.

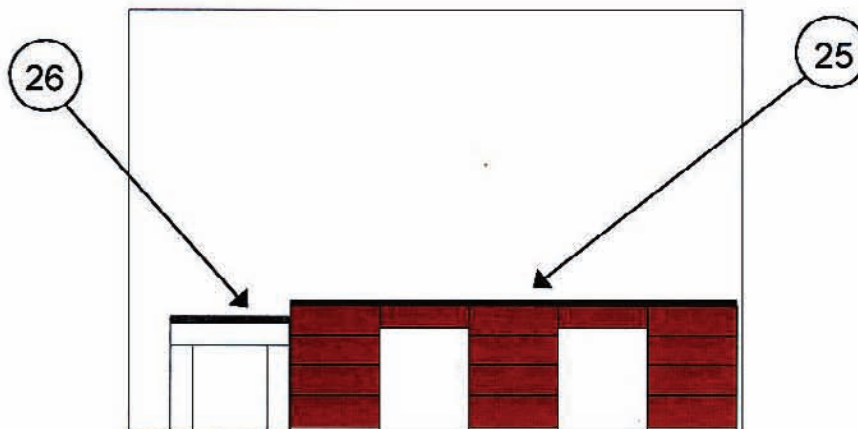


27/ Laboratórny stôl jednostranný

3000x750x900 mm

1ks

Pracovný stôl laboratórny jednostranný je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola POSTFORMING, podľa technickej špecifikácie vyššie. Skrinky pod pracovnou doskou sú fixne spojené s pracovnou doskou. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava skriniek: **3x skrinka dverová s polohovateľnou policou š. 600 mm pod laboratórny stôl hlboký 750 mm a vysoký 900 mm, 2x podvesná plnovýsuvná zásuvka** pod pracovnou doskou š. 600 mm, **2x skrinka závesná presklená 2-dverová 1200x340x900 mm, 1x skrinka závesná presklená dverová 600x340x900 mm**. Všetky spodné skrinky majú kovové alebo plastové nožičky s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností. Všetky závesné skrinky presklené majú 2-vrstvové bezpečnostné sklo v ráme a 2 polohovateľné police.

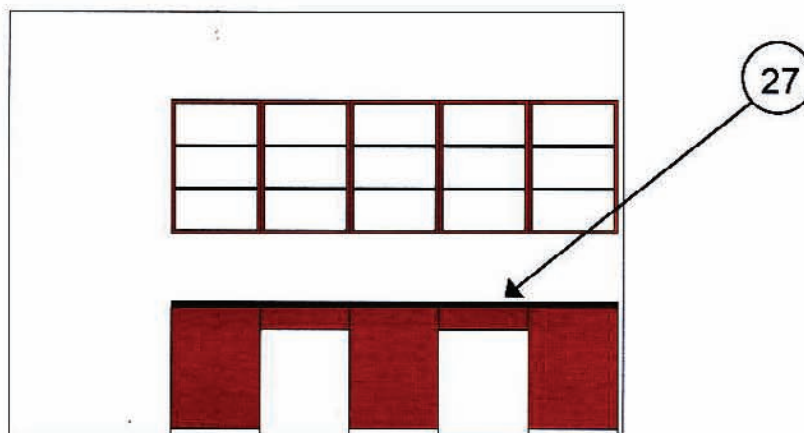


Miestnosť č. 1.42

28/ Pracovný stôl laboratórny

2200x750x900 mm

1ks

Pracovný stôl laboratórny jednostranný je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola je z HPL, podľa technickej špecifikácie vyššie. Skrinky pod pracovnou doskou sú fixne spojené s pracovnou doskou. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava skriniek: **2x skrinka dverová s polohovateľnou policou š. 600 mm** pod laboratórny stôl hlboký 750 mm a vysoký 900 mm. Všetky spodné skrinky majú kovové alebo plastové nožičky s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností.

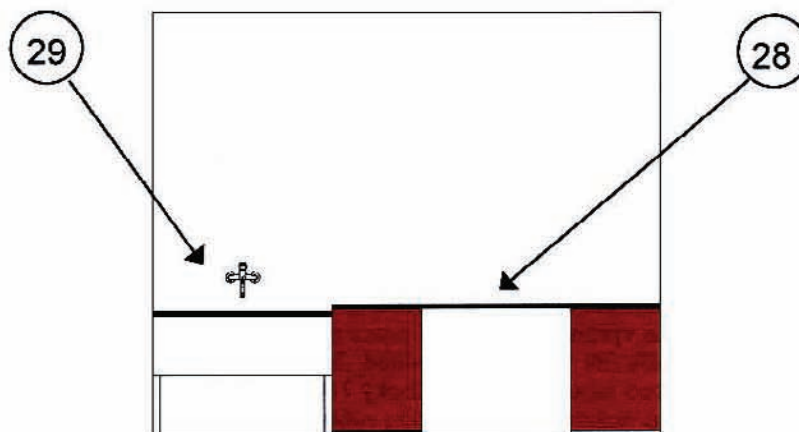

29/ Jednodrez veľký nerezový

1200x700x850 - hĺbka 400 mm

1ks


Nerezový jednodrez s ochranným prepadom vody proti pretečeniu. Vo výbave stola je aj **1x nástenná zmiešavacia armatúra chróm (150mm)** na teplú a studenú vodu.

30/ Pracovný stôl laboratórny

2200x750x900 mm

1ks

Pracovný stôl laboratórny jednostranný je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola je z HPL, podľa technickej špecifikácie vyššie. Skrinky pod pracovnou doskou sú fixne spojené s pracovnou doskou. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava skriniek: **2x skrinka dverová s polohovateľnou policou š. 600 mm** pod laboratórny stôl hlboký 750 mm a vysoký 900 mm. Všetky spodné skrinky majú kovové alebo plastové nožičky s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností.

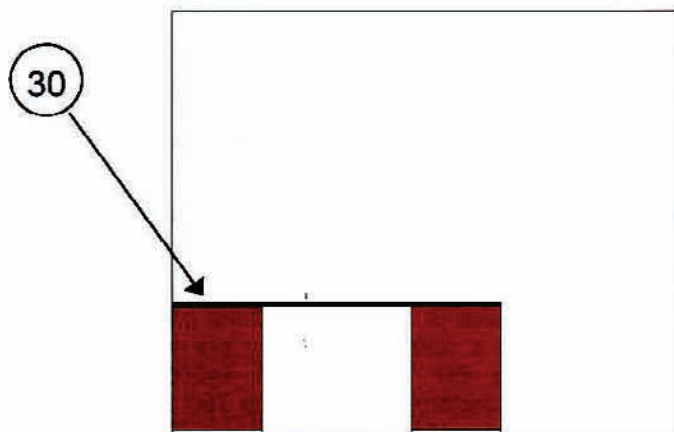

Miestnosť č. 1.43


31/ Laboratórny stôl jednostranný

3400x750x900 mm

1ks

Pracovný stôl laboratórny jednostranný je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola POSTFORMING, podľa technickej špecifikácie vyššie. Skrinky pod pracovnou doskou sú fixne spojené s pracovnou doskou. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava skriniek: **2x skrinka dvierková š. 600 mm** pod laboratórny stôl hlboký 750 mm a vysoký 900 mm, **1x skrinka 4-zásuvková š. 600 mm** pod laboratórny stôl hlboký 750 mm a vysoký 900 mm, **1x skrinka závesná dverová 600x340x900mm**, **1 x skrinka závesná 2-dverová 1200x340x900mm**. Všetky spodné skrinky majú

kovové alebo plastové nožičky s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností. Všetky závesné skrinky majú 2 polohovateľné police.

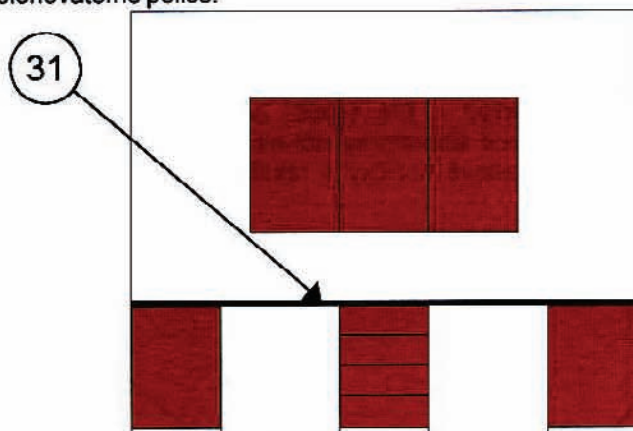


32/ Laboratórny stôl jednostranný mokrý

1200x750x900 mm

1ks

Pracovný stôl laboratórny jednostranný je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola je z HPL, podľa technickej špecifikácie vyššie. Skrinky pod pracovnou doskou sú fixne spojené s pracovnou doskou. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava skriniek: **1x skrinka inštalačná pod drez** **2-dvierková š. 1200 mm** pod laboratórny stôl hlboký 750 mm a vysoký 900 mm. Všetky spodné skrinky majú kovové alebo plastové nožičky s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností. Úchytka na dvierkach všetkých skriniek sú kovové. Vo výbave stola je **1x nerezový dvojrez** (rozmer jednotlivého drezu napr. 400 x 400 x 300 mm) s ochranným prepadom vody proti pretečeniu. Vo výbave stola je aj **1x nástenná zmiešavacia armatúra chróm (150mm)** na teplú a studenú vodu.

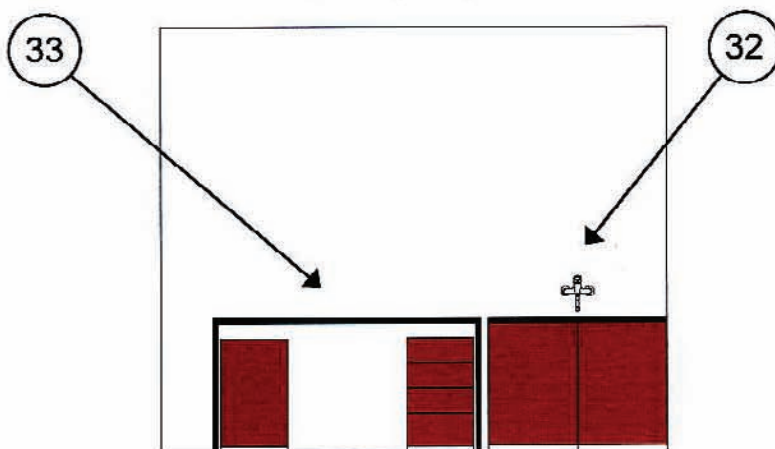

33/ Pracovný stôl laboratórny mobilný

1800x750x900 mm

1ks

Pracovný stôl laboratórny prístrojový certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola POSTFORMING, podľa technickej špecifikácie vyššie. Pracovná doska je fixne uchytená na kovovej podstave. Typ kovovej podnože „H“. Súčasťou je aj kovová výstuha pracovnej dosky a spodná výstuha. Kovová podstava je vybavená nožičkami s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností podlahy. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava skriniek: **1x skrinka kontajnerová zásuvková š. 450** pod laboratórny stôl s hĺbkou 750 mm výškou 900 mm, **1x skrinka kontajnerová dvierková š. 450** pod laboratórny stôl s hĺbkou 750 mm výškou 900 mm. Všetky kontajnerové skrinky sú na kovových alebo plastových kolieskach s pogumovaním, 2 kolieska sú vybavené brzdou. Úchytka na zásuvkách všetkých skriniek sú kovové.

Miestnosť č. 1.46


34/ Pracovný stôl laboratórny mobilný

1400x800x750 mm

1ks

Pracovný stôl laboratórny prístrojový certifikovaný podľa EN 13150 s **nosnosťou 250 kg**. Pracovná doska stola POSTFORMING, podľa technickej špecifikácie vyššie. Pracovná doska je fixne uchytená na kovovej podstave. Typ kovovej podnože „H“. Súčasťou je aj kovová výstuha pracovnej dosky a spodná výstuha.

Kovová podstava je vybavená nožičkami s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností podlahy.

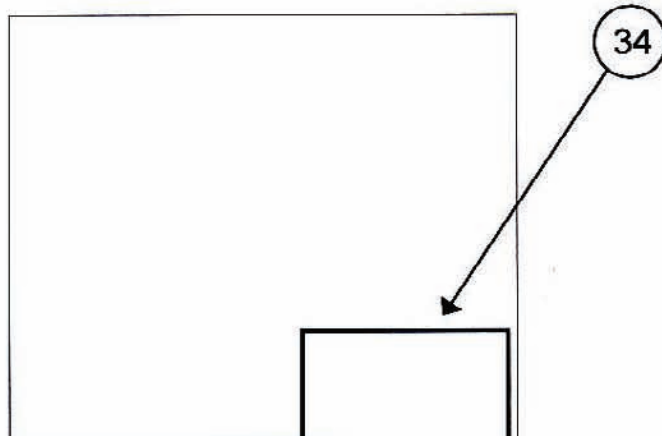


Miestnosť č. 2.12

35/ Laboratórny stôl jednostranný

4800x750x900 mm

1ks

Pracovný stôl laboratórny jednostranný je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola POSTFORMING, podľa technickej špecifikácie vyššie. Skrinky pod pracovnou doskou sú fixne spojené s pracovnou doskou. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava skriniek: **2x skrinka dvojdvierová š. 1200 mm pod laboratórny stôl** hlboký 750 mm a vysoký 900 mm, **4x skrinka 4-zásuvková š. 600 mm pod laboratórny stôl** hlboký 750 mm a vysoký 900 mm, výška zásuviek zhora: 1x 130 mm, 2x 150 mm, 1x 250-350 mm, **2x skrinka závesná 2-dvierová presklená 1200x340x600 mm**, **1x skrinka závesná 2-dvierová presklená 600x340x600 mm**. Všetky spodné skrinky majú kovové alebo plastové nožičky s rektifikáciou výšky. Všetky závesné skrinky presklené majú 2-vrstvové bezpečnostné sklo v ráme a 1 polohovateľnú policu. Zostava je doplnená policou: **1x pevná polica uchytená na stenu 3000x250 mm**. Materiál laminovaná drevotriesková doska hrúbky min. 18 mm, kontaktné hrany police sú chránené ABS hranou hrúbky 2 mm. Nosnosť min. 20 kg/m.

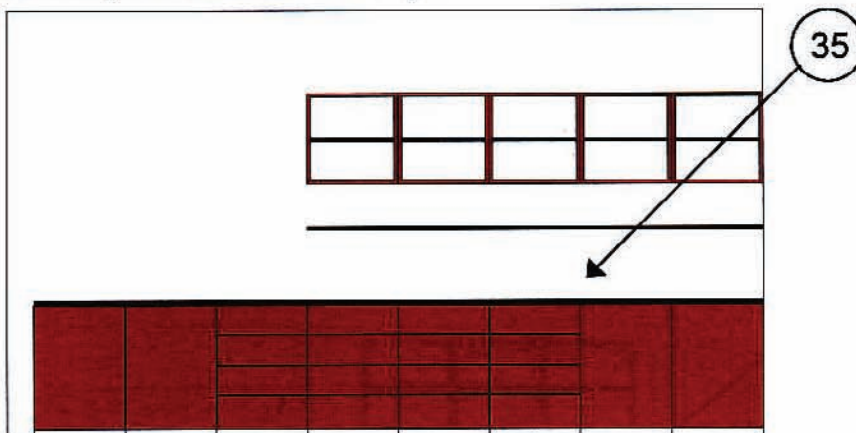


36/ Zostava stolov laboratórnych jednostranných

1ks


Pracovný stôl laboratórny jednostranný je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stolov je z materiálu HPL, podľa technickej špecifikácie vyššie. Skrinky pod pracovnou doskou sú fixne spojené s pracovnou doskou. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava stolov: **1x laboratórny stôl jednostranný 900x750x900mm**, **1x laboratórny stôl jednostranný 900x750x750mm**. Zostava skriniek: **1x skrinka dvojdvierová š. 900 mm pod laboratórny stôl** hlboký 750 mm a vysoký 900 mm, **1x skrinka dvojdvierová š. 900 mm pod laboratórny stôl** hlboký 750 mm a vysoký 750 mm, **1x skrinka závesná 2-dvierová presklená 1200x340x600mm**, **1x skrinka závesná 2-dvierová presklená 900x340x600mm**. Spodné skrinky majú kovové alebo plastové nožičky s rektifikáciou výšky. Všetky závesné skrinky presklené majú 2-vrstvové bezpečnostné sklo v ráme. Všetky dvierové skrinky majú 1 polohovateľnú policu. Úchytky na dvierkach sú kovové. Zostava je doplnená policou: **1x pevná polica uchytená na stenu 2100 x 250 mm**. Materiál laminovaná drevotriesková doska hrúbky min. 18 mm, kontaktné hrany police sú chránené ABS hranou hrúbky 2 mm. Nosnosť min. 20 kg/m.

37/ Jednodrez veľký nerezový**1200x700x850 - hĺbka 400 mm****1ks**

Nerezový jednodrez s ochranným prepacom vody proti pretečeniu. Vo výbave stola je aj 1x nástenná zmiešavacia armatúra chróm s dlhým ramenom (150mm) na teplú a studenú vodu.

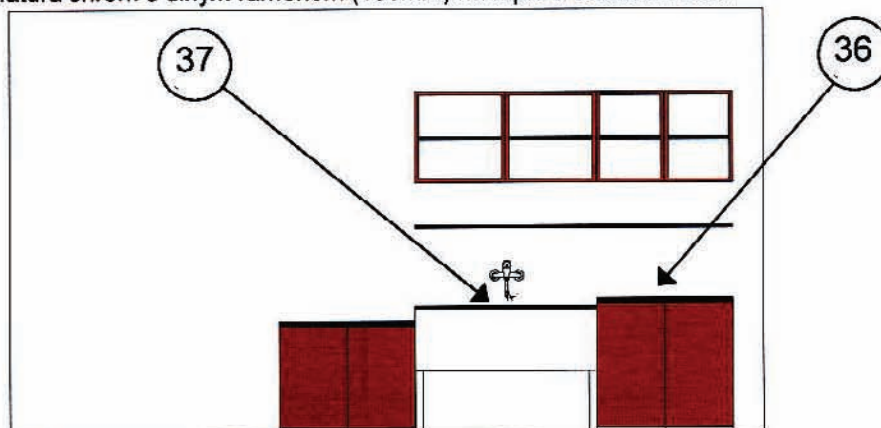
**Miestnosť č. 2.13****38/ Laboratórny stôl jednostranný****3600x750x900 mm****1ks**

Pracovný stôl laboratórny jednostranný je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola je z materiálu HPL, podľa technickej špecifikácie vyššie. Skrinky pod pracovnou doskou sú fixne spojené s pracovnou doskou. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava skriniek: **2 x skrinka dverová s polohovateľnou policou š. 600 mm** pod laboratórny stôl hlboký 750 mm a vysoký 900 mm, **1x skrinka 4-zásuvková š. 600 mm** pod laboratórny stôl hlboký 750 mm a vysoký 900 mm, výška zásuviek zhora 1x 130mm, 2x 150mm, 1x 250-350mm, **2x podvesná plnovýsuvná zásuvka** pod pracovnou doskou š. 600 mm max. výšky 130 mm, **1x inštalačná skrinka pod drez š. 600** pod laboratórny stôl hlboký 750 mm a vysoký 900 mm, **1x skrinka závesná 2-dverová presklená 1200x340x600mm**, **1x skrinka závesná 2-dverová presklená 600x340x600mm**. Inštalačná skrinka pod drez má ochranu dna prostredníctvom vyberateľnej polypropylénovej vane hĺbky min. 30mm, ktorá pokryje celé dno inštalačnej skrinky s výlevkou. Drez je osadený zhora nad úrovňou pracovnej dosky s kvalitným utesnením okrajov. Všetky spodné skrinky majú kovové alebo plastové nožičky s rektifikáciou výšky. Vo výbave stola je **1x polypropylénový drez** o rozmeroch napríklad 467x467x350 mm / 500x460x300 s ochranným prepacom vody proti pretečeniu. Vo výbave stola je aj **1x zmiešavacia armatúra** na teplú a studenú vodu z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom. Sústava je doplnená policou: **1x pevná polica uchytená na stenu 1800 x 250 mm**. Materiál laminovaná drevotriesková doska hrúbky min. 18 mm, kontaktné hrany police sú chránené ABS hranou hrúbky 2 mm. Nosnosť min. 20 kg/m.

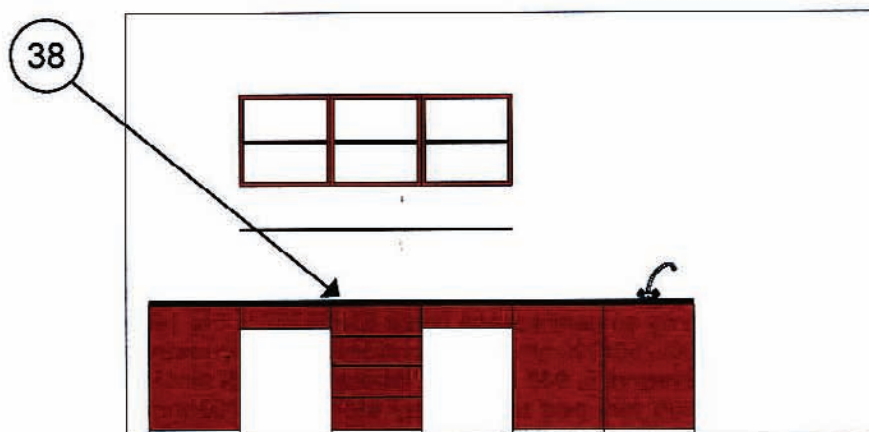


39/ Laboratórny stôl obojstranný**3000x1500x900 mm****1ks**

Pracovný stôl laboratórny obojstranný je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola je z materiálu HPL, podľa technickej špecifikácie vyššie. Skrinky pod pracovnou doskou sú fixne spojené s pracovnou doskou. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava skriniek: **2x skrinka 4-zásuvková š. 600 mm** pod laboratórny stôl hlboký 750 mm a vysoký 900 mm, výška zásuviek zhora 1x 130mm, 2x 150mm, 1x 250-350mm, **4 x podvesná plnovýsuvná zásuvka pod pracovnou doskou š. 600 mm max. výšky 130 mm**, **4x skrinka dverová s polohovateľnou policou š. 600** pod laboratórny stôl hlboký 750 mm a vysoký 900 mm. Všetky spodné skrinky majú kovové alebo plastové nožičky s rektifikáciou výšky. Súčasťou výbavy stola je **nadstavba**, ktorá pozostáva z 2 x mediálny stĺp a 2 x mediálna polica a zahŕňa: 8x elektrickú zásuvku 230V/IP 44 a 2x istič 16A. Mediálne stĺpy musia byť odolné voči vplyvu vody, vlhkosti. Hĺbka police min. 300 mm. Časti polic medzi mediálnymi stĺpmi majú kovovú výstuhu s povrchom upraveným technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. Police sú z materiálu HPL.

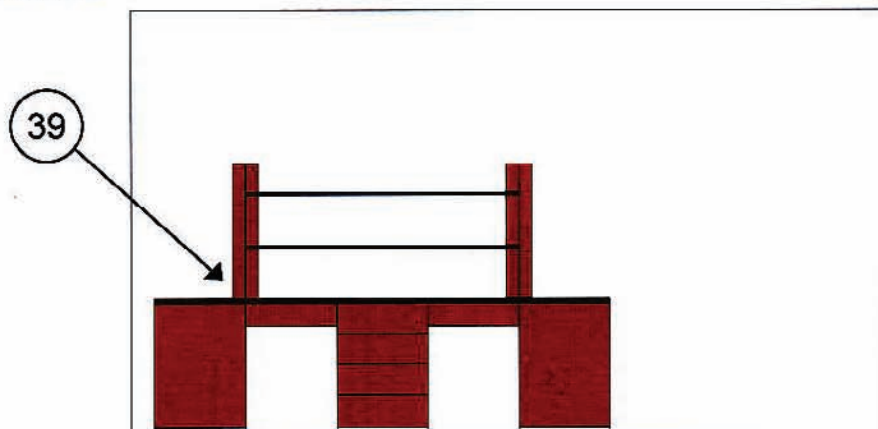**40/ Laboratórny stôl jednostranný****4200x750x900 mm****1ks**

Pracovný stôl laboratórny jednostranný je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola POSTFORMING, podľa technickej špecifikácie vyššie. Skrinky pod pracovnou doskou sú fixne spojené s pracovnou doskou. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava skriniek: **2x skrinka dverová š. 600 mm** pod laboratórny stôl hlboký 750 mm a vysoký 900 mm, **2x skrinka 4-zásuvková š. 600 mm** pod laboratórny stôl hlboký 750 mm a vysoký 900 mm, výška zásuviek zhora 1x 130mm, 2x 150mm, 1x 250-350mm, **2x podvesná plnovýsuvná zásuvka pod pracovnou doskou š. 600 mm max. výšky 130 mm**, **1x skrinka závesná 2-dverová presklená 1200x340x600mm**, **1x skrinka závesná 2-dverová presklená 600x340x600mm**. Všetky závesné skrinky presklené majú 2-vrstvové bezpečnostné sklo v ráme a 1 polohovateľnú policu. Zostava je doplnená policou: **1x pevná polica uchytená na stenu 1800 x 250 mm**. Materiál laminovaná drevotriesková doska hrúbky min. 18 mm, kontaktné hrany police sú chránené ABS hranou hrúbky 2 mm. Nosnosť min. 20 kg/m.

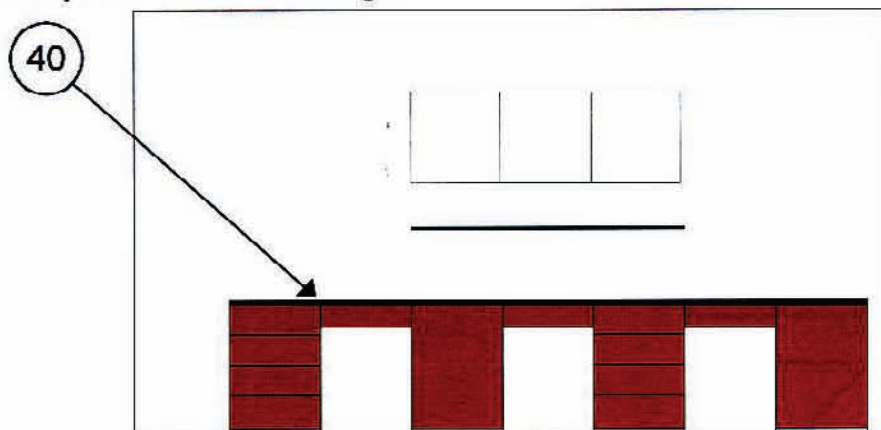


41/ Skriňa bezpečnostná na horľaviny**600x500x2000 mm****1ks**


Skriňa s certifikátom podľa EN 14470-1 a DIN 12925-1, 60 minútová odolnosť voči požiaru. Konštrukcia skrine z elektro galvanizovanej ocele, vonkajší monolitický rám v kyselinovzdornom prevedení, nehorľavé bezpečnostné prvky. Vo výbave skrine je: 4x polica, 1x záchytné dno, 1x perforovaný kryt záchytného dna, 1x aretácia otvorených dverí.

42/ Skriňa laboratórna, kombinovaná, hore presklená 900x550x2020 mm**1ks**

Skriňa je certifikovaná podľa normy EN 14 727 a EN 14 056. Výbava skrinky: horná časť 2x dvierka presklené s bezpečnostným sklom v rámoch, 3x výškovo polohovateľná polica, stredná časť 1x zásuvka, spodná časť uzamykateľná, s jednou výškovo polohovateľnou policou, kovové úchytky, laminovaná drevotriesková doska hrúbky min. 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, kovový koľajničkový posuv zásuvky alebo kovový plnovýsuv s nosnosťou až 40 kg, alebo zásuvky so systémom dovierania kvalitné závesy typu BLUM/HETTICH (alebo ekvivalent).

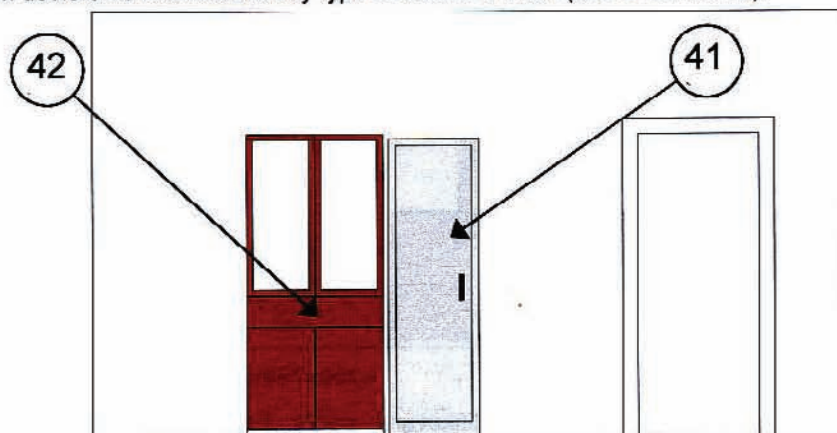
**Miestnosť č. 2.14****43/ Pracovný stôl laboratórny mobilný****1200x750x750 mm****1ks**

Pracovný stôl laboratórny prístrojový certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola POSTFORMING, podľa technickej špecifikácie vyššie. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava stolov: **1x laboratórny stôl mobilný 1200x750x750**. Pracovná doska je fixne uchytená na kovovej podstave. Typ kovovej podnože „H“. Súčasťou je aj kovová výstuha pracovnej dosky a spodná výstuha. Kovová podstava je vybavená nožičkami s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností podlahy. Zostava skriniek: **1x skrinka kontajnerová zásuvková š. 450** pod laboratórny stôl s hĺbkou 750 mm výškou 750 mm, **1x skrinka kontajnerová dvierková š. 450** pod laboratórny stôl s hĺbkou 750 mm výškou 750 mm s 1 nastaviteľnou policou, **1x skrinka závesná 2-dverová presklená 1200x340x600mm** s 1 nastaviteľnou policou. Sústava je doplnená policou: **1x pevná polica uchytená na stenu 1200x250 mm**. Materiál laminovaná drevotriesková doska hrúbky min. 18 mm, kontaktné hrany police sú chránené ABS hranou hrúbky 2 mm. Nosnosť min. 20 kg/m.

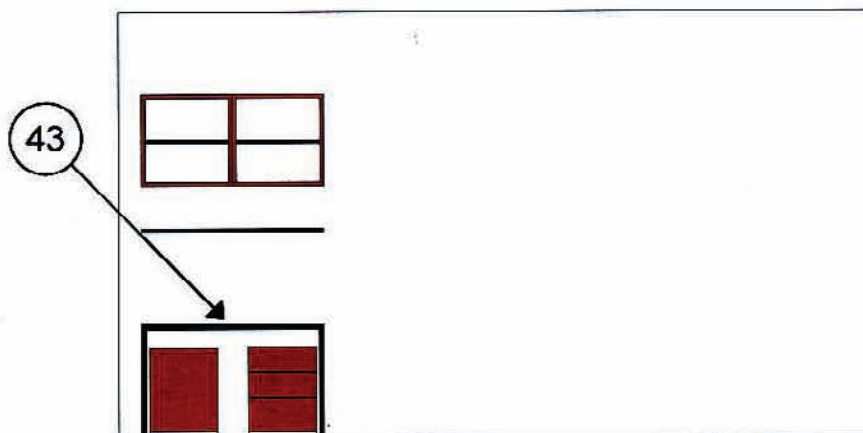


44/ Pracovný stôl laboratórny mobilný**1200x750x750 mm****1ks**

Pracovný stôl laboratórny prístrojový certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola POSTFORMING, podľa technickej špecifikácie vyššie. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava stolov: **1x laboratórny stôl mobilný 1200x750x750**. Pracovná doska je fixne uchytená na kovovej podstave. Typ kovovej podnože „H“. Súčasťou je aj kovová výstuha pracovnej dosky a spodná výstuha. Kovová podstava je vybavená nožičkami s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností podlahy. Zostava skriniek: **1x skrinka kontajnerová dvierková š. 450** pod laboratórny stôl s hĺbkou 750 mm výškou 750 mm s 1 nastaviteľnou policou, **1x skrinka závesná 2-dverová presklená 1200x340x600mm** s 1 nastaviteľnou policou. Zostava je doplnená policou: **1x pevná polica uchytená na stenu 1200 x 250 mm**. Materiál laminovaná drevotriesková doska hrúbky min. 18 mm, kontaktné hrany police sú chránené ABS hranou hrúbky 2 mm. Nosnosť min. 20 kg/m.

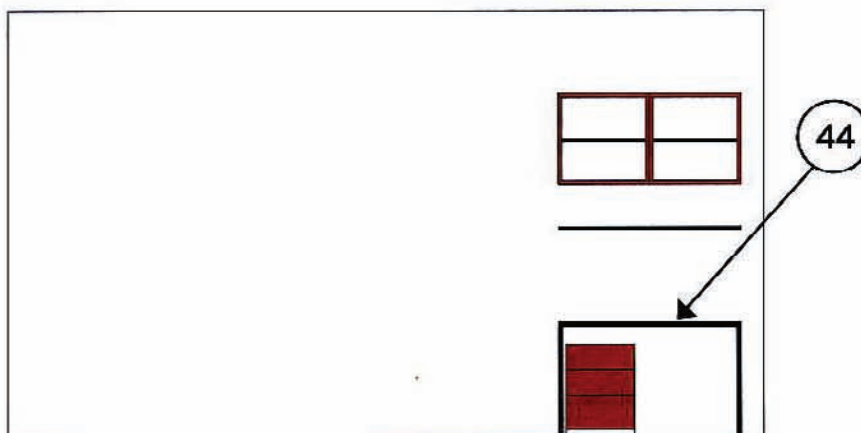
**Miestnosť č. 2.15****45/ Laboratórny stôl jednostranný****4200x750x900 mm****1ks**

Pracovný stôl laboratórny jednostranný je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola je z materiálu HPL, podľa technickej špecifikácie vyššie. Skrinky pod pracovnou doskou sú fixne spojené s pracovnou doskou. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava skriniek: **2x skrinka 4-zásuvková š. 600 mm** pod laboratórny stôl hlboký 750 mm a vysoký 900 mm, výška zásuviek zhora 1x 130mm, 2x 150mm, 1x 250-350mm, **2x podvesná plnovýsuvná zásuvka pod pracovnou doskou š. 600 mm** max. výšky 130 mm, **1x skrinka dverová s polohovateľnou policou š. 600 mm** pod laboratórny stôl hlboký 750 mm a vysoký 900 mm, **1x skrinka 2-dverová** s polohovateľnou policou š. 1200 mm pod laboratórny stôl hlboký 750 mm a vysoký 900 mm, **3x skrinka závesná 2-dverová presklená 1200x340x600mm**, **1x skrinka závesná 2-dverová presklená 600x340x600mm**. Všetky spodné skrinky majú kovové alebo plastové nožičky s rektifikáciou výšky. Všetky závesné skrinky presklené majú 2-vrstvové bezpečnostné sklo v ráme a 1 polohovateľnú policu. Zostava je doplnená policou: **1x pevná polica** uchytená na stenu 4200x250 mm. Materiál laminovaná drevotriesková doska hrúbky min. 18mm, kontaktné hrany police sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Nosnosť min. 20 kg/m.

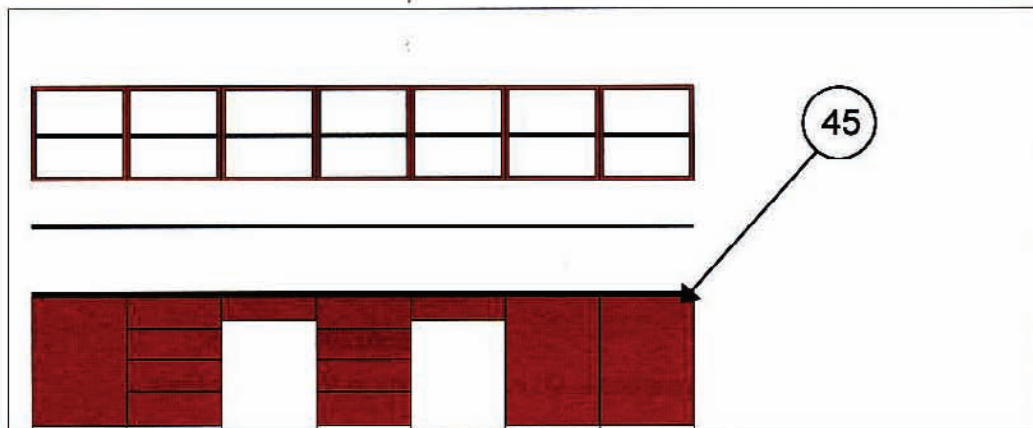

46/ Laboratórny stôl obojstranný mokrý**4800x1500x900 mm****1ks**

Pracovný stôl laboratórny obojstranný je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola je z materiálu HPL, podľa technickej špecifikácie vyššie. Skrinky pod pracovnou doskou sú fixne spojené s pracovnou doskou. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava skriniek: **4x skrinka 4-zásuvková š. 600 mm** pod laboratórny stôl hlboký 750 mm a vysoký 900 mm, výška zásuviek zhora 1x 130mm, 2x 150mm, 1x 250-350mm, **6x podvesná plynovýšuvná zásuvka pod pracovnou doskou š. 600 mm max. výšky 130 mm**, **2x inštalačná skrinka pod drez š. 600** pod laboratórny stôl hlboký 750 mm a vysoký 900 mm, **4x skrinka dverová s polohovateľnou policou š. 600** pod laboratórny stôl hlboký 750 mm a vysoký 900 mm. Inštalačná skrinka pod drez má ochranu dna prostredníctvom vyberateľnej polypropylénovej vane hĺbky min. 30mm, ktorá pokryje celé dno inštalačnej skrinky s výlevkou. Všetky spodné skrinky majú kovové alebo plastové nožičky s rektifikáciou výšky. Vo výbave stola je **2x polypropylénový drez** o rozmeroch napríklad 467x467x350 mm / 500x460x300 s ochranným prepacom vody proti pretečeniu. Drez je osadený zhora nad úrovňou pracovnej dosky s kvalitným utesnením okrajov. Vo výbave stola je aj **2x zmiešavacia armatúra** na teplú a studenú vodu z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom. Súčasťou výbavy stola je **nadstavba**, ktorá pozostáva z 3 x mediálny stĺp a 2 x mediálna polica a zahŕňa: 12x elektrická zásuvka 230V/IP 44 a 2x istič 16A, 2 x výtok studenej vody nekorozívnu armatúrou z mosadze s epoxy-polyesterovou povrchovou úpravou, 2 x odtoková polypropylénová vanička. Mediálne stĺpy musia byť odolné voči vplyvu vody, vlhkosti. Hĺbka police min. 300 mm. Časti políc medzi mediálnymi stĺpmi majú kovovú výstuhu. Police sú z materiálu HPL. Armatúry na vodu majú ventily, ktorých značenie zodpovedá norme EN 13792.

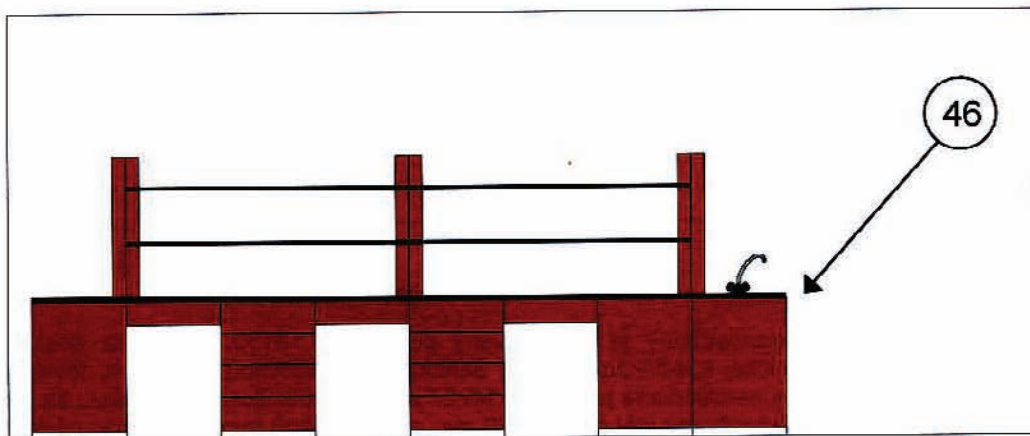**47/ Laboratórny stôl jednostranný****900x750x900 mm****1ks**

Pracovný stôl laboratórny jednostranný je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola POSTFORMING, podľa technickej špecifikácie vyššie. Skrinky pod pracovnou doskou sú fixne spojené s pracovnou doskou. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. **1x skrinka 2-dverová s polohovateľnou policou š. 900 mm** pod laboratórny stôl hlboký 750 mm a vysoký 900 mm.

48/ Skriňa bezpečnostná na horľaviny odsávaná**600x500x2000 mm****1ks**


Skriňa s certifikátom podľa EN 14470-1 a DIN 12925-1, 90 minútová odolnosť voči požiaru. Konštrukcia skrine z elektro galvanizovanej ocele, vonkajší monolitický rám v kyselinovzdornom prevedení, nehorľavé bezpečnostné prvky. Vo výbave skrine je: 4x polica, 1x záchytné dno, 1x perforovaný kryt záchytného dna, 1x aretácia otvorených dverí, odsávanie. Skriňa je vybavená systémom samovoľného uzatvorenia otvorených dverí v prípade, ak teplota okolitého prostredia prekročí 50°C. Súčasťou dodávky je odvetrávací nadstavec.

49/ Skriňa bezpečnostná na chemikálie**600x500x2000 mm****1ks**

Skriňa s certifikátom podľa EN 14470-1 a DIN 12925-1, 60 minútová odolnosť voči požiaru. Konštrukcia skrine z elektro galvanizovanej ocele, vonkajší monolitický rám v kyselinovzdornom prevedení, nehorľavé bezpečnostné prvky. Vo výbave skrine je: 4x polica, 1x záchytné dno, 1x perforovaný kryt záchytného dna, 1x aretácia otvorených dverí, predpríprava na ventiláciu, predpríprava na karbónový filter. Súčasťou dodávky je odvetrávací nadstavec.

50/ Skrinka na jedy**600x500x200 mm****1ks**

Uzamykateľná skrinka z galvanizovanej ocele. Vo výbave skrine je: 2x polica, zámok.

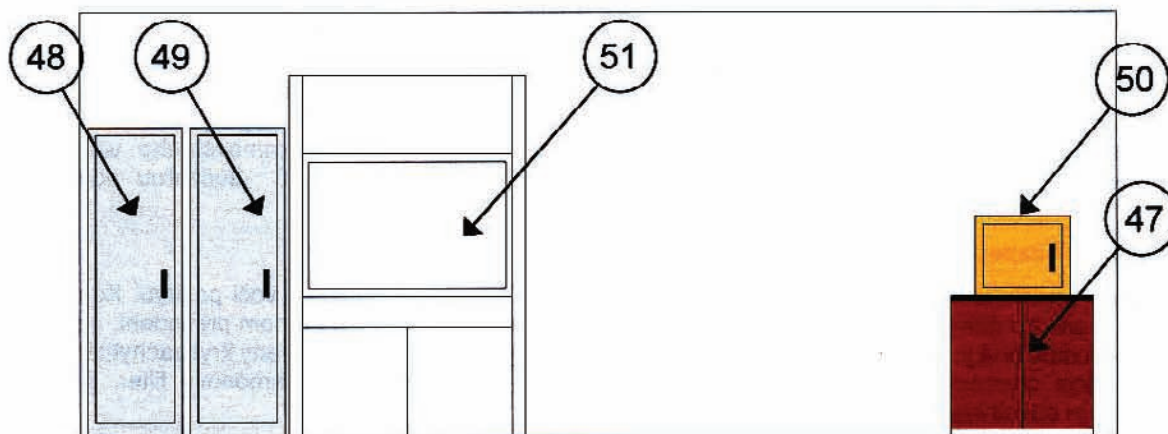

51/ Laboratórny digestor

1500x900x2350 mm

1ks

S certifikátom podľa EN 14175. Kovová nosná konštrukcia digestora zabezpečuje pevnosť digestora. Vnútrotný korpus digestora steny, zadný chrbát a strop sú zhotovené z kompaktného vysokotlakového laminátu (HPL). Rám čelnej clony je vybavený samočinnou bezpečnostnou poistkou, ktorá zabráňuje samovoľnému pádu rámu a tak možnému ohrozeniu obsluhy. Rám má výplň z bezpečnostného 2 vrstevného skla. Posuv rámu je vertikálny. Manuálne ovládaný rám je vybavený samočinnou bezpečnostnou poistkou, ktorá slúži k tomu, aby v prípade napr. pretrhnutia vodiacich elementov nedošlo k pádu rámu a tým k ohrozeniu zdravia obsluhy. Elektrické zásuvky majú ochranu IP 55. Pracovná doska digestora je vyrobená z HPL. Pracovná doska je fixne uchytená na kovovej podstave. Súčasťou je aj kovová výstuha pracovnej dosky, ktorá umožňuje postaviť do digestora aj ťažké prístroje.

Minimálne rozmery vnútornej komory digestora:

- 1 300 mm (šírka) x 750 mm (hĺbka) x 1 000 mm (výška).
- Vybava digestora:
- 1 x pracovná doska podľa vyššie uvedeného popisu so zvýšeným okrajom,
- 1 x rám čelnej clony s bezpečnostným sklom a samočinnou bezpečnostnou poistkou,
- min. 4 x elektrická zásuvka 230 V, IP 55,
- 2 x žiarivkové trubkové osvetlenie 1 300 lumen/ks, kryté 2 vrstevným bezpečnostným sklom,
- 1 x vypínač osvetlenia,
- 1 x prúdový chránič 16 A/30 mS,
- 1 x signalizácia výšky zdvihu čelnej clony v zmysle požiadaviek EN 14175,
- 1 x signalizácia rýchlosti prúdenia odsávaného vzduchu s vizuálnou indikáciou dostatočnej rýchlosti prúdenia odsávaného vzduchu,
- 1 x signalizácia rýchlosti prúdenia odsávaného vzduchu s vizuálnou indikáciou nedostatočnej rýchlosti prúdenia odsávaného vzduchu,
- 1 x signalizácia rýchlosti prúdenia odsávaného vzduchu s akustickou indikáciou nedostatočnej rýchlosti prúdenia odsávaného vzduchu s možnosťou vypnutia,
- 1 x predpríprava na pripojenie digestora na odsávacie potrubie.
- samostatný odťahový ventilátor, regulácia rýchlosti prúdenia odsávaného vzduchu, dĺžka potrubia 17 900 mm, priemer potrubia 315 mm, počet ohybov 4
- odsávaná spodná skrinka pre kyseliny a lúhy s dvierkami

Miestnosť č. 2.16

52/ Zostava pracovných stolov laboratórnych prístrojových

1ks


Pracovný stôl laboratórny prístrojový certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola POSTFORMING, podľa technickej špecifikácie vyššie. Zostava stolov: **1x laboratórny stôl mobilný 1500x750x750, 1x laboratórny stôl mobilný 1200x750x750.** Pracovná doska je fixne uchytená na kovovej podnoži. Typ kovovej podnože „H“. Súčasťou je aj kovová výstuha pracovnej dosky a spodná výstuha. Kovová podstava je vybavená nožičkami s rektifikáciou výšky. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava skriniek: **2x skrinka kontajnerová zásuvková š. 450** pod laboratórny stôl s hĺbkou 750 mm výškou 750 mm.

53/ Skriňa bezpečnostná na horľaviny odsávaná**600x500x2000 mm****1ks**

Skriňa s certifikátom podľa EN 14470-1 a DIN 12925-1, 90 minútová odolnosť voči požiaru. Konštrukcia skrine z elektro galvanizovanej ocele, vonkajší monolitický rám v kyselinovzdornom prevedení, nehorľavé bezpečnostné prvky. Vo výbave skrine je: 4x polica, 1x záchytné dno, 1x perforovaný kryt záchytného dna, 1x aretácia otvorených dverí, odsávanie. Skriňa je vybavená systémom samovoľného uzatvorenia otvorených dverí v prípade, ak teplota okolitého prostredia prekročí 50°C. Súčasťou dodávky je odvetrávací nadstavec.

54/ Skriňa bezpečnostná na chemikálie**600x500x2000 mm****1ks**

Skriňa s certifikátom podľa EN 14470-1 a DIN 12925-1, 60 minútová odolnosť voči požiaru. Konštrukcia skrine z elektro galvanizovanej ocele, vonkajší monolitický rám v kyselinovzdornom prevedení, nehorľavé bezpečnostné prvky. Vo výbave skrine je: 4x polica, 1x záchytné dno, 1x perforovaný kryt záchytného dna, 1x aretácia otvorených dverí, predpríprava na ventiláciu, predpríprava na karbónový filter. Súčasťou dodávky je odvetrávací nadstavec.

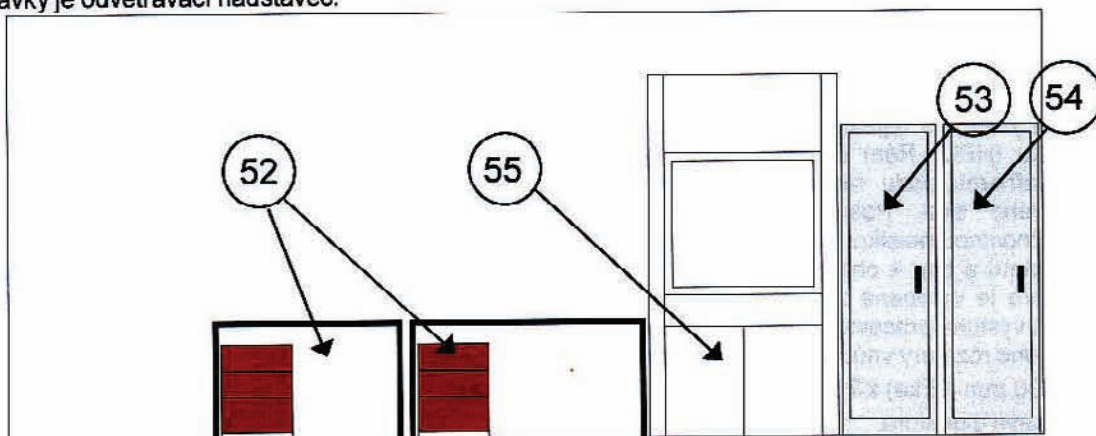
**55/ Laboratórny digestor****1200x900x2350 mm****1 ks**

S certifikátom podľa EN 14175. Kovová nosná konštrukcia digestora zabezpečuje pevnosť digestora. Vnútorňý korpus digestora steny, zadný chrbát a strop sú zhotovené z kompaktného vysokotlakového laminátu (HPL). Rám čelnej clony je vybavený samočinnou bezpečnostnou poistkou, ktorá zabráňuje samovoľnému pádu rámu a tak možnému ohrozeniu obsluhy. Rám má výplň z bezpečnostného 2 vrstvového skla. Posuv rámu je vertikálny. Manuálne ovládaný rám je vybavený samočinnou bezpečnostnou poistkou, ktorá slúži k tomu, aby v prípade napr. pretrhnutia vodiacich elementov nedošlo k pádu rámu a tým k ohrozeniu zdravia obsluhy. Elektrické zásuvky majú ochranu IP 55. Pracovná doska digestora je vyrobená z HPL. Pracovná doska je fixne uchytená na kovovej podstave. Súčasťou je aj kovová výstuha pracovnej dosky, ktorá umožňuje postaviť do digestora aj ťažké prístroje. Minimálne rozmery vnútornej komory digestora:

- 1 000 mm (šírka) x 750 mm (hĺbka) x 1 000 mm (výška).
- Výbava digestora:
- 1 x pracovná doska podľa vyššie uvedeného popisu so zvýšeným okrajom,
- 1 x rám čelnej clony s bezpečnostným sklom a samočinnou bezpečnostnou poistkou,
- min. 4 x elektrická zásuvka 230 V, IP 55,
- 2 x žiarivkové trubkové osvetlenie 1 300 lumen/ks, kryté 2 vrstvovým bezpečnostným sklom,
- 1 x vypínač osvetlenia,
- 1 x prúdový chránič 16 A/30 mS,
- 1 x signalizácia výšky zdvihu čelnej clony v zmysle požiadaviek EN 14175,
- 1 x signalizácia rýchlosti prúdenia odsávaného vzduchu s vizuálnou indikáciou dostatočnej rýchlosti prúdenia odsávaného vzduchu,
- 1 x signalizácia rýchlosti prúdenia odsávaného vzduchu s vizuálnou indikáciou nedostatočnej rýchlosti prúdenia odsávaného vzduchu,
- 1 x signalizácia rýchlosti prúdenia odsávaného vzduchu s akustickou indikáciou nedostatočnej rýchlosti prúdenia odsávaného vzduchu s možnosťou vypnutia,
- 1 x predpríprava na pripojenie digestora na odsávacie potrubie.
- samostatný odťahový ventilátor, regulácia rýchlosti prúdenia odsávaného vzduchu, dĺžka potrubia 17 900 mm, priemer potrubia 315 mm, počet ohybov 4
- odsávaná spodná skrinka pre kyseliny a lúhy s dvierkami

56/ Laboratórny stôl obojstranný**4800x1500x900 mm****1ks**


Pracovný stôl laboratórny obojstranný je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola je z materiálu HPL, podľa technickej špecifikácie vyššie. Skrinky pod pracovnou doskou sú fixne spojené s pracovnou doskou. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava skriniek: **4x skrinka 4-zásuvková š. 600 mm** pod laboratórny stôl hlboký 750 mm a vysoký 900 mm, výška zásuviek zhora 1x 130mm, 2x 150mm, 1x 250-350mm, **6x podvesná plnovýsuvná zásuvka pod pracovnou doskou š. 600 mm** max. výšky 130 mm, **2x inštalačná skrinka pod drez š. 600** pod laboratórny stôl hlboký 750 mm a vysoký 900 mm, **4x skrinka dverová s polohovateľnou policou š. 600** pod laboratórny stôl hlboký 750 mm a vysoký 900 mm. Inštalačná skrinka pod drez má ochranu dna prostredníctvom vyberateľnej polypropylénovej vane hĺbky min. 30mm, ktorá pokryje celé dno inštalačnej skrinky s výlevkou. Všetky spodné skrinky majú kovové alebo plastové nožičky s rektifikáciou výšky. Vo výbave stola je **2x polypropylénový drez** o rozmeroch napríklad 467x467x350 mm / 500x460x300 s ochranným prepadom vody proti pretečeniu. Drez je osadený zhora nad úrovňou pracovnej dosky s kvalitným utesnením okrajov. Vo výbave stola je aj **2x zmiešavacia armatúra** na teplú a studenú vodu z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom. Súčasťou výbavy stola je **nadstavba**, ktorá pozostáva z 3 x mediálny stĺp a 2 x mediálna polica a zahŕňa: 12x elektrickú zásuvku 230V/IP 44 a 2x istič 16A, 2 x výtok studenej vody nekoroziálnou armatúrou z mosadze s epoxy-polyesterovou povrchovou úpravou, 2 x odtoková polypropylénová vanička. Mediálne stĺpy musia byť odolné voči vplyvu vody, vlhkosti. Hĺbka police min. 300 mm. Časti políc medzi mediálnymi stĺpmi majú kovovú výstuhu. Police sú z materiálu HPL. Armatúry na vodu majú ventily, ktorých značenie zodpovedá norme EN 13792.

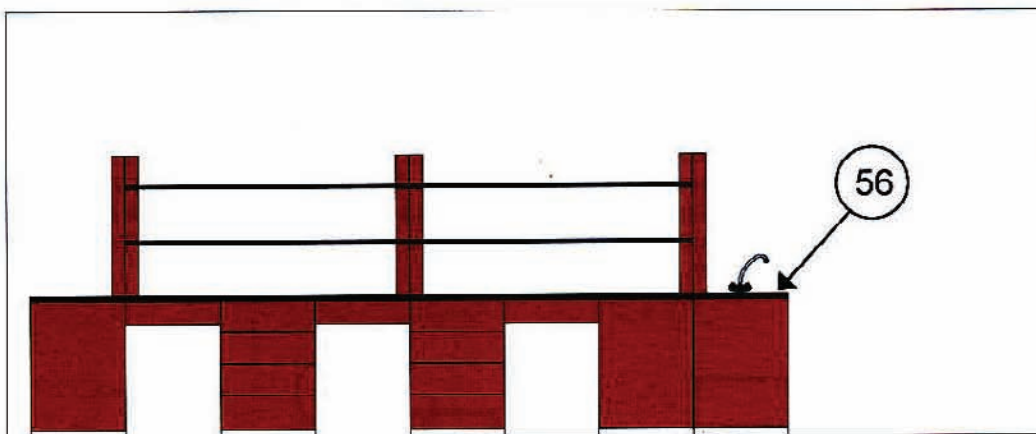**57/ Skrinka na jedy****600 x 500 x 200 mm****1ks**

Uzamykateľná skrinka z galvanizovanej ocele. Vo výbave skrine je: 2x polica, zámok.

58/ Laboratórny stôl jednostranný**3000x750x900 mm****1ks**

Pracovný stôl laboratórny jednostranný je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola POSTFORMING, podľa technickej špecifikácie vyššie. Skrinky pod pracovnou doskou sú fixne spojené s pracovnou doskou. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava skriniek: **1x skrinka 4-zásuvková š. 600 mm** pod laboratórny stôl hlboký 750 mm a vysoký 900 mm, výška zásuviek zhora 1x 130mm, 2x 150mm, 1x 250-350mm, **2x podvesná plnovýsuvná zásuvka pod pracovnou doskou š. 600 mm** max. výšky 130 mm, **2x skrinka dverová s polohovateľnou policou š. 600 mm** pod laboratórny stôl hlboký 750 mm a vysoký 900 mm, **2x skrinka závesná 2-dverová presklená 1200x340x600mm**, **1x skrinka závesná 2-dverová presklená 600x340x600mm**. Všetky spodné skrinky majú kovové alebo plastové nožičky s rektifikáciou. Všetky závesné skrinky presklené majú 2-vrstvové bezpečnostné sklo v ráme a 1 polohovateľnú policu. Zostava je doplnená policou: **1x pevná polica uchytená na stenu 3000 x 250 mm**. Materiál laminovaná drevotriesková doska hrúbky min. 18mm, kontaktné hrany police sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Nosnosť min. 20 kg/m.

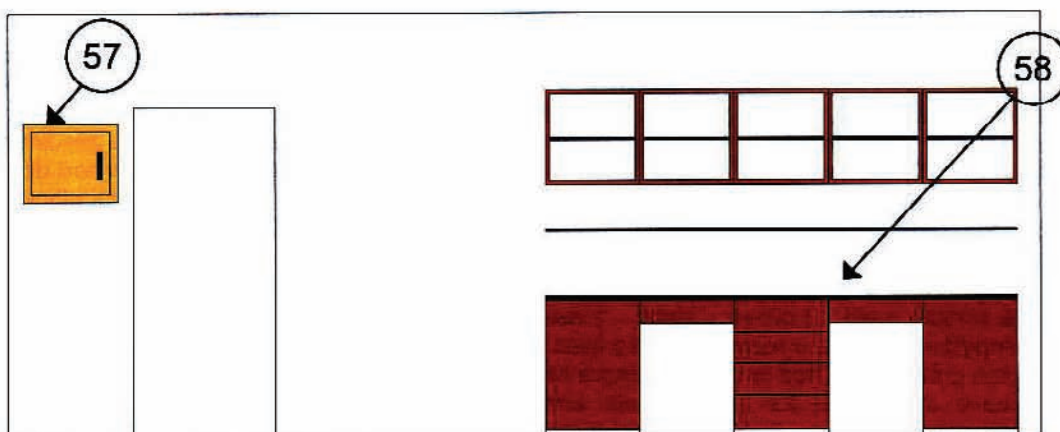


Miestnosť č. 2.17

59/ Laboratórny stôl jednostranný

3000x750x900 mm

1ks

Pracovný stôl laboratórny jednostranný je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola je z materiálu HPL podľa technickej špecifikácie vyššie. Skrinky pod pracovnou doskou sú fixne spojené s pracovnou doskou. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava skriniek: **2x skrinka 4-zásuvková š. 600 mm** pod laboratórny stôl hlboký 750 mm a vysoký 900 mm, výška zásuviek zhora 1x 130mm, 2x 150mm, 1x 250-350mm, **2x podvesná plnovýsuvná zásuvka pod pracovnou doskou š. 600 mm max. výšky 130 mm**, **1x skrinka dverová s polohovateľnou policou š. 600 mm** pod laboratórny stôl hlboký 750 mm a vysoký 900 mm, **1x skrinka závesná 2-dverová presklená 1200x340x600mm**, **1x skrinka závesná 2-dverová presklená 600x340x600mm**. Všetky spodné skrinky majú kovové alebo plastové nožičky s rektifikáciou výšky. Všetky závesné skrinky presklené majú 2-vrstvové bezpečnostné sklo v ráme a 1 polohovateľnú policu. Zostava je doplnená policou: **1x pevná polica uchytená na stenu 1800 x 250 mm**. Materiál laminovaná drevotriesková doska hrúbky min. 18mm, kontaktné hrany police sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Nosnosť min. 20 kg/m.

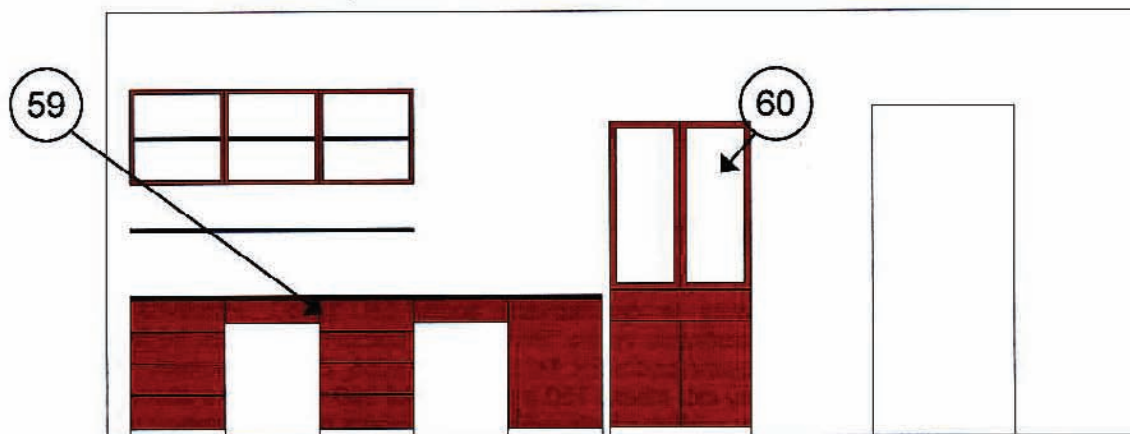

60/ Skriňa laboratórna, kombinovaná, hore presklená 900x550x2020

1ks

Skriňa je certifikovaná podľa normy EN 14 727 a EN 14 056. Výbava skrinky: horná časť 2x dvierka presklené s bezpečnostným sklom v rámoch, 3x výškovo polohovateľná polica, stredná časť 1x zásuvka, spodná časť uzamykateľná, s jednou výškovo polohovateľnou policou, kovové úchytky, laminovaná drevotriesková doska hrúbky min. 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, kovový kofajničkový posuv zásuvky alebo kovový plnovýsuv s nosnosťou až 40 kg, alebo zásuvky so systémom dovierania kvalitné závesy typu BLUM/HETTICH (alebo ekvivalent).


61/ Laboratórny stôl obojstranný

4800x1500x900 mm

1ks

Pracovný stôl laboratórny obojstranný je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola je z materiálu HPL, podľa technickej špecifikácie vyššie. Skrinky pod pracovnou doskou sú fixne spojené s pracovnou doskou. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava skriniek: **4x skrinka 4-zásuvková š. 600 mm** pod laboratórny stôl hlboký 750 mm a vysoký 900 mm, výška zásuviek zhora 1x 130mm, 2x 150mm, 1x 250-350mm, **6x podvesná plnovýsuvná zásuvka pod pracovnou doskou š. 600 mm max. výšky 130 mm**, **2x inštalácia skrinka pod drez š. 600** pod laboratórny stôl hlboký 750 mm a

vysoký 900 mm, **4x skrinka dverová s polohovateľnou policou š. 600** pod laboratórny stôl hlboký 750 mm a vysoký 900 mm. Inštalačná skrinka pod drez má ochranu dna prostredníctvom vyberateľnej polypropylénovej vane hĺbky min. 30mm, ktorá pokryje celé dno inštalačnej skrinky s výlevkou. Všetky spodné skrinky majú kovové alebo plastové nožičky s rektifikáciou výšky. Vo výbave stola je **2x polypropylénový drez** o rozmeroch napríklad 467x467x350 mm / 500x460x300 s ochranným prepacom vody proti pretečeniu. Drez je osadený zhora nad úrovňou pracovnej dosky s kvalitným utesnením okrajov. Vo výbave stola je aj **2x zmiešavacia armatúra** na teplú a studenú vodu z mosadze s epoxypolyesterovým povrchom. Súčasťou výbavy stola je **nadstavba**, ktorá pozostáva z 3 x mediálny stĺp a 2 x mediálna polica a zahŕňa: 12x elektrickú zásuvku 230V/IP 44 a 2x istič 16A, 2 x výtok studenej vody nekorozívnu armatúrou z mosadze s epoxypolyesterovou povrchovou úpravou, 2 x odtoková polypropylénová vanička. Mediálne stĺpy musia byť odolné voči vplyvu vody, vlhkosti. Hĺbka police min. 300 mm. Časťi polic medzi mediálnymi stĺpmi majú kovovú výstuhu. Police sú z materiálu HPL. Armatúry na vodu majú ventily, ktorých značenie zodpovedá norme EN 13792.

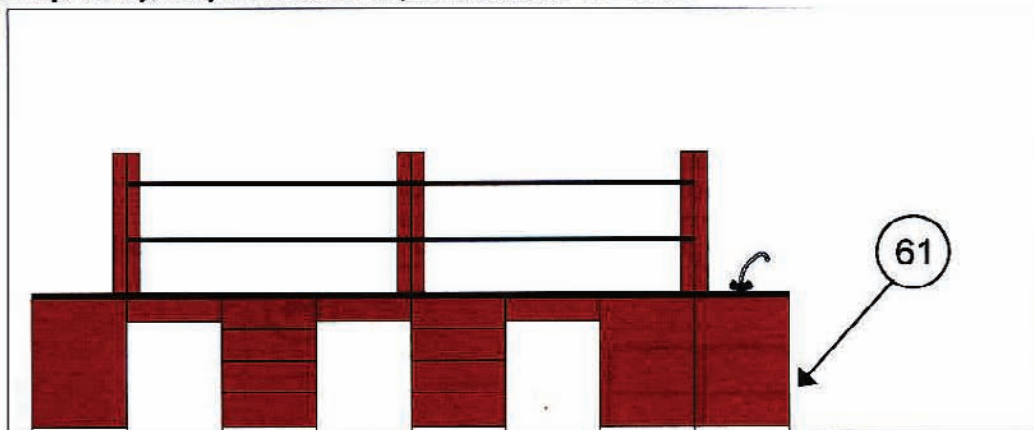

62/ Pracovný stôl laboratórny prístrojový

1800x750x750 mm

1ks

Pracovný stôl laboratórny prístrojový certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola POSTFORMING, podľa technickej špecifikácie vyššie. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava stolov: **1x laboratórny stôl mobilný 1800x750x750**. Pracovná doska je fixne uchytená na kovovej podstave. Typ kovovej podnože „H“. Súčasťou je aj kovová výstuha pracovnej dosky a spodná výstuha. Kovová podstava je vybavená nožičkami s rektifikáciou výšky. Zostava skriniek: **1x skrinka kontajnerová zásuvková š. 450** pod laboratórny stôl s hĺbkou 750 mm výškou 750 mm, **1x skrinka kontajnerová dvierková š. 450** pod laboratórny stôl s hĺbkou 750 mm výškou 750 mm s 1 nastaviteľnou policou.



Miestnosť č. 2.18

63/ Zostava pracovných stolov laboratórnych prístrojových

1ks

Pracovný stôl laboratórny prístrojový certifikovaný podľa EN 13150. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava stolov: **2x laboratórny stôl mobilný 1200x750x750 mm**. Pracovná doska stola z HPL, podľa technickej špecifikácie vyššie. Pracovná doska je fixne uchytená na kovovej podstave.

Typ kovovej podnože „H“. Súčasťou je aj kovová výstuha pracovnej dosky a spodná výstuha. Kovová podstava je vybavená nožičkami s rektifikáciou výšky. Zostava skriniek: **2x skrinka kontajnerová zásuvková š. 450** pod laboratórny stôl s hĺbkou 750 mm výškou 750 mm, **1x skrinka závesná 2-dverová presklená 1200x340x600mm**. Všetky závesné skrinky presklené majú 2-vrstvové bezpečnostné sklo v ráme a 1 polohovateľnú policu. Zostava je doplnená policou: **1x pevná polica uchytená na stenu 1200 x 250 mm**. Materiál laminovaná drevotriesková doska hrúbky min. 18mm, kontaktné hrany police sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Nosnosť min. 20 kg/m.


64/ Laminárny box

š. 1200 mm

1ks

Laminárny box certifikovaný podľa EN12469:2000. Pracovný box zabezpečujúci sterilné podmienky pre prácu s bunkami a kultúrami. Minimálne parametre:

- trieda bezpečnosti II, A2/B3.
- použiteľný pre laboratória typu BSL2
- pracovná plocha min. 1100x500 mm, $\pm 5\%$ tolerancia,
- hlučnosť max. 55 dBA
- min. 99% účinnosť HEPA filtra pre častice väčšie ako 0,3 μm - UV svetlo
- el. zásuvka vo vnútri pracovného priestoru
- vybavený automatickou reguláciou rýchlosti prúdenia,
- bezšpárový plášť pre zabezpečenie ľahkého čistenia,
- konštrukcia ventilátorov musí zabezpečovať homogénny tlak nad filtrom,
- vybavený vnútorným osvetlením pracovnej plochy bez nebezpečenstva oslňovania,
- neperforovaná pracovná plocha, predné okno z netrieštivého skla s manuálnym posuvom

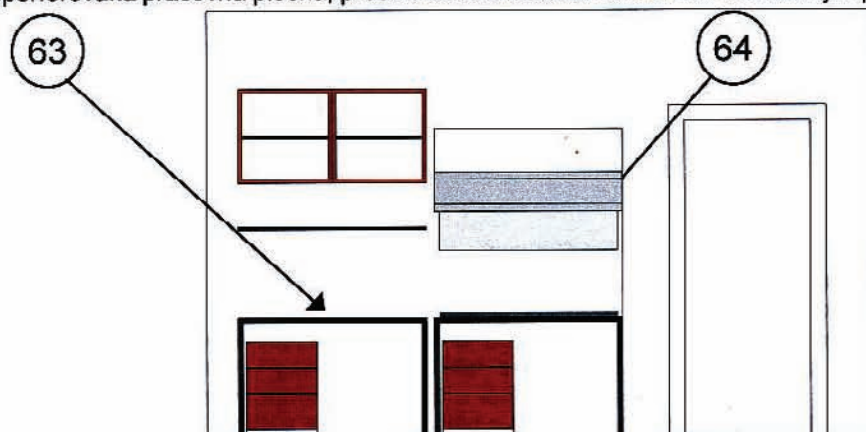


65/ Laboratórny stôl jednostranný mokrý

600x750x900 mm

1ks

Pracovný stôl laboratórny jednostranný je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola je z HPL, podľa technickej špecifikácie vyššie. Skrinka pod pracovnou doskou je fixne spojená s pracovnou doskou. Skrinka je certifikovaná podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava skriniek: **1x skrinka inštalčná pod drez š. 600 mm pod laboratórny stôl** hlboký 750 mm a vysoký 900 mm. Všetky spodné skrinky majú kovové alebo plastové nožičky s rektifikáciou výšky. Vo výbave stola je **1x polypropylénový drez** o rozmeroch napríklad 467x467x350 mm / 500x460x300 s ochranným prepacom vody proti pretečeniu. Drez je osadený zhora nad úrovňou pracovnej dosky s kvalitným utesnením okrajov. Vo výbave stola je aj **1x zmiešavacia armatúra** na teplú a studenú vodu z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom.

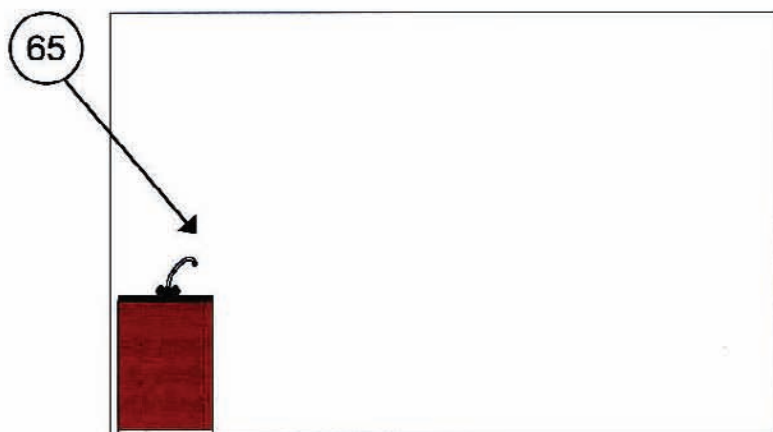


Miestnosť č. 2.19

66/ Zostava pracovných stolov laboratórných prístrojových

1ks

Pracovný stôl laboratórný prístrojový certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola POSTFORMING, podľa technickej špecifikácie vyššie. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava stolov: **1x laboratórný stôl mobilný** 1200x750x750 mm, **1x laboratórný stôl mobilný** 1500x750x750 mm. Pracovná doska je fixne uchytená na kovovej podstave. Typ kovovej podnože „H“. Súčasťou je aj kovová výstuha pracovnej dosky a spodná výstuha. Kovová podstava je vybavená nožičkami s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností podlahy. Zostava skriniek: **3x skrinka kontajnerová zásuvková š. 450** pod laboratórný stôl s hĺbkou 750 mm výškou 750 mm, **2x skrinka kontajnerová dverková š. 450** pod laboratórný stôl s hĺbkou 750 mm výškou 750 mm, **1x skrinka závesná 2-dverová presklená** 1200x340x600mm. Všetky závesné skrinky presklenené majú 2-vrstvové bezpečnostné sklo v ráme a 1 polohovateľnú policu. Zostava je doplnená policou: **1x pevná polica uchytená na stenu 1200 x 250 mm**. Materiál laminovaná drevotriesková doska hrúbky min. 18mm, kontaktné hrany police sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Nosnosť min. 20 kg/m.

Miestnosť č. 2.20

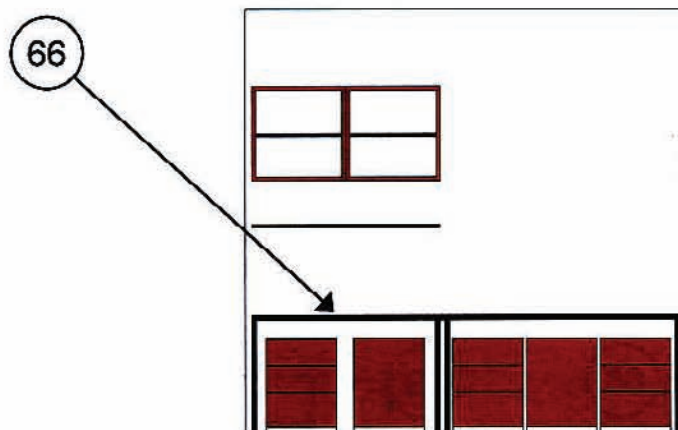

67/ Zostava pracovných stolov laboratórných prístrojových

1ks

Pracovný stôl laboratórný prístrojový certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola POSTFORMING, podľa technickej špecifikácie vyššie. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava stolov: **1x laboratórný stôl mobilný** 1800x750x750 mm, **1x laboratórný stôl mobilný** 1200x750x750 mm. Pracovná doska je fixne uchytená na kovovej podstave. Typ kovovej podnože „H“. Súčasťou je aj kovová výstuha pracovnej dosky a spodná výstuha. Kovová podstava je vybavená nožičkami s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností podlahy. Zostava skriniek: **2x skrinka kontajnerová zásuvková š. 450** pod laboratórný stôl s hĺbkou 750 mm výškou 750 mm, **2x skrinka závesná 2-dverová presklená** 900x340x600mm. Všetky závesné skrinky presklenené majú 2-vrstvové bezpečnostné sklo v ráme a 1 polohovateľnú policu. Zostava je doplnená policou: **1 x pevná polica uchytená na stenu 1800 x 250 mm**. Materiál laminovaná drevotriesková doska hrúbky min. 18mm, kontaktné hrany police sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Nosnosť min. 20 kg/m.

68/ Laminárny box

š. 1200mm

1ks

Laminárny box certifikovaný podľa EN12469:2000. Pracovný box zabezpečujúci sterilné podmienky pre prácu s bunkami a kultúrami. Minimálne parametre:

- trieda bezpečnosti II, A2/B3.
- použiteľný pre laboratória typu BSL2
- pracovná plocha min. 1100x500 mm, $\pm 5\%$ tolerancia,
- hlučnosť max. 55 dBA
- min. 99% účinnosť HEPA filtra pre častice väčšie ako 0,3 μm - UV svetlo
- el. zásuvka vo vnútri pracovného priestoru
- vybavený automatickou reguláciou rýchlosti prúdenia,
- bezšparový plášť pre zabezpečenie ľahkého čistenia,
- konštrukcia ventilátorov musí zabezpečovať homogénny tlak nad filtrom,
- vybavený vnútorným osvetlením pracovnej plochy bez nebezpečenstva oslňovania,
- neperforovaná pracovná plocha, predné okno z netrieštivého skla s manuálnym posuvom,

69/ Pracovný stôl váhový

800x800x800mm alebo 600x600x900mm 1ks


Stôl váhový pracovný je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola je vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 38mm s 0,8mm vrstvou vysokotlakého laminátu. Prevedenie pracovnej dosky POSTFORMING. Podstavu stola tvorí kovová „H“ podstava vyrobená z jaklových profilov min. 60x20x2mm, ktoré sú povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. Súčasťou výbavy stola sú kovové výstuhy pracovnej dosky vyrobené z jaklových profilov, ktoré sú povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov a zabezpečujú vysokú nosnosť stola. Kovová „H“ podstava stojí na stabilných nožičkách s možnosťou rektifikácie výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností. Súčasťou výbavy je integrovaný váhový blok s povrchom z prírodného lešteného kameňa hrúbky min. 20mm, rozmery váhového bloku sú min. 400x400mm. Váhový blok je oddelený od pracovnej dosky a uložený na špeciálnej konštrukcii, ktorá zamedzí prenosu vibrácií z okolia na citlivé analytické váhy.

70/ Laboratórny stôl jednostranný mokrý

2400x750x900 mm

1ks

Pracovný stôl laboratórny jednostranný je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola je z materiálu HPL, podľa technickej špecifikácie vyššie. Skrinky pod pracovnou doskou sú fixne spojené s pracovnou doskou. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava skriniek: **1x skrinka 4-zásuvková š. 600 mm** pod laboratórny stôl hlboký 750 mm a vysoký 900 mm, výška zásuviek zhora 1x 130mm, 2x 150mm, 1x 250-350mm, **2x podvesná plnovýsuvná zásuvka** pod pracovnou doskou š. 600 mm max. výšky 130 mm, **1x inštaláčna skrinka pod drez š. 600** pod laboratórny stôl hlboký 750 mm a vysoký 900 mm, **2x skrinka závesná 2-dverová presklená** 1200x340x600mm. Inštaláčna skrinka pod drez má ochranu dna prostredníctvom vyberateľnej polypropylénovej vane hĺbky min. 30mm, ktorá pokryje celé dno inštaláčnej skrinky s výlevkou. Všetky spodné skrinky majú kovové alebo plastové nožičky s rektifikáciou výšky. Vo výbave stola je **1x polypropylénový drez** o rozmeroch napríklad 467x467x350 mm / 500x460x300 s ochranným prepadom vody proti pretečeniu. Drez je osadený zhora nad úrovňou pracovnej dosky s kvalitným utesnením okrajov. Vo výbave stola je aj **1x zmiešavacia armatúra** na teplú a studenú vodu z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom. Všetky závesné skrinky presklené majú 2-vrstvové bezpečnostné sklo v ráme a 1 polohovateľnú policu. Zostava je doplnená policou: **1x pevná polica uchytená na stenu 2400 x 250 mm**. Materiál laminovaná drevotriesková doska hrúbky min. 18mm, kontaktné hrany police sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Nosnosť min. 20 kg/m.

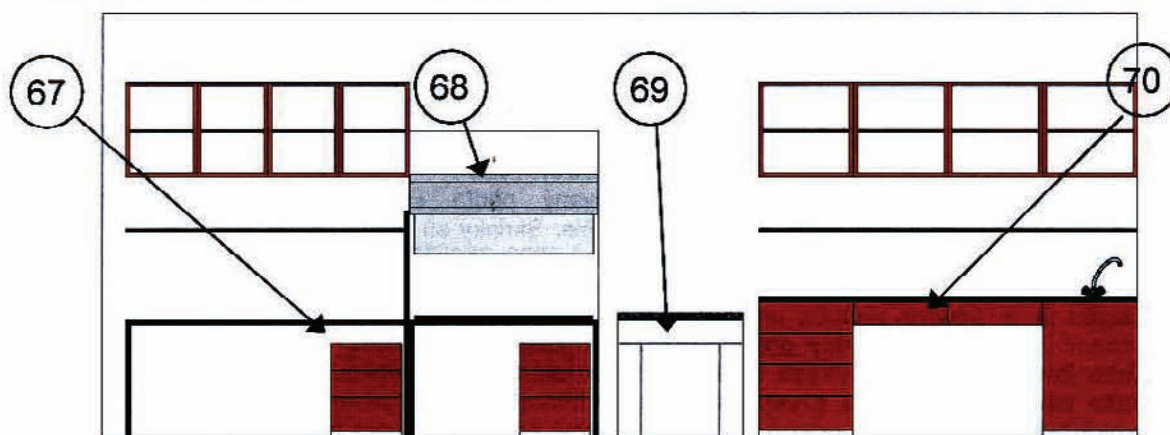

71/ Skriňa laboratórna s úložným priestorom

1200x550x2020 mm

1ks

Skriňa je certifikovaná podľa normy EN 14 727 a EN 14 056. 2x dverka s uzamykaním, 2x kľúč, kovové úchytky, 4x výškovo polohovateľná polica, šírka skrine 1200 mm je delená stredovou vnútornou priečkou,

laminovaná drevotriesková doska hrúbky min. 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, kvalitné závesy typu BLUM/HETTICH (alebo ekvivalent).

72/ Skriňa laboratórna, kombinovaná, hore presklená 900x550x2020 mm 1ks


Skriňa je certifikovaná podľa normy EN 14 727 a EN 14 056. Výbava skrinky: horná časť 2x dvierka presklené s bezpečnostným sklom v rámoch, 3x výškovo polohovateľná polica, stredná časť 1x zásuvka, spodná časť uzamykateľná, s jednou výškovo polohovateľnou policou, kovové úchytky, laminovaná drevotriesková doska hrúbky min. 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, kovový koľajničkový posuv zásuvky alebo kovový plnovýsuv s nosnosťou až 40 kg, alebo zásuvky so systémom dovierania kvalitné závesy typu BLUM/HETTICH (alebo ekvivalent).

73/ Skriňa bezpečnostná na horľaviny 600x500x2000 mm 1ks

Skriňa s certifikátom podľa EN 14470-1 a DIN 12925-1, 90 minútová odolnosť voči požiaru. Konštrukcia skrine z elektro galvanizovanej ocele, vonkajší monolitický rám v kyselinovzdornom prevedení, nehorľavé bezpečnostné prvky. Vo výbave skrine je: 4x polica, 1x záchytné dno, 1x perforovaný kryt záchytného dna, 1x aretácia otvorených dverí. Skriňa je vybavená systémom samovoľného uzatvorenia otvorených dverí v prípade, ak teplota okolitého prostredia prekročí 50°C.

74/ Skriňa bezpečnostná na chemikálie 600x500x2000 mm 1ks

Skriňa s certifikátom podľa EN 14470-1 a DIN 12925-1, 60 minútová odolnosť voči požiaru. Konštrukcia skrine z elektro galvanizovanej ocele, vonkajší monolitický rám v kyselinovzdornom prevedení, nehorľavé bezpečnostné prvky. Vo výbave skrine je: 4x polica, 1x záchytné dno, 1x perforovaný kryt záchytného dna, 1x aretácia otvorených dverí, predpríprava na ventiláciu, predpríprava na karbónový filter.

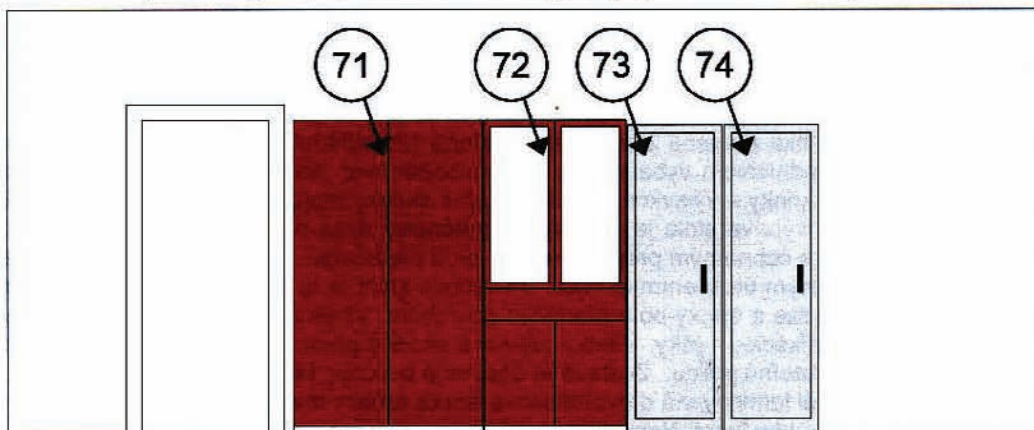

Miestnosť č. 2.21

75/ Pracovný stôl laboratórny prístrojový 1500x750x750mm 1ks


Pracovný stôl laboratórny prístrojový certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola POSTFORMING, podľa technickej špecifikácie vyššie. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava stolov: **1x laboratórny stôl mobilný 1500x750x750**. Pracovná doska je fixne uchytená na kovovej podstave. Typ kovovej podnože „H“. Súčasťou je aj kovová výstuha pracovnej dosky a spodná výstuha. Kovová podstava je vybavená požičkami s rektifikáciou výšky. Zostava skriniek: **1x skrinka kontajnerová zásuvková š. 450** pod laboratórny stôl s hĺbkou 750 mm výškou 750 mm, **1x skrinka závesná presklená 600x340x600mm**, **1x skrinka závesná 2-dverová presklená 900x340x600mm**. Všetky závesné skrinky presklené majú 2-vrstvové bezpečnostné sklo v ráme a 1 polohovateľnú policu. Zostava je doplnená policou: **1x pevná polica uchytená na stenu 1500x250 mm**. Materiál laminovaná drevotriesková doska hrúbky min. 18mm, kontaktné hrany police sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Nosnosť min. 20 kg/m.

76/ Skriňa laboratórna, kombinovaná, hore presklená 900x550x2020 mm 2ks


Skriňa je certifikovaná podľa normy EN 14 727 a EN 14 056. Výbava skrinky: horná časť 2x dvierka presklené s bezpečnostným sklom v rámoch, 3x výškovo polohovateľná polica, stredná časť 1x zásuvka, spodná časť uzamykateľná, s jednou výškovo polohovateľnou policou, kovové úchytky, laminovaná drevotriesková doska hrúbky min. 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, kovový koľajničkový posuv zásuvky alebo kovový plnovýsuv s nosnosťou až 40 kg, alebo zásuvky so systémom dovierania kvalitné závesy typu BLUM/HETTICH (alebo ekvivalent).

77/ Skriňa laboratórna šatníková s úložným priestorom 1200x550x2020**1ks**

Skriňa je certifikovaná podľa normy EN 14 727 a EN 14 056. Vybavenie: 2x dvierka s uzamykaním, 2x kľúč, kovové úchytky, 1x pevne uložená polica, v hornej časti priestoru, 1x vešiaková tyč, v 1/3 šírky policová časť, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, kvalitné závesy typu BLUM/HETTICH (alebo ekvivalent).

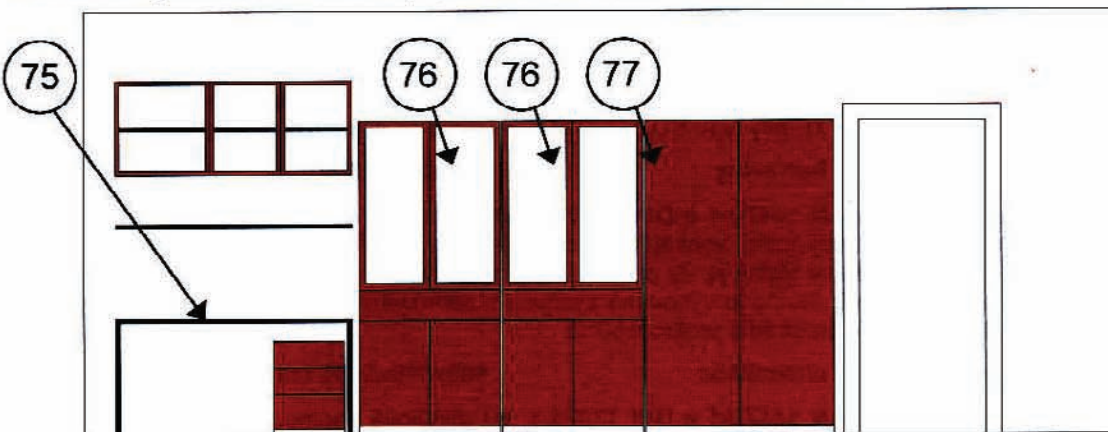**78/ Laboratórny stôl jednostranný mokrý****2400x750x900 mm****1ks**

Pracovný stôl laboratórny jednostranný je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola je z materiálu HPL podľa technickej špecifikácie vyššie. Skrinky pod pracovnou doskou sú fixne spojené s pracovnou doskou. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava skriniek: **1x skrinka 4-zásuvková š. 600 mm** pod laboratórny stôl hlboký 750 mm a vysoký 900 mm, výška zásuviek zhora 1x 130mm, 2x 150mm, 1x 250-350mm, **2x podvesná plnovýsuvná zásuvka pod pracovnou doskou š. 600 mm max. výšky 130 mm**, **1x inštalačná skrinka pod drez š. 600** pod laboratórny stôl hlboký 750 mm a vysoký 900 mm, 2 x skrinka závesná 2-dverová presklená 1200x340x600mm. Inštalačná skrinka pod drez má ochranu dna prostredníctvom vyberateľnej polypropylénovej vane hĺbky min. 30mm, ktorá pokryje celé dno inštalačnej skrinky s výlevkou. Všetky spodné skrinky majú kovové alebo plastové nožičky s rektifikáciou výšky. Vo výbave stola je **1x polypropylénový drez** o rozmeroch napríklad 467x467x350 mm / 500x460x300 mm s ochranným prepadom vody proti pretečeniu. Drez je osadený zhora nad úrovňou pracovnej dosky s kvalitným utesnením okrajov. Vo výbave stola je aj **1x zmiešavacia armatúra** na teplú a studenú vodu z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom. Všetky spodné skrinky majú kovové alebo plastové nožičky s rektifikáciou výšky. Všetky závesné skrinky presklenené majú 2-vrstvové bezpečnostné sklo v ráme a 1 polohovateľnú policu. Zostava je doplnená policou: **1x pevná polica uchytená na stenu 2400 x 250 mm**. Materiál laminovaná drevotriesková doska hrúbky min. 18 mm, kontaktné hrany police sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Nosnosť min. 20 kg/m.

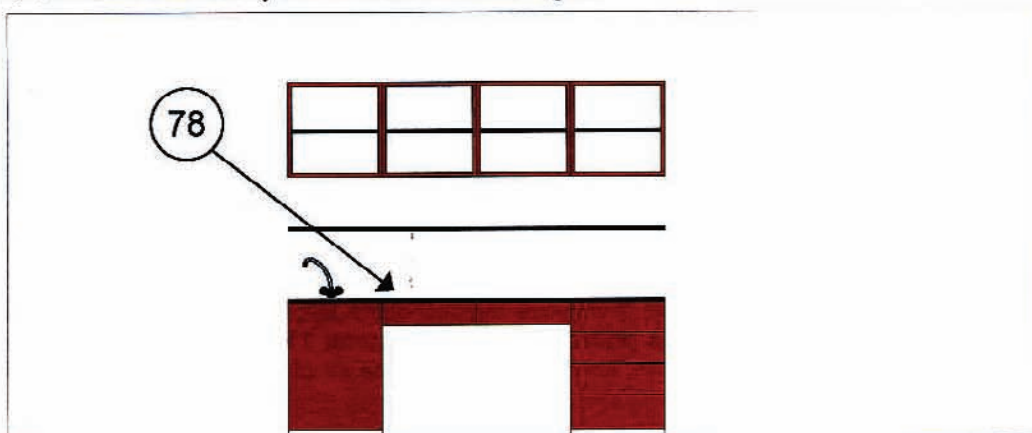**79/ Laboratórna stolička****35ks**

Výškovo nastaviteľná pomocou plynového piestu, na kolieskach, s opierkou chrbta, sedadlo s výplňou z hustej peny potiahnuté materiálom, ktorý je umývateľný, pevný a oteruvzdorný. S oporným kruhom na nohy, bez opierok rúk.

Konkrétne poradové číslo výrobku a názov výrobku uvedené v nasledovnej tabuľke zodpovedajú výrobku s rovnakým poradovým číslom a názvom uvedeným v tomto odseku B) /ostatné technické parametre/ tejto prílohy č. 1

Poradové č. výrobku	Názov výrobku určený verejným obstarávateľom	Požadované technické parametre	
		Áno	nie
1.	Laboratórny digestor (odsávací box)	X	
2.	Laboratórny stôl jednostranný	X	
3.	Laboratórny stôl obojstranný mokrý	X	
4.	Laboratórny stôl jednostranný	X	
5.	Laboratórny stôl jednostranný mokrý	X	
6.	Zostava pracovných stolov laboratórnych prístrojových	X	
7.	Zostava pracovných stolov laboratórnych prístrojových	X	
8.	Laminárny box	X	
9.	Laboratórny stôl jednostranný mokrý	X	
10.	Zostava pracovných stolov laboratórnych prístrojových	X	
11.	Laminárny box	X	
12.	Pracovný stôl laboratórny prístrojový	X	
13.	Laboratórny stôl jednostranný	X	
14.	Laboratórny stôl obojstranný mokrý	X	
15.	Pracovný stôl laboratórny prístrojový	X	
16.	Zostava pracovných stolov laboratórnych prístrojových	X	
17.	Pracovný stôl laboratórny	X	
18.	Jednodrez veľký nerezový	X	
19.	Laboratórny stôl jednostranný mokrý	X	
20.	Pracovný stôl nerezový	X	
21.	Zostava pracovných stolov laboratórnych prístrojových	X	
22.	Skriňa bezpečnostná na horľaviny	X	
23.	Skriňa bezpečnostná na chemikálie	X	
24.	Skrinka na jedy	X	
25.	Laboratórny stôl jednostranný	X	
26.	Pracovný stôl váhový	X	
27.	Laboratórny stôl jednostranný	X	
28.	Pracovný stôl laboratórny	X	
29.	Jednodrez veľký nerezový	X	
30.	Pracovný stôl laboratórny	X	
31.	Laboratórny stôl jednostranný	X	
32.	Laboratórny stôl jednostranný mokrý	X	
33.	Pracovný stôl laboratórny mobilný	X	
34.	Pracovný stôl laboratórny mobilný	X	
35.	Laboratórny stôl jednostranný	X	
36.	Zostava stolov laboratórnych jednostranných	X	
37.	Jednodrez veľký nerezový	X	

38.	Laboratórny stôl jednostranný	X	
39.	Laboratórny stôl obojstranný	X	
40.	Laboratórny stôl jednostranný	X	
41.	Skriňa bezpečnostná na horľaviny	X	
42.	Skriňa laboratórna, kombinovaná, hore presklená	X	
43.	Pracovný stôl laboratórny mobilný	X	
44.	Pracovný stôl laboratórny mobilný	X	
45.	Laboratórny stôl jednostranný	X	
46.	Laboratórny stôl obojstranný mokrý	X	
47.	Laboratórny stôl jednostranný	X	
48.	Skriňa bezpečnostná na horľaviny odsávaná	X	
49.	Skriňa bezpečnostná na chemikálie	X	
50.	Skrinka na jedy	X	
51.	Laboratórny digestor	X	
52.	Zostava pracovných stolov laboratórných prístrojových	X	
53.	Skriňa bezpečnostná na horľaviny odsávaná	X	
54.	Skriňa bezpečnostná na chemikálie	X	
55.	Laboratórny digestor	X	
56.	Laboratórny stôl obojstranný	X	
57.	Skrinka na jedy	X	
58.	Laboratórny stôl jednostranný	X	
59.	Laboratórny stôl jednostranný	X	
60.	Skriňa laboratórna, kombinovaná, hore presklená	X	
61.	Laboratórny stôl obojstranný	X	
62.	Pracovný stôl laboratórny prístrojový	X	
63.	Zostava pracovných stolov laboratórných prístrojových	X	
64.	Laminárny box	X	
65.	Laboratórny stôl jednostranný mokrý	X	
66.	Zostava pracovných stolov laboratórných prístrojových	X	
67.	Zostava pracovných stolov laboratórných prístrojových	X	
68.	Laminárny box	X	
69.	Pracovný stôl váhový	X	
70.	Laboratórny stôl jednostranný mokrý	X	
71.	Skriňa laboratórna s úložným priestorom	X	
72.	Skriňa laboratórna, kombinovaná, hore presklená	X	
73.	Skriňa bezpečnostná na horľaviny	X	
74.	Skriňa bezpečnostná na chemikálie	X	
75.	Pracovný stôl laboratórny prístrojový	X	
76.	Skriňa laboratórna, kombinovaná, hore presklená	X	
77.	Skriňa laboratórna šatníková s úložným priestorom	X	
78.	Laboratórny stôl jednostranný mokrý	X	
79.	Laboratórna stolička	X	

29.	Jednodrez veľký nerezový	525,39	105,08	630,47	525,39	105,08	630,47
30.	Pracovný stôl laboratórny	447,40	89,48	536,88	447,40	89,48	536,88
31.	Laboratórny stôl jednostranný	618,84	123,77	742,61	618,84	123,77	742,61
32.	Laboratórny stôl jednostranný mokrý	419,29	83,86	503,15	419,29	83,86	503,15
33.	Pracovný stôl laboratórny mobilný	399,62	79,92	479,54	399,62	79,92	479,54
34.	Pracovný stôl laboratórny mobilný	240,82	48,16	288,98	240,82	48,16	288,98
35.	Laboratórny stôl jednostranný	1 083,29	216,66	1 299,95	1 083,29	216,66	1 299,95
36.	Zostava stolov laboratórných jednostranných	566,85	113,37	680,22	566,85	113,37	680,22
37.	Jednodrez veľký nerezový	525,39	105,08	630,47	525,39	105,08	630,47
38.	Laboratórny stôl jednostranný	1 307,43	261,49	1 568,92	1 307,43	261,49	1 568,92
39.	Laboratórny stôl obojstranný	1 668,59	333,72	2 002,31	1 668,59	333,72	2 002,31
40.	Laboratórny stôl jednostranný	875,31	175,06	1 050,37	875,31	175,06	1 050,37
41.	Skriňa bezpečnostná na horľaviny	1 405,80	281,16	1 686,96	1 405,80	281,16	1 686,96
42.	Skriňa laboratória, kombinovaná, hore presklená	268,93	53,79	322,72	268,93	53,79	322,72
43.	Pracovný stôl laboratórny mobilný	479,02	95,80	574,82	479,02	95,80	574,82
44.	Pracovný stôl laboratórny mobilný	479,02	95,80	574,82	479,02	95,80	574,82
45.	Laboratórny stôl jednostranný	1 310,24	262,05	1 572,29	1 310,24	262,05	1 572,29
46.	Laboratórny stôl obojstranný mokrý	3 322,60	664,52	3 987,12	3 322,60	664,52	3 987,12
47.	Laboratórny stôl jednostranný	208,50	41,70	250,20	208,50	41,70	250,20
48.	Skriňa bezpečnostná na horľaviny odsávaná	1 792,25	358,45	2 150,70	1 792,25	358,45	2 150,70
49.	Skriňa bezpečnostná na chemikálie	1 440,93	288,19	1 729,12	1 440,93	288,19	1 729,12
50.	Skrinka na jedy	316,71	63,34	380,05	316,71	63,34	380,05
51.	Laboratórny digestor	3 527,77	705,55	4 233,32	3 527,77	705,55	4 233,32
52.	Zostava pracovných stolov laboratórných prístrojových	527,50	105,50	633,00	527,50	105,50	633,00
53.	Skriňa bezpečnostná na horľaviny odsávaná	1 792,25	358,45	2 150,70	1 792,25	358,45	2 150,70
54.	Skriňa bezpečnostná na chemikálie	1 440,93	288,19	1 729,12	1 440,93	288,19	1 729,12
55.	Laboratórny digestor	2 518,78	503,76	3 022,54	2 518,78	503,76	3 022,54
56.	Laboratórny stôl obojstranný	3 322,60	664,52	3 987,12	3 322,60	664,52	3 987,12
57.	Skrinka na jedy	316,71	63,34	380,05	316,71	63,34	380,05
58.	Laboratórny stôl jednostranný	852,12	170,42	1 022,54	852,12	170,42	1 022,54
59.	Laboratórny stôl jednostranný	926,60	185,32	1 111,92	926,60	185,32	1 111,92
60.	Skriňa laboratória, kombinovaná, hore presklená	268,93	53,79	322,72	268,93	53,79	322,72
61.	Laboratórny stôl obojstranný	3 322,60	664,52	3 987,12	3 322,60	664,52	3 987,12
62.	Pracovný stôl laboratórny prístrojový	399,62	79,92	479,54	399,62	79,92	479,54
63.	Zostava pracovných stolov laboratórných prístrojových	760,78	152,16	912,94	760,78	152,16	912,94
64.	Laminárny box	3 394,27	678,85	4 073,12	3 394,27	678,85	4 073,12
65.	Laboratórny stôl jednostranný mokrý	500,80	100,16	600,96	500,80	100,16	600,96
66.	Zostava pracovných stolov laboratórných prístrojových	873,20	174,64	1 047,84	873,20	174,64	1 047,84
67.	Zostava pracovných stolov laboratórných prístrojových	788,88	157,78	946,66	788,88	157,78	946,66
68.	Laminárny box	3 394,27	678,85	4 073,12	3 394,27	678,85	4 073,12
69.	Pracovný stôl váhový	302,66	60,53	363,19	302,66	60,53	363,19
70.	Laboratórny stôl jednostranný mokrý	1 105,77	221,15	1 326,92	1 105,77	221,15	1 326,92

Príloha č. 2:

Položkový rozpočet, predložený Predávajúcim vo verejnom obstarávaní, ktorý vychádza z výsledkov elektronickej aukcie

Nový návrh ceny – položkový rozpočet

Obchodné meno uchádzača: **ITES Vranov, s. r. o.**

Sídlo:

Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Topľou

Predmet zákazky: Nákup laboratórneho nábytku

Nový návrh ceny – položkový rozpočet

Por. č. výrobku	Názov výrobku určený verejným obstarávateľom	Navrhovaná jednotková cena v Eur bez DPH	DPH 20%	Navrhovaná jednotková cena v EUR s DPH	Navrhovaná celková cena za položku v Eur bez DPH	DPH 20%	Navrhovaná celková cena za položku v EUR s DPH
1.	Laboratórny digestor (odsávací box)	2 518,79	503,76	3 022,55	2 518,79	503,76	3 022,55
2.	Laboratórny stôl jednostranný	903,42	180,68	1 084,10	903,42	180,68	1 084,10
3.	Laboratórny stôl obojstranný mokrý	2 294,64	458,93	2 753,57	2 294,64	458,93	2 753,57
4.	Laboratórny stôl jednostranný	827,53	165,51	993,04	827,53	165,51	993,04
5.	Laboratórny stôl jednostranný mokrý	694,73	138,95	833,68	694,73	138,95	833,68
6.	Zostava pracovných stolov laboratórných prístrojových	861,25	172,25	1 033,50	861,25	172,25	1 033,50
7.	Zostava pracovných stolov laboratórných prístrojových	666,62	133,32	799,94	666,62	133,32	799,94
8.	Laminárny box	3 394,27	678,85	4 073,12	3 394,27	678,85	4 073,12
9.	Laboratórny stôl jednostranný mokrý	693,32	138,66	831,98	693,32	138,66	831,98
10.	Zostava pracovných stolov laboratórných prístrojových	714,40	142,88	857,28	714,40	142,88	857,28
11.	Laminárny box	3 394,27	678,85	4 073,12	3 394,27	678,85	4 073,12
12.	Pracovný stôl laboratórny prístrojový	360,97	72,19	433,16	360,97	72,19	433,16
13.	Laboratórny stôl jednostranný	689,11	137,82	826,93	689,11	137,82	826,93
14.	Laboratórny stôl obojstranný mokrý	2 045,20	409,04	2 454,24	2 045,20	409,04	2 454,24
15.	Pracovný stôl laboratórny prístrojový	286,50	57,30	343,80	573,00	114,60	687,60
16.	Zostava pracovných stolov laboratórných	534,53	106,91	641,44	534,53	106,91	641,44
17.	Pracovný stôl laboratórny	629,38	125,88	755,26	629,38	125,88	755,26
18.	Jednodrez veľký nerezový	510,64	102,13	612,77	510,64	102,13	612,77
19.	Laboratórny stôl jednostranný mokrý	973,68	194,74	1 168,42	973,68	194,74	1 168,42
20.	Pracovný stôl nerezový	864,78	172,96	1 037,74	2 594,34	518,87	3 113,21
21.	Zostava pracovných stolov laboratórných	1 409,31	281,86	1 691,17	1 409,31	281,86	1 691,17
22.	Skriňa bezpečnostná na horľaviny	1 988,99	397,80	2 386,79	1 988,99	397,80	2 386,79
23.	Skriňa bezpečnostná na chemikálie	1 405,81	281,16	1 686,97	2 811,62	562,32	3 373,94
24.	Skrinka na jedy	316,71	63,34	380,05	316,71	63,34	380,05
25.	Laboratórny stôl jednostranný	548,58	109,72	658,30	548,58	109,72	658,30
26.	Pracovný stôl váhový	302,66	60,53	363,19	302,66	60,53	363,19
27.	Laboratórny stôl jednostranný	777,64	155,53	933,17	777,64	155,53	933,17
28.	Pracovný stôl laboratórny	447,40	89,48	536,88	447,40	89,48	536,88

71.	Skriňa laboratória s úložným priestorom	259,79	51,96	311,75	259,79	51,96	311,75
72.	Skriňa laboratória, kombinovaná, hore presklená	268,93	53,79	322,72	268,93	53,79	322,72
73.	Skriňa bezpečnostná na horľaviny	1 405,80	281,16	1 686,96	1 405,80	281,16	1 686,96
74.	Skriňa bezpečnostná na chemikálie	1 131,77	226,35	1 358,12	1 131,77	226,35	1 358,12
75.	Pracovný stôl laboratórny prístrojový	525,39	105,08	630,47	525,39	105,08	630,47
76.	Skriňa laboratória, kombinovaná, hore presklená	268,94	53,79	322,73	537,88	107,58	645,46
77.	Skriňa laboratória šatníková s úložným priestorom	249,96	49,99	299,95	249,96	49,99	299,95
78.	Laboratórny stôl jednostranný mokrý	1 105,77	221,15	1 326,92	1 105,77	221,15	1 326,92
79.	Laboratórna stolička	235,67	47,13	282,80	8 248,45	1649,69	9 898,14

Celková cena za predmet zákazky bez DPH	98 250,00 €
DPH 20 %	19 650,00 €
Celková cena za predmet zákazky s DPH	117 900,00 €

Vo Vranove nad Topľou dňa 06.12.2016

③ **ITES Vranov, s.r.o.**
Černianska 137
093 03 Vranov nad Topľou
IČO: 31680259
IČ DFH: SK2020527817



Ing. Michal Fedor
konateľ



Slavomír Fedor
konateľ

Príloha č. 3:

Údaje o všetkých známych subdodávateľoch

Por. Číslo	Predmet plnenia subdodávateľa	hodnota plnenia vyjadrená v % (percentách) k ponukovej cene	Identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo	osoba oprávnená konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia

Vo Vranove nad Topľou dňa 30.12.2016

 **ITES Vranov, s.r.o.**
 Černianska 137
 093 03 Vranov nad Topľou
 IČO: 31680259
 IČ DPH: SK2020527817



Ing. Michal Fedor
konateľ



Slavomír Fedor
konateľ