

KÚPNA ZMLUVA Č. 23032021/MMVH MVFACM

uzavretá v zmysle § 409 zákona č. 513/1991 Zb.

v znení neskorších zmien a doplnení (Obchodný zákonník).

1 Zmluvné strany:

1.1 Kupujúci: Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a
hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
Sídlo: Vyšné Hágy 1, 059 84
Konajúci prostredníctvom: Ing. Jozef Poráč, MPH, generálny riaditeľ
Ing. Agáta Jenčová, ekonomická riaditeľka
IČO: 00 227 811
DIČ: 2021212622
IČ DPH: SK2021212622
Právna forma: štátna príspevková organizácia zriadená Ministerstvom
zdravotníctva SR

/ďalej len „kupujúci“/

1.2 Predávajúci: Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o.
Sídlo: Piešťanská 12, Nové Mesto nad Váhom
Konajúci prostredníctvom: Ing. Jaroslav Tonkovič – konateľ
Ing. Margita Vernerová - konateľka

IČO: 46378979
IČ DPH: SK2023373264
DIČ: 2023373264
IBAN: [REDACTED]
SWIFT: [REDACTED]

Zapísaný: Okresný súd Trenčín, Obchodný register, vložka číslo 25685/R, Oddiel Sro

/ďalej len „predávajúci“/

Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o., Piešťanská 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

tel./fax +421 32 7798 118, www.messer.sk




2. Predmet zmluvy a spôsob odovzdania predmetu kúpy

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy dohoda zmluvných strán, v ktorej sa Predávajúci zaväzuje previesť vlastnícke právo a odovzdať Predmet kúpy na Kupujúceho a Kupujúci sa zaväzuje za podmienok uvedených v tejto Zmluve Predmet kúpy prevziať a zaplatiť kúpnu cenu určenú v článku 4 tejto Zmluvy a úprava práv a povinností zmluvných strán spojených s dodávkou, inštaláciou a uvedením do prevádzky Predmetu kúpy (ďalej ako „Predmet kúpy“).
- 2.2 Podľa dohody zmluvných strán sa pod Predmetom kúpy bude rozumieť zdravotnícka technika, ktorá je bližšie špecifikovaná v Prílohe č. 1 k tejto Zmluve.
- 2.3. Predávajúci sa na základe tejto zmluvy zaväzuje dodať kupujúcemu nový tovar v súlade s bodom 2.2 tejto zmluvy, ktorý zodpovedá technickým, STN, EN a ostatným normám a požiadavkám, ktoré kupujúci výslovne požaduje a ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 k tejto Zmluve.
Dodanie tovaru v rozpore s týmto bodom 2.3. bude kupujúci považovať za podstatné porušenie Zmluvy s právom okamžitého odstúpenia od tejto Kúpnej zmluvy a s právom uplatnenia zmluvnej pokuty voči predávajúcemu vo výške 20 % zo zaplatenej kúpnej ceny a to popri práve na vrátenie celej zaplatenej kúpnej ceny, ako aj s právom na úhradu všetkých nákladov a škody, ktorá kupujúcemu vznikla v dôsledku dodania tovaru v rozpore s touto Zmluvou.
- 2.4. Predávajúci odovzdá predmet kúpy vrátane príslušenstva (najmä platný certifikát a návod na obsluhu) osobe určenej kupujúcim, vykoná poučenie osoby určenej kupujúcim o obsluhu a údržbe, o čom vyhotoví protokol. Kupujúci k odovzdaniu predmetu kúpy a poučeniu personálu poskytne predávajúcemu požadovanú súčinnosť.

3. Termín a miesto plnenia

- 3.1 Predávajúci sa zaväzuje odovzdať Predmet kúpy do rúk Kupujúceho v mieste prevzatia na adrese podľa čl. 1 tejto zmluvy, v termíne do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
- 3.2 Povinnosť Predávajúceho odovzdať Predmet kúpy do rúk Kupujúceho sa považuje za splnenú dňom jeho prevzatia Kupujúcim, v mieste plnenia podľa bodu 3.1 tejto Zmluvy.
- 3.3 Prevzatie Predmetu kúpy potvrdí Kupujúci predávajúcemu na dodacom liste.
- 3.4 Ak pri preberacom konaní, alebo bezprostredne po ňom, Kupujúci zistí, že Predmet kúpy vykazuje viditeľné vady preukázateľne brániace jeho riadnemu užívaniu, alebo riadnemu užívaniu na účel, na ktorý je určený podľa požadovaných noriem, certifikátov

Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o., Piešťanská 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom





a požiadaviek Kupujúceho určený, prípadne nie je kompletná dokladová časť podľa bodu 2.4, odmietne prevzatie Predmetu Kúpy, o čom zmluvné strany vyhotovia písomný záznam. Po odstránení väd, alebo doplnení dokladovej časti, ktoré bránili úspešnému prevzatiu Predmetu kúpy, oznámi Predávajúci túto skutočnosť Kupujúcemu a vyzve ho k prevzatiu Predmetu kúpy.

Kupujúci je kedykoľvek v priebehu užívania tovaru (do uplynutia záručnej doby) oprávnený reklamovať skryté vady tovaru, resp. vady, ktoré sú zistiteľné až užívaním tovaru a ktoré majú za následok, že tovar nie je možné riadne a bez obmedzení užívať na ten účel, na ktorý je určený podľa požadovaných noriem, certifikátov a požiadaviek Kupujúceho určený.

4. Kúpna cena a platobné podmienky

4.1 Kúpna cena Predmetu kúpy v súlade s čl. 2 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a to vo výške **28980,- EUR bez DPH (slovom dvadsaťosemtisícdeväťstoosemdesiat EUR bez DPH), 34776,- EUR vrátane DPH (slovom tridsaťštyritisíc sedmstosedemdesiatšesť EUR vrátane DPH)** ktorú zaplatí Kupujúci na účet Predávajúceho po prevzatí Predmetu kúpy na základe faktúry a podľa ustanovení Zmluvy. Predávajúcemu vzniká právo vystaviť faktúru na kúpnu cenu hneď po prevzatí Predmetu kúpy Kupujúcim.

4.2 V cene podľa bodu 4.1. tejto zmluvy (a súvisiacich) je zahrnutá dodávka tovaru do miesta plnenia, odovzdanie, uvedenie do prevádzky a poučenie osoby určenej Kupujúcim o obsluhu a údržbe Predmetu kúpy.

4.3 Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru po odovzdaní a prevzatí riadne dodaného tovaru Kupujúcim. Predávajúci je povinný vystaviť faktúru najneskôr do 5-ich dní nasledujúceho mesiaca po dni dodania tovaru. Faktúra bude obsahovať:

- obchodné meno, sídlo alebo trvalý pobyt, miesto podnikania, IČO, daňové identifikačné číslo a číslo registrácie Predávajúceho, ktorý uskutočňuje zdaniteľné plnenie
- obchodné meno, sídlo alebo trvalý pobyt, miesto podnikania, IČO, daňové identifikačné číslo Kupujúceho, v ktorého prospech sa zdaniteľné plnenie uskutočňuje,
- poradové číslo faktúry,
- dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia,
- dátum vyhotovenia faktúry,
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
- názov, množstvo tovaru alebo rozsah zdaniteľného plnenia,
- výška ceny bez dane ,



- sadzba DPH a výška DPH celkom,
- celkovú fakturovanú sumu,
- označenie (názov) Predmetu kúpy,
- číslo Zmluvy
- označenie peňažného ústavu a účtu, na ktorý sa má fakturovaná čiastka uhradiť
- odtlačok pečiatky Predávajúceho a podpis osoby oprávnenej k podpisu faktúry.

4.3 Prílohou a neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude aj preberací protokol. V prípade, že faktúra nebude obsahovať zákonné alebo v Zmluve uvedené náležitosti, nebude k nej pripojený Kupujúcim potvrdený preberací protokol podľa predchádzajúcej vety, je Kupujúci oprávnený vrátiť ju Predávajúcemu v lehote splatnosti na doplnenie a prepracovanie s písomným odôvodnením. V týchto prípadoch prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti a Kupujúci nie je v omeškaní s úhradou ceny Predmetu kúpy. Nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej alebo novej faktúry Kupujúcemu.

4.4 Faktúry, vystavené Predávajúcim, budú splatné do 30 dní odo dňa ich doručenia Kupujúcemu, a to bezhotovostne na účet Kupujúceho uvedený na faktúre. Predávajúci doručí faktúry na adresu Kupujúceho podľa čl.1 tejto zmluvy.

4.5 Zmluvné strany dohodli zákaz postúpenia pohľadávok veriteľa podľa § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho písomného súhlasu dlžníka. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky veriteľa v rozpore s dohodou dlžníka podľa predchádzajúcej vety, bude podľa § 39 Občianskeho zákonníka absolútne neplatný.

5. Záručná doba a reklamačné konanie


5.1. Predávajúci je povinný dodať Predmet kúpy v množstve, akosti a parametroch v súlade s touto zmluvou, dokumentáciou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Z tohto dôvodu je kupujúci v súčinnosti s predávajúcim povinný pri prevzatí dodávky zistiť jej kompletnosť a kvalitu.

5.2 Vadou sa na účely tejto Zmluvy rozumie odchýlka v akosti, množstve, a parametroch Predmetu kúpy stanovených dokumentáciou, Zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Zároveň Predávajúci zodpovedá za to, že Predmet kúpy bude mať vlastnosti výslovne vymienené podľa Prílohy č. 1 k tejto Zmluve a že ho bude možno riadne a bez obmedzení užívať na ten účel, na ktorý je určený podľa požadovaných noriem, certifikátov a požiadaviek Kupujúceho.

5.3 Predmet kúpy má tiež vady, ak :

Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o., Piešťanská 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

tel./fax +421 32 7798 118, www.messer.sk





- doklady podľa tejto Zmluvy neboli Objednávateľovi odovzdané, boli odovzdané neúplné alebo spôsobom, ktorý je v rozpore s obsahom Zmluvy,
 - má právne vady, alebo je zaťažené právami tretích osôb,
 - má vady, ktoré existovali pred odovzdaním tovaru, ale stali sa zjavné až po odovzdaní Predmetu kúpy (skryté vady).
 - ako aj iné vady, ktoré sú vadami podľa platných právnych predpisov
- 5.4 Na Predmet kúpy sa vzťahuje záruka **24 mesiacov**, pričom záručná doba začína plynúť dňom odovzdania, prevzatia a uvedenia predmetu kúpy do prevádzky. Zárukou za akosť preberá Predávajúci záväzok, že Predmet kúpy bude po uvedení do užívania spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.
- 5.5 V prípade uplatnenia reklamácie vady vystaví Kupujúci bezodkladne písomné oznámenie (reklamáciu), ktoré obsahuje najmä:
- špecifikáciu zmluvného vzťahu, na základe ktorého bolo vykonané plnenie (číslo Zmluvy a označenie zmluvných strán),
 - názov reklamovaného Predmetu kúpy,
 - miesto dodania Predmetu kúpy,
 - termín jeho dodania,
 - popis reklamovanej vady Predmetu kúpy,
 - voľbu nároku, ktorý si Kupujúci uplatňuje a primeranú lehotu, v ktorej má Predávajúci poskytnúť zvolené záručné plnenie.
- 5.6 Nahlásenie vady Predávajúci bezodkladne potvrdí Kupujúcemu písomnou formou. Kupujúci sa zaväzuje vytvoriť Predávajúcemu podmienky potrebné na odstránenie vady, prípadne inú potrebnú činnosť za účelom poskytnutia záručného plnenia.
- 5.7 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady na Predmete kúpy, že počas záručnej doby má Kupujúci právo požadovať od Predávajúceho a Predávajúci má povinnosť bezplatne odstrániť vady.
- 5.8 Predávajúci sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd na Predmete kúpy do dvoch pracovných dní odo dňa uplatnenia písomnej reklamácie Kupujúcim a vady odstrániť v najkratšom možnom čase. Termín odstránenia väd dohodnú zmluvné strany písomnou formou. Pri vadách, ktoré môžu obmedziť alebo znemožniť prevádzkovú činnosť Kupujúceho je Predávajúci povinný začať s odstraňovaním väd do 24 hodín po uplatnení písomnej reklamácie Kupujúcim.



- 5.9 Ak sa ukáže, že vada Predmetu kúpy alebo jeho časti je neopraviteľná, zaväzuje sa Predávajúci dodať do desiatich dní od zistenia tejto skutočnosti alebo od výzvy Kupujúceho náhradné plnenie.
- 5.10 Predávajúci je povinný odstrániť bez zbytočného odkladu aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Náklady takto vzniknuté budú uhradené na základe vzájomnej dohody zmluvných strán podľa ceny Predmetu kúpy a preukázaného množstva vykonaných prác nevyhnutných na vykonanie opravy.
- 5.11 V prípade, že Predávajúci oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote alebo v primeranej lehote napriek tomu, že Kupujúci vytvoril Predávajúcemu podmienky na ich odstránenie, má Kupujúci právo dať ich odstrániť tretej osobe na náklady Predávajúceho, alebo od Zmluvy odstúpiť.
- 5.12 Predávajúci sa zaväzuje počas trvania záručnej doby raz ročne prekontrolovať za účasti povereného zamestnanca Kupujúceho Predmet kúpy za účelom zistenia a následne odstránenia záručných vád. O každej prehliadke bude spísaný protokol o vykonaní záručnej prehliadky potvrdený oboma zmluvnými stranami. O záručnú prehliadku Predmetu kúpy požiada Predávajúci Kupujúceho najmenej 10 dní pred navrhovaným termínom prehliadky.

6. Práva a povinnosti zmluvných strán


- 6.1 Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru po uhradení celej kúpnej ceny v súlade s touto Zmluvou.
- 6.2 Predávajúci je povinný odovzdať Predmet kúpy v súlade so Zmluvou a zodpovedá za to, že Predmet kúpy bude mať vlastnosti dohodnuté v Zmluve, určené dokumentáciou a bude zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám, ktoré sú stanovené technickými predpismi a normami. Predávajúci je povinný pri odovzdávaní Predmetu kúpy akceptovať v priestoroch Kupujúceho realizáciu iných výkonov vo verejnom záujme a svoju činnosť s nimi zosúladiť.
- 6.3 Akékoľvek spory a nároky vyplývajúce z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiace sa budú riešiť predovšetkým rokovaním a dohodou účastníkov zmluvy v dobrej viere a s dobrým úmyslom. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa akékoľvek spory alebo nároky vyplývajúce z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiace nevyriešia spôsobom uvedeným v predchádzajúcom odseku, budú zmluvné strany riešiť spor prostredníctvom príslušného súdu.



- 6.4 Súčasťou dodania Predmetu kúpy je aj jeho doprava na miesto dodania, inštalácia a uvedenie do prevádzky, odskúšanie Predmetu kúpy, zaškolenia zamestnancov Kupujúceho s obsluhou dodaného Predmetu kúpy, odovzdanie návodu na obsluhu v slovenskom jazyku, vyhlásenia o zhode, vyhlásenia, že Predmet kúpy je spôsobilý na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, záručný list, potvrdenie prevzatia/odovzdania Predmetu kúpy v preberacom protokole v mieste dodania/odovzdania zo strany Predávajúceho. O zaškolení obsluhy bude vykonaný zápis.
- 6.5 Kupujúci má právo odmietnuť prevziať Predmet kúpy, ak technické a úžitkové parametre nezodpovedajú technickým parametrom uvedeným v ponuke, ak by sa počas záručnej doby vyskytli opakovane závažné nedostatky v kvalite Predmetu kúpy, prípadne zistí, že kvalita Predmetu kúpy nezodpovedá predloženej ponuke.

7 Odstúpenie od zmluvy

- 7.1 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným z dôvodu vyskytnutia vyššej moci a do 6 mesiacov nedôjde k dohode strán o náhradnom plnení čo do predmetu a času plnenia, strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc má právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.
- 7.2 Obe zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade jej podstatného porušenia. Za podstatné porušenie zmluvy Predávajúcim sa bude považovať dodanie vadného tovaru, za podstatné porušenie zmluvy Kupujúcim sa bude považovať zavinené meškanie s úhradou kúpnej ceny.
- 7.3 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane, ak v odstúpení nie je uvedený neskorší dátum účinnosti odstúpenia.
- 7.4 Odstúpenie od Zmluvy, dodatky k Zmluve, faktúry, doklady o skúškach a ďalšiu dokumentáciu patriacu k Predmetu kúpy, oznámenia, súhlasy a reklamácia väd budú vyhotovené písomne a doručené druhej zmluvnej strane osobne alebo zaslané poštou. Odstúpenie od Zmluvy doručujú zmluvné strany formou doporučenej zásielky.
- 7.5 Kupujúci je oprávnený pre doručovanie všetkých písomností určiť adresu tretej osoby, pričom doručenie písomností tretej osobe sa považuje za doručenie Kupujúcemu. Povinnosť doručovania písomností tretej osobe vzniká Predávajúcemu dňom, keď mu bude doručené oznámenie Kupujúceho o uplatnení si tohto oprávnenia a o kontaktných údajoch tretej osoby.
- 7.6 Všetky písomnosti sa považujú za doručené aj v prípade neprevzatia zásielky odoslanej poštou zmluvnou stranou na adresu sídla alebo miesta podnikania druhej zmluvnej Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o., Piešťanská 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom





strany alebo na adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy resp. na adresu tretej osoby oznámenú Kupujúcim. Za deň doručenia sa považuje prvý deň nasledujúceho mesiaca po odoslaní písomnosti zmluvnou stranou.

8. Všeobecné a záverečné ustanovenia

- 8.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy a iné prekážky, ktoré nastali nezávisle od vôle povinnej strany a bránia jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala.
- 8.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade spracovania osobných údajov fyzických osôb, budú postupovať v zmysle Nariadenia (EÚ) 2016/679 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“). Predávajúci podpisom tejto Zmluvy dáva Kupujúcemu súhlas na spracovanie údajov v súlade v rozsahu nevyhnutnom na realizáciu tejto Zmluvy a v súlade so zák.č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov
- 8.3 V prípade, ak pri plnení predmetu Zmluvy bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov fyzických osôb zo strany Kupujúceho, Predávajúci vyhlasuje, že zabezpečil predchádzajúci písomný súhlas dotknutých osôb so spracovaním ich osobných údajov Kupujúcim, pričom Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že má na ich poskytnutie súhlas, ak sa tento podľa právnych predpisov vyžaduje a ďalej Predávajúci vyhlasuje, že je oprávnený Kupujúcemu uvedené osobné údaje poskytnúť.
- 8.4 Pokiaľ je súčasťou Predmetu kúpy predmet duševného vlastníctva spôsobilý na ochranu podľa zákona (ďalej len „autorské dielo“) Predávajúci týmto udeľuje Kupujúcemu právo autorské dielo použiť (ďalej len „licencia“) na časovo neobmedzené obdobie, minimálne však po dobu trvania autorských alebo iných práv duševného vlastníctva k takémuto autorskému dielu, a to pre svoju potrebu v neobmedzenom územnom, vecnom alebo inom rozsahu pričom cena za licenciu je súčasťou ceny Predmetu kúpy. V rozsahu a za podmienok uvedených v predchádzajúcej vete udeľuje Predávajúci Kupujúcemu aj bezodplatnú sublicenciu na použitie autorského diela. Predávajúci súhlasí s tým, že vec (hmotný substrát) prostredníctvom ktorej je autorské dielo vyjadrené môže Objednávateľ bez ďalšieho upravovať, zmeniť, spájať alebo aj zničiť.
- Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o., Piešťanská 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom









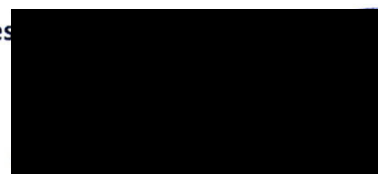

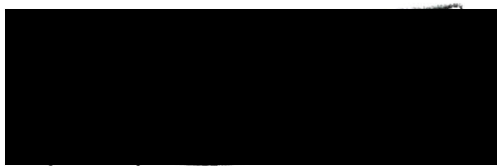


- 8.5 Zmluvné strany sa zaväzujú považovať skutočnosti alebo informácie, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s uzavretím alebo plnením Zmluvy (napr. obchodné tajomstvo, know-how, technické riešenia, dokumentácia), za dôverné a zaväzujú sa zachovávať mlčanlivosť o takýchto skutočnostiach alebo informáciách až do doby, kedy sa tieto stanú všeobecne známymi za predpokladu, že sa tak nestane porušením povinnosti mlčanlivosti. Takto získané informácie sa zaväzujú nezneužiť a nesprístupniť tretím osobám. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvy. V opačnom prípade zmluvná strana zodpovedá za škodu, ktorá vznikla porušením tejto povinnosti.
- 8.6 Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 8.7 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. Ak nedôjde k dohode o znení dodatku k zmluve, oprávňuje to obe strany, aby ktorákoľvek z nich požiadala súd o rozhodnutie.
- 8.8 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiadala o rozhodnutie súd.
- 8.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:
- Príloha č. 1: **Technická špecifikácia tovaru**
- 8.10 Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých kupujúci po podpise obdrží dve vyhotovenia a predávajúci jedno vyhotovenie.
- 8.11 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR podľa ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 8.12 Osoby, ktoré podpisujú Zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvnej strany a zaväzovať zmluvnú stranu svojím podpisom. Podpisujúce osoby sú si zároveň vedomé právnych následkov, ktoré nastanú, pokiaľ sa ich vyhlásenie podľa predchádzajúcej vety ukáže nepravdivým.
- 8.13 V prípade, že niektoré z ustanovení Zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.



8.14 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ňou, uzatvárajú ju slobodne, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nevýhodných podmienok, na znak čoho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

<p>Vo Vyšných Hágoch, dňa:</p> <p></p> <p>Kupujúci</p> <p></p> <p>Ing. Jozef Poráč, MPH generálny riaditeľ</p> <p></p> <p>Ing. Agáta Jenčová ekonomická riaditeľka</p>	<p>V Novom Meste nad Váhom, dňa: 25.03.2021</p> <p>Predávajúci</p> <p></p> <p></p> <p>Ing. Jaroslav Tonkovič konateľ</p> <p></p> <p>Ing. Margita Vernerová na základe splnomocnenia</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Príloha č.1

Monitor vitálnych funkcií : **GE Healthcare B125**

(EKG,NIBP,SpO2, 2x InvBP , respirácia, teplota)



Monitor vitálnych funkcií **GE Healthcare B125** je modulárny monitorovací systém (rozšírenie funkcií vložení modulov) s 12,1" TFT dotykovou farebnou obrazovkou . Napájanie zo siete 220V/50 Hz , alebo prevádzka na zabudovanom akumulátore(≥ 3 hod) .

Možnosť voľby ľubovoľnej konfigurácie 6-tich kriviek a 4 numerických polí a farebne ich rozlíšiť .

Možnosť pripojenia tlačiarne alebo zapisovača (opcia , možnosť dokúpiť , nie je súčasťou dodávky)

.Monitor má výstup pre pripojenie tlačiarne .Tlač reálnych kriviek , aktuálnych údajov , grafických a numerických trendov , tlač z pamäte udalostí . Ovláda sa pomocou otočného kolieska a priamo vyvedených kláves rýchlej voľby alebo touch screen .Obrazovka je konfigurovateľná užívateľom .

Grafické a numerické trendy všetkých monitorovaných parametrov od 20 min do 168 hodín s rozlíšením od 10 sec do 1 min .

Pamäť udalostí : pamäť pre 400 udalostí s možnosťou zachytenia reálnych kriviek o dĺžke 20 s .

Pamäť zahlásených alarmov : ALARM HISTORY

Trend kurzor : možnosť prezerania a tlače vo všetkých typoch trendov .

Monitor je dodávaný s nastavenými hodnotami alarmov .Alarmy sú aktívne i v prípade , že parameter nie je zobrazený na obrazovke do tej doby , pokiaľ príčina alarmu nie je odstránená .

Alarmové hranice sú prehľadne usporiadané v centrálnom poli alarmov .

EKG (3 , 5 alebo 12 zvodov - opcia)

zobrazenie EKG krivky , možnosť výberu zvodu I , II , III , aVR , aVL , aVF

zobrazenie EKG krivky , súčasne 3 kanály EKG 1 , EKG 2 , EKG 3

meranie srdcovej frekvencie HR

kontrola funkcie pacemakera

Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o., Piešťanská 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

tel./fax +421 32 7798 118, www.messer.sk



sledovanie ischémie myokardu
rýchlosť posuvu krivky 12,5 ; 25 ; 50 mm/s
rozsah merania srdcovej frekvencie 30 – 250 bpm
nastavitelné alarmové hranice

Monitor analyzuje zmeny ST segmentu kontinuálne

Numerické ST dáta sú zobrazené vpravo od druhej stopy EKG

Možnosť manuálneho nastavenia ST bodu

Zobrazenie ST QRS komplexu pre každý zvod

Grafický trend ST hodnot

rozsah merania – 9 až 9 mm

nastavitelné alarmové hranice

analýza arytmií – asystola , brady, tachy , ventikulárna fibrilácia , ventikulárna tachykardia

Monitor štandardne sleduje dýchanie

Na základe impedančnej respirácie z EKG .Zobrazuje respiračnú vlnu , a počet respirácií .Rozsah merania 4 – 120 dych/min .Nastavitelné alarmové hranice .

Pulzná oxymetria

Meranie hodnoty saturáci kyslíkom

Meranie pulzovej frekvencie HR

Zobrazenie pletyzmografickej krivky

Možnosť merania senzorom na prste ruky , nohy , na uchu , alebo u malých detí z dlane alebo chodidla

rozsah merania SpO2 40 – 100 %

rýchlosť posuvu krivky 12,5 ; 25 ; 50 mm/s

nastavitelné alarmové hranic

Meranie InvBP:

- 2 vstupy s možnosťou výberu linky invazívneho tlaku z ponúkaného menu (merania arteriálneho, intrakraniálneho (ICP), centrálného venózneho tlaku (CVP) , tlaku v pľúcnici ,....)
- Zobrazenie tlakovej krivky s nulovou a referenčnou úrovňou
- Rozsah merania - 40 až 320 mmHg (-5,3 až 42,7 kPa)
- Presnosť merania $\pm 5\%$ alebo ± 2 mmHg, podľa toho, čo je väčšie
- Frekvenčný rozsah 4-22 Hz
- Konvertor citlivosti 5 mV / V / mmHg
- Ľahká obsluha , nulovanie IBP vyvedené na funkčnú klávesu

Neinvazívny krvný tlak

Automatické meranie pre navolený intervalu od 1 min do 4 hodín. S manuálnym štartom . Kontinuálne meranie počas doby 5 minút

Venous Stasis = natlakovanie manžety na 80 a podržanie na dobu 2 min pri zavádzaní kanyly .

Nastavitelné alarmové hranice .


Merané hodnoty tlaku: systolický, stredný a Diastolický.

Meranie InvBP

- 2 vstupy s možnosťou výberu linky invazívneho tlaku z ponúkaného menu (merania arteriálneho, intrakraniálneho (ICP), centrálného venózneho tlaku (CVP) , tlaku v pľúcnici ,....)
- Zobrazenie tlakovej krivky s nulovou a referenčnou úrovňou
- Rozsah merania 40 až 320 mmHg (-5,3 až 42,7 kPa)
- Presnosť merania $\pm 5\%$ alebo ± 2 mmHg, podľa toho, čo je väčšie
- Frekvenčný rozsah 4-22 Hz
- Konvertor citlivosti 5 mV / V / mmHg
- Ľahká obsluha , nulovanie IBP vyvedené na funkčnú klávesu

Teplota

Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o., Piešťanská 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom





Teplota môže byť meraná z rôznych miest , podľa použitého senzoru / esofageálna , nasofaryngeálna , kožná , rektálna , teplota krvi , axilárna ,..../

Monitor má dva vstupy pre meranie teplôt

rozsah merania 10 – 45 °C


nastavitelné alarmové hranice

možnosť budúceho rozšírenia o meranie ET CO₂ , C.O. , entropia , dychové plyny , plné arytmie – 16 typov , plný pohľad na krivky , skóre včasného varovania

Spotrebný material :

M1210728	1 x 2017003-003, Multi-Link ECG Cable, 3/5-Lead Standard, IEC, 3.6 m/12 1 x 412682-003 , Multi-Link ECG Leadwire Set, 3-Lead, 29", grabbers, IEC 1 x 2020980-001, Air Hose, NIBP, Adult, Mated Submin, 3.6 m/12 ft 3 x DUR-P2-2A, DUR-A2-2A, DUR-A3-2A, child , Adult,largeAdult 2 TB 1 x TS-G3, TruSignal Interconnect cable 1 x TS-F-D, TruSignal finger sensor, reusable
2005772-001	Dual Invasive Pressure Adapter cable pre dva kusy monitorov
2016998-001	Teplotný predlžovací , 700/400 series, 0,5 m
M1024247	Teplotná sonda , 400 Series, reusable


Centrálny monitor GE Healthcare CSCS

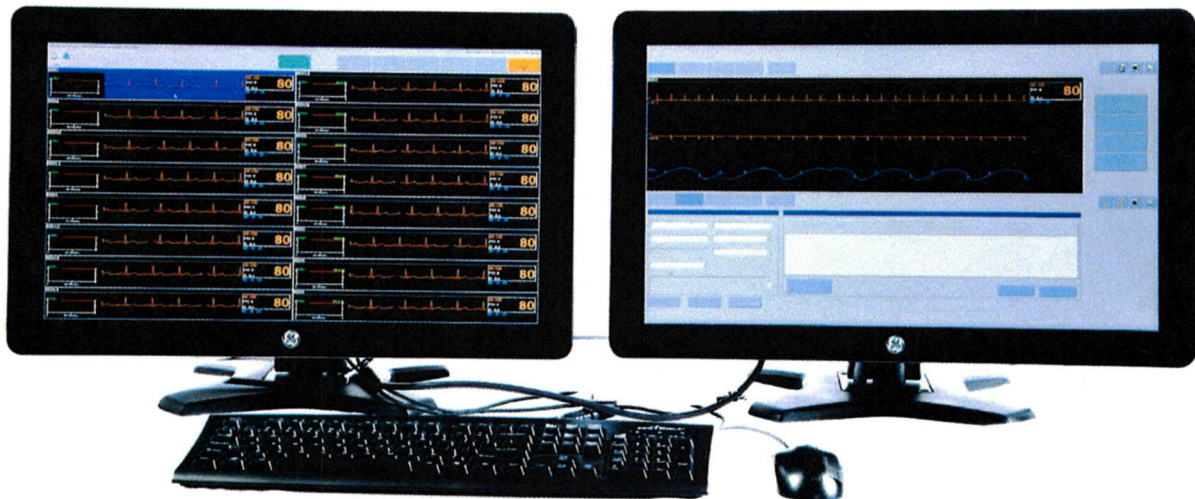

CARESCAPE Central Station je určená na použitie pod priamym dohľadom licencovaného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Určeným použitím je poskytovať klinickým lekárom údaje o dospelých, pediatrických a novorodeneckých pacientoch v rámci nemocničného alebo klinického prostredia. CARESCAPE Central Station je určená na zbieranie, zobrazovanie a tlač údajov zo siete, vrátane demografických údajov pacienta, fyziologických parametrov a kriviek, oznámení alarmu a/alebo iných nemedicínskych informácií z monitorov a telemetrických systémov. Medzi fyziologické parametre a krivky patrí elektrokardiograf

Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o., Piešťanská 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

tel./fax +421 32 7798 118, www.messer.sk






(EKG), pulzná oxymetria (SPO2), invazívne merania tlaku krvi (IBP), neinvazívne meranie tlaku krvi (NIBP), dýchanie (RR), ventilátor (VNT), oxid uhličitý (CO2), kyslík (O2), hmotnostná spektrometria (Gas), teplota (Temp) a bispektrálny index (BIS). Je možné zobrazit' informácie o pacientovi z lôžkových a telemetrických systémov týkajúce sa parametrov a kriviek pre jednotlivé údery. Nastavenia patientskeho monitora a telemetrického systému je možné upravovať. Hodnoty parametrov odvodené z údajov o pacientovi sa dajú vypočítať, zobrazit' a vytlačit'. CARESCAPE Central Station podporuje možnosť prístupu k informáciám o produktoch spoločnosti GE a k nemocničnému intranetu vo formáte internetového prehliadača. CARESCAPE Central Station podporuje aj možnosť prístupu k informáciám o pacientovi získaným zo siete CARESCAPE a uloženým na sieťovom serveri.

Primárnymi displejmi môže byť štandardný displej alebo displej s dotykovou obrazovkou. Primárny displej sa používa na zobrazenie zobrazovača okna viacerých patientskych zobrazení. Ak sa nepoužije sekundárny displej, okno viacerých patientskych zobrazení sa zobrazí v hornej polovici obrazovky a jednoduchý zobrazovač alebo jeden z nástrojov na posudzovanie údajov sa zobrazí v spodnej polovici obrazovky.

Okno viacerých patientskych zobrazení zobrazuje číselné hodnoty parametrov a krivky naraz až pre 16 pacientov. Na jedného pacienta je možné zobrazit' až štyri krivky. V prípade výberu okna viacerých patientskych zobrazení sa pozadie vysvieti namodro.

Centrálne jednotka dokáže prevziať a zobrazit' údaje o parametroch z monitorovacích zariadení pripojených do siete a sekundárnych monitorovacích zariadení prostredníctvom zariadenia rozhrania Unity Network ID. Ak centrálnu jednotku používate spolu s lôžkovými monitormi, nebude primárnym monitorovacím zariadením. Centrálne jednotka podporuje pomocou jedného alebo viacerých kompatibilných monitorovacích zariadení nasledujúce parametre

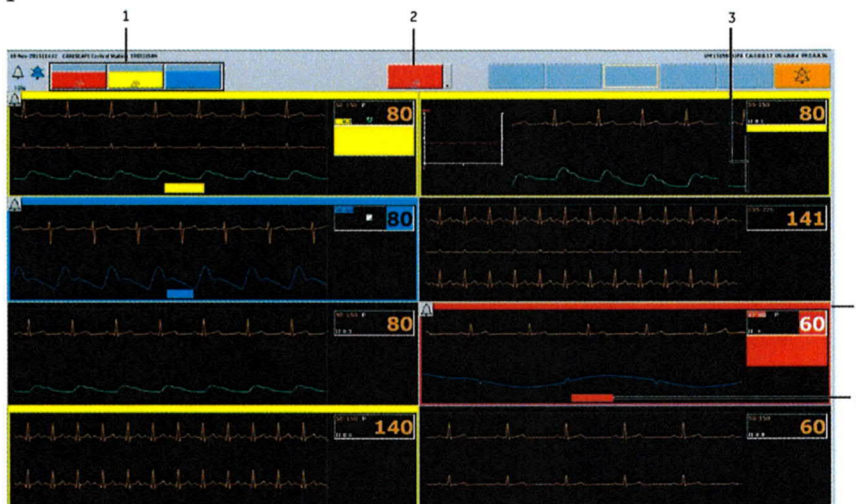

Centrála umožňuje:

- Prehľadné zobrazenie alarmových správ, podobne ako na lôžkových monitoroch
- Centrála umožňuje plný pohľad na prenesené krivky za posledných XX hodín (v závislosti od opcie) s možnosťou ich tlače a archivácie
- Nastavenie alarmov lokálne priamo z monitora , alebo z centrálného monitora .
- Prenos informácií z postele na posteľ (krivky, čísla a trendy) v rámci siete
- Umožnenie sledovanie patientskych údajov na vzdialenom pracovisku (doktorskej izbe)
- Spracovávanie údajov vo Windows , ukladanie na pamäťové médium
- Centrála laserová tlačiareň s možnosťou tlače na bežný A4 formát

Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o., Piešťanská 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

tel./fax +421 32 7798 118, www.messer.sk



Možnosti nastavenia rôznych konfiguračných stavov.

Centrálna stanica umožňuje úplný prístup k nastaveniam alarmov na prepojených lôžkových monitoroch.

Centrálna stanica umožňuje vyvolanie ľubovoľnej uchovanej udalosti vedúcej k aktivácii alarmu z prepojeného lôžka monitora.

Centrálna stanica umožňuje vyvolanie úplneho trendu z ľubovoľného prepojeného lôžkového monitora.

Centrálna stanica umožňuje meniť ľubovoľné údaje o pacientovi na prepojených lôžkových monitoroch.

Centrálna stanica umožňuje zadať nasledové údaje o novom pacientovi do prepojených lôžkových monitorov:

1. Meno pacienta
2. Identifikačné číslo pacienta
3. hmotnosť pacienta
4. Výška pacienta
5. Dátum narodenia
6. Pohlavie
7. Plocha tela sa vypočíta automaticky

Centrálna stanica umožňuje nastaviť rôzne priority alarmov na prepojených lôžkových monitoroch.

Centrálna stanica umožňuje konfiguráciu rôznych kriviek a parametrov na svojej obrazovke pre každý prepojený lôžkový monitor.

Centrálna stanica umožňuje v samostatnom okne zobrazovať každú dostupnú konfiguráciu obrazovky z prepojeného lôžkového monitora.

Centrálna stanica umožňuje klinikom diaľkový prístup ku každému lôžku.

Centrálna stanica umožňuje inštaláciu softwaru na báze operačného systému Windows, ktorý slúži na ďalšiu diagnostiku, napr. Holter-EKG, prehliadač rtg. snímkov a pod.

Centrálna stanica umožňuje používanie existujúcej nemocničnej siete LAN 100 Mbit/s.

Centrálna stanica môže fungovať ako brána do nemocničnej siete.



Monitor vitálnych funkcií	8 ks
- príslušenstvo pre uchytenie monitorov	8 ks
- veľkosť TFT farebnej obrazovky 30 cm	30 cm
prevádzka na elektrickú sieť akumulátor minimálne 180 minút	180 minút
- možnosť voľby ľubovoľnej konfigurácie kriviek a numerických polí a farebne ich odlišiť – počet súčasne zobrazených kriviek - min. 6	kriviek
- grafické a numerické trendy všetkých monitorovaných parametrov min. 148 hodín	168 hodín
modul ku monitoru na meranie fyziologických funkcií pacienta: EKG, respirácia, SpO2, teplota 2x, neinvazívny TK, meranie 2x invazívny TK – 8 ks	EKG, respirácia, SpO2, teplota 2x, neinvazívny TK, meranie 2x invazívny TK – 8 ks
- záručná doba 24 mesiacov	24 mesiacov
- užívateľom nastaviteľné hranice alarmov – manuálne a automaticky	áno
- EKG so zobrazením 3 a 5 zvodov – možnosť výberu zvodov I, II, III, aVR, aVL, aVF	áno
- zobrazenie EKG krivky	áno
- meranie srdcovej frekvencie HR, kontrola pacemakera, sledovanie ischémie myokardu	áno
- schopnosť analýzy ST segmentu, meranie ST elevácie a ST depresie a možnosťou zobraziť ST trendy	áno
- rozsah merania respirácie – 4 – 120 dychov za min.	áno
- SpO2: meranie pulzovej frekvencie HR, zobrazenie pletyzmografickej krivky	áno
- rozsah merania SpO2 1-100%	áno
- meranie neinvazívneho tlaku krvi – manuálny a automatický režim	áno
- IBP tlaky: možnosť merania tlakov. Arteriálny tlak, centrálny venózy tlak, tlak v pľúcnici, ICP – systolický, diastolický a stredný	áno
- rozsah merania: -40 až 320 mmHg	áno
- možnosť merania teploty z rôznych miest, podľa použitého senzora	áno
- možnosť budúceho rozšírenia o meranie CO2, OXYCRG, entropie alebo BIS, srdcového výdaja, dychové plyny CO2, O2, N2O, AA, Mac, MACage, balančného plynu, zobrazenie plných arytmií minimálne 19 typov, plný pohľad na krivky, skóre včasného varovania ktoré sa vypočíta podľa monitorovaných parametrov:	áno
<ul style="list-style-type: none"> • respiračnej frekvencie • SpO2 • vzduchu alebo kyslíku podávaného pacientovi • systolického krvného tlaku • nameraného počtu pulzov • stupňa vedomia pacienta • teploty pacienta 	áno
- možnosť tlače kriviek alarmov, číselných trendov a správ na kompatibilných sieťových zariadeniach objednávateľa, certifikovaných podľa IEC 60950 – laserové tlačiarne pripojené na LAN siete	áno
- odosielanie monitorovaných patientskych údajov a alarmov z monitora do PC na účely výskumu a prípravy školiacich materiálov – sw pre spracovanie týchto trendov a alarmov v excel súboroch	áno
- budúce meranie vdychovaného a vydychovaného CO2 s využitím už zakúpených modulov u obstarávateľa – so zobrazením : Fi a EtCO2, počtu dychov a kapnografickej krivky na obrazovke monitora	áno
- požadovaná kompatibilita s GE centrálnym monitorovacím systémom, požadovaná vzájomná zameniteľnosť monitorov so staršou inštaláčnou bázou	áno
	áno
Príslušenstvo: EKG káble, saturačný senzor, manžeta na meranie neinvazívneho tlaku 3 ks po 1 ks pre dieťa, 1 ks dospelý pacient, 1 ks manžeta pre nadmerného pacienta, 2 ks káble na meranie invazívnych tlakov, príslušenstvo pre meranie teploty	Kompletné príslušenstvo: sieťový kábel, EKG káble, saturačný senzor, manžety na meranie neinvazívneho tlaku rôznych veľkostí (3 ks po 1 ks pre dieťa, 1 ks dospelý pacient, 1 ks manžeta pre nadmerného pacienta,), káble na meranie invazívnych tlakov pre dva vstupy, príslušenstvo pre meranie teploty
- ovládanie v slovenskom alebo českom jazyku	áno
- vrátane záručného a pozáručného servisu	áno
- zariadenie nové, nepoužívané	áno
- všetky potrebné príslušenstvo	áno

Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o., Piešťanská 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom



Centrálna monitorovacia stanica	1 ks
- veľkosť LCD monitora 40 cm	áno
- možnosť spojenia monitorov vitálnych funkcií v počte 8 ks	áno
- sledovanie parametrov v reálnom čase, trendov a podpora pri prekladaní pacienta v rámci siete min. 72 hodín	áno
- vybavenie pre vzájomné prepojenie a komunikáciu s centrálnymi monitormi a monitormi vitálnych funkcií na iných oddeleniach	áno
- uchovanie kontinuálnych kriviek všetkých monitorovaných parametrov	áno
- možnosť nastavenia alarmov lokálne priamo z monitora, alebo z centrálného monitora	áno
- možnosť nastavenia rôznych konfiguračných stavov	áno
- umožnenie stanice k úplnému prístupu k nastaveniam alarmov na prepojených lôžkových monitoroch	áno
- možnosť zadania komplexných údajov o pacientovi (meno, identifikačné číslo, hmotnosť, výška, dátum narodenia, pohlavie)	áno
- možnosť nastavenia rôznych priorít alarmov na prepojených lôžkových monitoroch	áno
- možnosť tlače kriviek, kriviek alarmov, číselných trendov a správ na kompatibilných sieťových zariadeniach objednávateľa, certifikovaných podľa IEC 60950 – laserová tlačiareň pripojená na LAN sieť	áno
- opcia pre budúce zriadenie 2 externých klientskych sledovacích staníc so SW pre sledovanie monitorovaných údajov pacientov personálom na lekárskej izbe – kompatibilita s používanými monitormi iných oddelení pre vytvorenie databázy pacientov	áno
- podpora IKT štandardu HL7, možná kompatibilita s inými informačnými systémami	áno
- ovládanie v slovenskom alebo českom jazyku	áno
- vrátane dostupných aktualizácií softvéru	áno
- vrátane záručného a pozáručného servisu	áno
- zariadenie nové, nepoužívané	áno
- všetky aktualizácie sw v cene	áno
- záruka 24 mesiacov	áno