

**Kúpna zmluva a zmluva o poskytovaní údržby**  
uzavretá podľa § 409 a nasledujúcich v spojení s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.  
(Obchodného zákonníka) v znení neskorších právnych predpisov  
(ďalej len „zmluva“)

medzi

Názov: **Záchranná zdravotná služba Bratislava**  
štátna príspevková organizácia  
Sídlo: Antolská 11, 850 07 Bratislava  
IČO: 17 336 210  
DIČ: 2020845827  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK85 8180 0000 0070 0028 7955  
Štatutárny orgán: Ing. PhDr. Michal Kováčik, riaditeľ  
e-mail:  
tel. sekretariát:  
Kontaktná/oprávnená osoba: Michal Vido, vedúci oddelenia nákupu a logistiky liekov a ŠZM  
E- mail:  
Tel.:  
ďalej len „Kupujúci“)

a

Názov: MEDIS Nitra, spol. s r.o.  
Sídlo: Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra – Dražovce  
IČO: 36531774  
DIČ: 2020148152  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
IBAN: SK81 1100 0000 0026 2477 6463  
Štatutárny orgán: Karol Janovič, MBA, konateľ spoločnosti  
Zapísaný: Okresný súd v Nitre, odd.:Sro, vložka č. 11430/N, ako spoločnosť  
s ručením obmedzením  
e-mail:  
(ďalej len „Predávajúci“)

### Preambula

- 2.1. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky „Zdravotnícke technológie pre vozidlá ZZS“ vyhláseného Kupujúcim vo Vestníku verejného obstarávania č. 171/2021 zo dňa 27.07.2021 pod zn. 36182-MST, realizovaného v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), v ktorom bol Predávajúci na základe vyhodnotenie ponúk úspešným uchádzačom.
- 2.2. Predávajúci je v čase uzatvorenia tejto zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (Ak na strane predávajúceho ako Zmluvnej strany podieľa skupina dodávateľov podľa § 37 zákona č. 343/2015 Z. z., má každý člen tejto skupiny dodávateľov povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora).

### Článok III. Predmet zmluvy

- 3.1. Účelom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti s dodaním zariadení vymedzených v prílohe č. 1 zmluvy a zabezpečením údržby podľa pokynov stanovených výrobcom a príslušnými predpismi upravujúcimi požiadavky na prevádzku zariadení.
- 3.2. Touto zmluvou sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu
  - 3.2.1. Transportné defibrilátory pre mobilnú intenzívnu jednotku (MIJ) v počte 2 ks,
  - 3.2.2. Transportné defibrilátory pre rýchlu lekársku pomoc (RLP) v počte 6 ks,
  - 3.2.3. Ventilátor pre umelú pľúcnu ventiláciu pre RLP v počte 10 ks.
- 3.3. Podrobná špecifikácia zariadení podľa predchádzajúceho bodu vrátane zoznamu príslušenstva je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Predávajúci prehlasuje, že všetky zariadenia sú nové, nepoužívané a sú zabalené v originálnych obaloch.
- 3.4. Touto zmluvou sa ďalej Predávajúci zaväzuje poskytnúť Kupujúcemu
  - 3.4.1. **údržbu** zariadení podľa bodu 3.2 tejto zmluvy v rozsahu podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy,
  - 3.4.2. **dopravu** zariadení podľa bodu 3.2 tejto zmluvy do sídla Kupujúceho,
  - 3.4.3. **zaškolenie** cca. 15 zamestnancov na obsluhu zariadení podľa bodu 3.2 tejto zmluvy priamo na pracovisku Kupujúceho slovensky hovoriacim špecialistom v rozsahu min. 4 hod./zariadenie,
  - 3.4.4. **poskytovanie bezplatného záručného servisu** zariadení podľa bodu 3.2 tejto zmluvy,
- 3.5. Touto zmluvou sa Kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu zariadení podľa bodu 3.2 tejto zmluvy a cenu za služby údržby vo výške v zmysle článku V tejto zmluvy.

### Článok IV. Dodacie podmienky

- 4.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu zariadenia podľa bodu 3.2 tejto zmluvy vrátane služieb podľa bodu 3.4.3 najneskôr do 120 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
- 4.2. Miestom dodania zariadení podľa bodu 3.2 tejto zmluvy a poskytnutia služieb údržby je sídlo Kupujúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Predávajúci oznámi termín dodávky minimálne 3 pracovné dni pred plánovaným termínom dodania kontaktným osobám.
- 4.3. Odovzdanie a prebratie zariadení bude vykonané poverenými zástupcami Kupujúceho a Predávajúceho v mieste dodania predmetu zmluvy.
- 4.4. Kupujúci má právo pri preberaní prezrieť všetky zariadenia pre účely kontroly stavu a vady zariadení.
- 4.5. Pokiaľ je predmet dodávky v súlade s touto zmluvou a Predávajúci riadne vykonal činnosti podľa bodu 3.4.3, Kupujúci dodávku preberie a riadne dodanie potvrdí na preberacom protokole. Kupujúci má právo zariadenie neprebrať, ak nespĺňa niektorú z požiadaviek podľa tejto zmluvy, najmä ak má zariadenie vady. Kupujúci je v takom prípade povinný písomne oznámiť Predávajúcemu konkrétne dôvody neprebratia zariadenia, a to do dvoch pracovných dní.

- 4.6. V prípade situácie podľa bodu 4.5 tejto zmluvy je Predávajúci povinný bezodkladne, resp. v primeranej lehote určenej Predávajúcim, odstrániť všetky dôvody neprebratia zariadení.
- 4.7. Dokladmi nevyhnutnými k prebratiu a užívaniu zariadenia sa považujú:
- 4.7.1. záručný list,
  - 4.7.2. príslušná dokumentácia podľa platných predpisov,
  - 4.7.3. návod na obsluhu v slovenskom jazyku 1 x v písomnej podobe, 1 x na CD,
  - 4.7.4. zoznam príslušenstva a spotrebného materiálu k zariadeniu.

## **Článok V.**

### **Cena a platobné podmienky**

- 5.1. Cena je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena konečná v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 5.2. Kúpna cena zariadení a ceny údržby sú uvedené v prílohe č. 3 tejto zmluvy.
- 5.3. Kúpna cena zariadení zahŕňa aj náklady na činnosti podľa bodov 3.4.2 až 3.4.4 tejto zmluvy. Kúpna cena zahŕňa colné a daňové poplatky.
- 5.4. Ceny podľa tejto zmluvy sú stanovené ako najvyššie prípustné, neprekročiteľné a platné počas celého trvania tejto zmluvy v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch verejného obstarávania a zahŕňajú všetky náklady vrátane všetkých rizík a vplyvov (predovšetkým kurzových a inflačných) súvisiacich s plnením predmetu zmluvy.
- 5.5. Ceny je možné meniť iba pri zmene colných a daňových taríf podľa všeobecne záväzných predpisov a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, formou písomného a očíslovaného dodatku.
- 5.6. Kúpna cena zariadení bude Kupujúcim uhradená na bankový účet Predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy jednorazovo na základe Predávajúcim vystavenej faktúry. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa doručenia Kupujúcemu.
- 5.7. Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru po dodaní zariadení podľa bodu 3.2 a poskytnutí služieb podľa bodov 3.4.2 a 3.4.3 tejto zmluvy alebo príslušenstva a ich riadnom prebratí Kupujúcim.
- 5.8. Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru za údržbu raz za rok, a to za všetky činnosti v rámci údržby vykonané za predchádzajúci rok od predchádzajúcej fakturácie za údržbu.
- 5.9. Predávajúci je oprávnený vystavovať faktúry do 10 pracovných dní odo dňa dodania zariadení podľa bodu 3.2, alebo vykonania údržby, najneskôr však do piateho (5.) pracovného dňa mesiaca, nasledujúceho po mesiaci v ktorom boli zariadenia dodané alebo vykonaná údržba.
- 5.10. Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci vystaví faktúru v elektronickej forme a zašle vo forme .pdf na e-mail Kupujúceho: Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že faktúra v elektronickej podobe je plnohodnotnou náhradou faktúry v papierovej forme. Povinnou prílohou faktúry podľa bodu 5.7 tejto zmluvy je preberací protokol.
- 5.11. Ak faktúra nie je vystavená v súlade s právnymi predpismi alebo v súlade s touto Zmluvou, je Kupujúci oprávnený ju v lehote splatnosti vrátiť Predávajúcemu na prepracovanie. Tým

prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť doručením opravenej faktúry Kupujúcemu.

- 5.12. Zaplatením kúpnej ceny zariadení prechádza na Kupujúceho vlastnícke právo na dodané zariadenia.
- 5.13. V prípade, ak sa preukáže po uzatvorení tejto zmluvy, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej aj „nižšia cena“) za rovnaký alebo porovnateľný tovar a služby, ako je uvedené v tejto zmluve a predávajúci aj reálne za takúto nižšiu cenu za tovar a služby už poskytol alebo stále poskytuje, ktorá je nižšia o viac ako 5 % ako cena predávajúceho podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa predávajúci poskytnúť kupujúcemu pre takýto dodaný tovar a služby po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.

## **Článok VI.**

### **Záruka a zodpovednosť za vady**

- 6.1. Na zariadenia podľa bodu 3.2 tejto zmluvy Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku v trvaní 24 mesiacov. Na príslušenstvo zariadení podľa bodu 3.2 tejto zmluvy Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku v trvaní 6 mesiacov s výnimkou spotrebného materiálu. Záruky podľa prvej a druhej vety začínajú plynúť odo dňa podpisu preberacieho protokolu.
- 6.2. Zárukou Predávajúci preberá záväzok, že dodané zariadenia budú počas záručnej doby spôsobilé na použitie na obvyklý účel a že si zachovávajú dohodnuté a obvyklé vlastnosti.
- 6.3. Zodpovednosť Predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka, nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na zariadení vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s pomocou ktorých predávajúci plnil svoj záväzok.
- 6.4. Ak sa na zariadení vyskytne počas záručnej doby vada, za ktorú zodpovedá Predávajúci, zaväzuje sa Predávajúci túto vadu bezplatne odstrániť.
- 6.5. Kupujúci je povinný reklamovať u Predávajúceho vznik vady zariadenia bez zbytočného odkladu, po tom, čo Kupujúci vady zistil. Kupujúci nahlási reklamáciu emailom na adresu
- 6.6. Počas záručnej doby je Predávajúci povinný prijať zariadenie na servis a začať s odstraňovaním vady do 24 hodín v pracovných dňoch.
- 6.7. Predávajúci je počas záručnej doby povinný odstrániť nahlásené vady do 15 pracovných dní od prijatia zariadenia. Predávajúci nie je v omeškaní v zmysle predchádzajúcej vety ak Kupujúcemu do momentu odstránenia vady bezplatne zapožičia náhradné zariadenie. Odstránením vady sa rozumie podpísanie servisného výkazu, ak je vada riadne odstránená. V prípade, že servisný výkaz Kupujúci nepodpíše pre prekážky na jeho strane, napriek tomu, že vada bola odstránená, má sa za to, že termín odstránenia vady je dodržaný. Túto skutočnosť Predávajúci zaznamená do servisného záznamu spolu s poznámkou o povahe prekážky, pre ktorú nebol servisný záznam podpísaný zo strany Kupujúceho.
- 6.8. Predávajúci je povinný o reklamácií vyhotoviť záznam, ktorého obsahom bude predovšetkým uvedenie dátumu reklamácie, charakter reklamovanej vady, spôsob vybavenia reklamácie, lehota vybavenia reklamácie, podpisy zodpovedných pracovníkov zmluvných strán.

- 6.9. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba neplynie v období od prijatia zariadenia na servis do odstránenia vady Predávajúcim, no iba v prípade, ak sa na vadu skutočne vzťahujú záručné podmienky.

## **Článok VII. Podmienky údržby**

- 7.1. Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje zabezpečiť údržbu zariadení podľa bodu 3.2 tejto zmluvy v súlade s podmienkami podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy. Druh a rozsah údržby podľa tejto zmluvy je uvedený v prílohe č. 2 tejto zmluvy.
- 7.2. Predávajúci sa zaväzuje poskytovať údržbu podľa tejto zmluvy v súlade s platnými predpismi, technickými normami a pokynmi výrobcu. Údržba musí byť poskytovaná s náležitou odbornou starostlivosťou, v súlade s najnovšími znalosťami, ktoré pre dané zariadenie výrobca poskytuje.

## **Článok VIII. Zmluvné pokuty a zodpovednosť za škody**

- 8.1. V prípade, že Predávajúci je v omeškaní so splnením povinnosti podľa 4.1 tejto zmluvy, Kupujúci je oprávnený požadovať od Predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200 eur za každý aj začatý deň omeškania.
- 8.2. V prípade, že Predávajúci je v omeškaní so splnením povinnosti podľa 6.7 tejto zmluvy a Kupujúcemu nezapožičal náhradné zariadenie je Kupujúci oprávnený požadovať od Predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 30 eur za každý aj začatý deň, počas ktorého bol Predávajúci v omeškaní a počas ktorého nebolo zapožičané náhradné zariadenie.
- 8.3. V prípade, že Predávajúci je v omeškaní s údržbou v zmysle plánu údržby je Kupujúci oprávnený požadovať od Predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 30 eur za každý aj začatý deň omeškania, a to za každé jedno zariadenie.
- 8.4. V prípade, že Predávajúci je v omeškaní so splnením povinností podľa bodu 9 prílohy č. 2 tejto zmluvy je Kupujúci oprávnený požadovať od Predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 30 eur za každý aj začatý deň omeškania, a to za každé jedno zariadenie.
- 8.5. V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou splatnej faktúry je Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho úroky z omeškania v sadzbe podľa § 369a Obchodného zákonníka.
- 8.6. Predávajúci sa zaväzuje, že pohľadávku voči Kupujúcemu, ktorá mu, ako veriteľovi vznikne z tohto zmluvného vzťahu, nepostúpi podľa § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho, ako dlžníka. Postúpenie pohľadávky Predávajúcim bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho je neplatné podľa § 39 Občianskeho zákonníka. Súhlas Kupujúceho je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas jeho zriaďovateľa (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky).
- 8.7. Úhradou zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Kupujúceho na náhradu škody podľa platných právnych predpisov, o ktorú vzniknutá škoda presahuje dohodnutú zmluvnú pokutu.
- 8.8. Zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením povinností podľa tejto zmluvy sa riadi § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

- 8.9. Zmluvné strany sa zaväzujú upozorniť druhú zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu na akékoľvek vzniknuté okolnosti brániace riadnemu a včasnému plneniu predmetu zmluvy alebo vylučujúce zodpovednosť.

#### **Článok IX.**

##### **Ochrana a zabezpečenie dôverných informácií**

- 9.1. Každá zmluvná strana povinná uchovávať a zabezpečovať dôvernoscť akýchkoľvek informácií označených za dôverné a nebude takéto informácie sprístupňovať tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany a ani ich využívať iným spôsobom, ako na naplnenie účelu tejto Kúpnej zmluvy.

#### **Článok X.**

##### **Subdodávateľa**

- 10.1. Predávajúci je oprávnený realizovať predmet tejto zmluvy prostredníctvom subdodávateľov. Zoznam subdodávateľov je prílohou č. 4 tejto zmluvy.
- 10.2. Predávajúci je povinný Kupujúcemu oznámiť akúkoľvek zmenu údajov u subdodávateľov uvedených v prílohe č. 4, a to bezodkladne.
- 10.3. V prípade zmeny subdodávateľa je Predávajúci povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa zmeny subdodávateľa predložiť Kupujúcemu informácie o novom subdodávateľovi, pričom pri výbere subdodávateľa musí Predávajúci postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene.
- 10.4. Subdodávateľ, ktorý má podľa § 11 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 10.5. Predávajúci zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizoval on sám.

#### **Článok XI.**

##### **Trvanie a skončenie zmluvy**

- 11.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do splnenia všetkých záväzkov zmluvných strán a do vzájomného vysporiadania pohľadávok vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné skončiť:
- 11.2.1. písomnou dohodou Zmluvných strán alebo
  - 11.2.2. odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy druhou zmluvnou stranou.
  - 11.2.3. Písomnou výpoveďou zo strany Kupujúceho kedykoľvek po dodaní zariadení podľa bodu 3.2 tejto zmluvy a poskytnutí činností podľa bodu 3.4.3, a to aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná doba je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená Predávajúcemu.
- 11.3. Podstatným porušením zmluvy je:

- 11.3.1. omeškanie Predávajúceho s dodaním zariadení podľa bodu 3.2 tejto zmluvy a poskytnutím činností podľa bodu 3.4.3 o viac ako 30 dní s výnimkou dôvodov vyššej moci;
  - 11.3.2. fakturovanie kúpnej ceny v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve;
  - 11.3.3. dodanie predmetu zmluvy s horšími parametrami, ako uvedenými v tejto zmluve;
  - 11.3.4. porušenie pravidiel ohľadom subdodávateľov a ich nesplnenie ani v primeranej lehote určenej Kupujúcim;
  - 11.3.5. ak voči Predáváčemu začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia;
  - 11.3.6. ak Predávajúci vstúpil do likvidácie;
  - 11.3.7. omeškanie Kupujúceho so zaplatením faktúry o viac ako 60 dní po lehote jej splatnosti;
- 11.4. Odstúpenie od zmluvy sa vykoná písomným oznámením odstupujúcej Zmluvnej strany adresovaným druhej Zmluvnej strane. Oznámenie musí obsahovať dôvody odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie je účinné okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
- 11.5. Odstúpiť od zmluvy je možné aj z dôvodov uvedených v § 19 zákona o verejnom obstarávaní a § 15 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 11.6. Odstúpenie od zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
- 11.7. Pre účely tejto zmluvy sa vyššou mocou rozumejú udalosti nezávislé od vôle a konania Zmluvných strán, ktoré nemôžu Zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť. Ide napr. o vojnu, všeobecnú mobilizáciu, povstanie, živelné pohromy, embargá, karantény. Účinky vyššej moci trvajú po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však tri mesiace. Kupujúci po uplynutí tejto doby môže uznať ďalšie trvanie účinkov vyššej moci.

## **Článok XII.**

### **Spoločné a záverečné ustanovenia**

- 12.1. Ak niektoré okolnosti nie sú touto zmluvou upravené, riadia sa podmienkami stanovenými v súťažných podkladoch. V ostatných záležitostiach, bližšie neupravených v tejto zmluve, ani súťažných podkladoch, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 12.2. Predávajúci je pri vykonávaní činností podľa tejto zmluvy povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy a hygienické predpisy.
- 12.3. Zmluvné strany sú povinné vyvíjať všetko úsilie k vytvoreniu potrebných podmienok pre realizáciu predmetu zmluvy v súlade s pravidlami poctivého obchodného styku.
- 12.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa budú snažiť riešiť všetky spory, ktoré prípadne vyplynú z výkladu a realizácie tejto zmluvy zmierom. Ak nebude zmierlivé riešenie sporu možné, budú riešené podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky. Táto zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky.
- 12.5. Všetky podania a iné oznámenia, ktoré sa doručujú zmluvným stranám, je potrebné doručiť osobne, alebo doporučenou listovou zásielkou, alebo elektronickou poštou.
- 12.6. Ku dňu podpisu tejto zmluvy je:
- 12.6.1. adresou pre doručovanie Kupujúcemu:  
Záchranná zdravotná služba Bratislava  
Antolská 11, 850 07 Bratislava


e-mail:

12.6.2. adresou pre doručovanie Predávajúcemu:  
MEDIS Nitra, spol. s.r.o  
Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra - Dražovce  
e-mail:


- 12.7. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy pre zmluvné strany prechádzajú v celom rozsahu na prípadných právnych nástupcov všetkých zmluvných strán.
- 12.8. Túto zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, a to vo forme písomných očíslovaných dodatkov k zmluve.
- 12.9. Žiadna zmluvná strana nie je oprávnená postúpiť tretej osobe pohľadávku, ktorá jej na základe tejto zmluvy vznikla, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Konanie v rozpore s dohodou podľa predchádzajúcej vety je v zmysle ustanovenia § 525 ods. 2 Občianskeho zákonníka absolútne neplatným právnym úkonom.
- 12.10. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva predstavuje slobodný a vážny prejav ich vôle, je pre ne určitá a zrozumiteľná, neuzatvorená v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.
- 12.11. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Kupujúci obdrží dve vyhotovenia a Predávajúci jedno vyhotovenie.
- 12.12. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 12.13. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:  
Príloha č. 1 - Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy  
Príloha č. 2 - Údržba  
Príloha č. 3 - Ceny  
Príloha č. 4 - Zoznam subdodávateľov

V Bratislave, dňa 30-09-2021

Kup

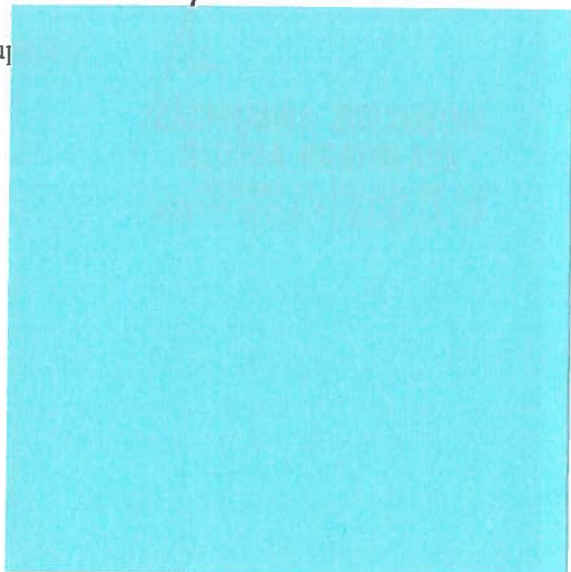

V Nitre, dňa 13.09.2021

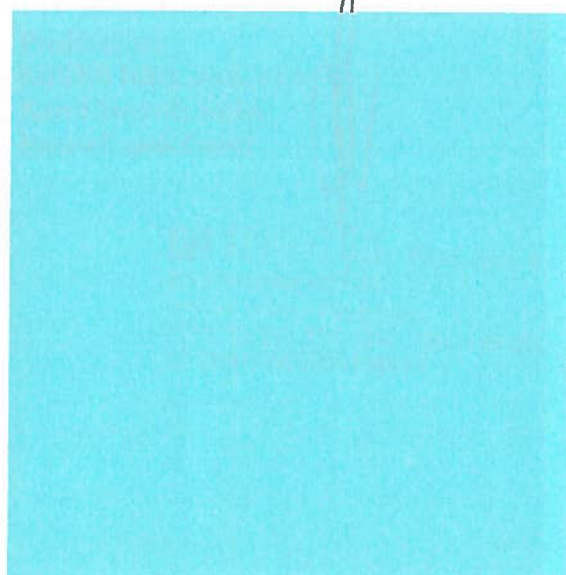



Príloha č. 2 - Podrobná špecifikácia zariadenia: Transportný defibrilátor pre RLP

| Názov zariadenia                                                                                                                              | model corpus c3 SLIM<br>výrobca GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH Nemecko                                                                                    | hodnota<br>parametra<br>ponuknutého<br>zariadenia |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| a) transportný defibrilátor<br>s možnosťou automatickej alebo<br>poloautomatickej externej<br>defibrilácie a s možnosťou<br>defibrilácie detí | Blízaký konvenčný defibrilátor s monitorovaním vitálnych funkcií s možnosťou využitia režimu AED. Textová a hlasová navigácia v režime AED musí byť v slovenskom jazyku. | áno                                               |
|                                                                                                                                               | Defibrilácia pomocou bezpečnostných lopatiek alebo jednorazových elektród pre všetky vekové skupiny s prepájacím káblom min 1m dĺžka                                     | áno                                               |
|                                                                                                                                               | S možnosťou 12 simultánnych zvodov pri meraní EKG                                                                                                                        | áno                                               |
|                                                                                                                                               | So zobrazením a tlačou 12- zvodového záznamu EKG krivky pacienta                                                                                                         | áno                                               |
|                                                                                                                                               | S možnosťou pripojenia do elektrickej siete v ambulantnej časti vozidla alebo priebežného dobíjania batérií v ambulancii ZZS                                             | áno                                               |
|                                                                                                                                               | Nabíjacia konzola vo vozidle 12V                                                                                                                                         | áno                                               |
|                                                                                                                                               | Napájanie zo sieťového zdroja 230 V AC                                                                                                                                   | áno                                               |
|                                                                                                                                               | S možnosťou externej kardiostimulácie                                                                                                                                    | áno                                               |
|                                                                                                                                               | Meranie saturácie kyslíkom SPO2 so snímačmi pre všetky vekové a hmotnostné skupiny                                                                                       | áno                                               |
|                                                                                                                                               | Neinvasívny tlak krvi (NIBP) s manžetami pre všetky vekové a hmotnostné skupiny, s možnosťou priebežného sledovania tlaku krvi                                           | áno                                               |
|                                                                                                                                               | Ponuka predkonfigurovaného zobrazenia displeja                                                                                                                           | áno                                               |
|                                                                                                                                               | Pamäťové úložisko na archiváciu údajov                                                                                                                                   | CF karta                                          |
|                                                                                                                                               | Automatické meranie impedance pri použití defibrilačných elektród                                                                                                        | áno                                               |
|                                                                                                                                               | Počet výbojov na jednu nabitú batériu min. 200                                                                                                                           | áno                                               |
|                                                                                                                                               | Menu prístroja musí byť v slovenskom jazyku                                                                                                                              | 200                                               |
|                                                                                                                                               | Výboj v rozsahu min. 2 až max. 200 J                                                                                                                                     | 2-200 J                                           |
|                                                                                                                                               | Funkcia metronómu pri KPR s možnosťou vypnutia                                                                                                                           | áno                                               |
|                                                                                                                                               | Modulárny systém prístroja s oddelením zobrazovacej jednotky od defibrilačnej jednotky                                                                                   | áno                                               |
|                                                                                                                                               | Monitorovanie etCO2 so zobrazením kapnografickej krivky na monitore                                                                                                      | áno                                               |
|                                                                                                                                               | Podsvietený LCD displej                                                                                                                                                  | áno                                               |
|                                                                                                                                               | Telemetrický prenos dát zabudovaný GSM modul/modem                                                                                                                       | áno                                               |
|                                                                                                                                               | Možnosť prenosu dát Bluetooth alebo WIFI                                                                                                                                 | áno                                               |
|                                                                                                                                               | Tlačiareň 3 stôp súčasne                                                                                                                                                 | áno                                               |
|                                                                                                                                               | Užívateľom konfigurovateľné rozloženie parametrov a kriviek na displeji                                                                                                  | áno                                               |
|                                                                                                                                               | Počítačovo riadený batériový manažment automaticky zabezpečujúci pravidelné vybíjanie a nabíjanie                                                                        | áno                                               |
|                                                                                                                                               | Nárazu odolný prístroj s certifikátom. Odolnosť voči vode a prachu IP 55                                                                                                 | IP 55                                             |
|                                                                                                                                               | Hmotnosť samotnej defibrilačnej jednotky max. 4 kg (vrátane batérií)                                                                                                     | 2,3 kg                                            |
|                                                                                                                                               | Hmotnosť celého prístroja bez príslušenstva max. 8 kg (vrátane batérií)                                                                                                  | 5,0 kg                                            |
|                                                                                                                                               | Homologovaný uchyt na stenu ambulancie ZZS 1x                                                                                                                            | áno                                               |
|                                                                                                                                               | Ochranná brašna chrániaca prístroj a zároveň slúžiaca na uskladnenie príslušenstva                                                                                       | áno                                               |

príloha č. 1 KZ

| Príloha č. 2 - Podrobná špecifikácia prístroja na umelú pľúcnu ventiláciu (Ventilátor) pre RLP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Názov zariadenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>model MEDUMAT Standard2</p> <p>výrobca WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG Nemecko</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Názov položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Požadovaný technický parameter                                                                            | hodnota parametra ponúknutého zariadenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>automatický dýchací prístroj určený pre všetky vakové skupiny vrátane detí (s výnimkou novorodencov a extrémne nezrelých novorodencov transportovaných v inkubátore) s programom na riadenie, podporné dýchanie, s možnosťou nastavenia pozitívneho tlaku na konci výdychu a režimom na ventiláciu so stálym pozitívnym tlakom v dýchacích cestách (CPAP), CPR, IPPV (Opätrenie MZ SR 07648/2019-OL; výnos MZ SR 10548/2009-OL)</p> | 1                                                                                                         | 5 integrovaným ventilom na regulovanie pozitívneho tlaku na konci výdychu (PEEP) s možnosťou nastavenia v minimálnom rozsahu 0 – 20 cmH2O                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                                                                                         | S možnosťou regulovania frakcie inšpirovaného kyslíka (FiO2) a monitorovania tlaku v dýchacích cestách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                         | Časovo cyklická, objemovo kontrolovaná a tlakovo kontrolovaná ventilácia s možnosťou nastavenia parametrov ventilácie                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                         | Podporné ventilačné režimy: minimálne SIMV, režim na ventiláciu na dvoch tlakových úrovniach (BIPAP) a režim na ventiláciu so stálym pozitívnym tlakom v dýchacích cestách (CPAP), CPR, IPPV                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                                                                                         | Pneumatický riadený                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                                                                                                         | Dýchový ťdai objem (Vt) minimálne 50 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7                                                                                                         | Minútový ventilálny objem v minimálnom rozsahu 3 - 20 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8                                                                                                         | Frekvencia objemovej ventilácie v minimálnom rozsahu 5 - 50 dychov/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9                                                                                                         | Nastaviteľný pomer inšpiria k Expiriu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10                                                                                                        | Nastavenie parametrov na prístroji musí byť priamo viditeľné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11                                                                                                        | Zobrazenie tlaku v dýchacích cestách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12                                                                                                        | Alarmy minimálne: <ul style="list-style-type: none"> <li>Nízky napájací tlak a oxygen supply</li> <li>Vysoký tlak dýchacích ciest</li> <li>Nízky tlak dýchacích ciest</li> <li>Nízky stav batérie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13                                                                                                        | Napájanie: <ul style="list-style-type: none"> <li>Napájanie musí byť umožnené stlačeným medicínskym kyslíkom (O2), alebo medicínskym vzduchom</li> <li>Napájací tlak musí byť v rozsahu od 2,7 do 6 barov/ 40 do 88 psi</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16                                                                                                        | Potrebné súčasti prístroja: <ul style="list-style-type: none"> <li>Ventilátor - základný prístroj</li> <li>Pacientský dýchací systém pre opakovateľné použitie (obsahuje kompletný systém potrebný pre použitie prístroja)</li> <li>Testovacie pľúčka (vak)</li> <li>Nosný systém pre uchytenie ventilátora, napájacej fľaše a ich súčastí (ak je súčasťou prístroja)</li> <li>Systém na uchytenie na nosníka</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17                                                                                                        | Pacientský dýchací systém (ventilačný okruh) na opakované použitie, sterilizovateľný autoklávom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18                                                                                                        | Homologovaný úchyt na stenu ambulancie ZZS, s možnosťou pripojenia do elektrickej siete v ambulancnej časti vozidla a priebežného dobíjania batérií v ambulancii ZZS                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19                                                                                                        | Braňa na prenos a ochranu prístroja aj na uskladnenie príslušenstva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20                                                                                                        | Menu prístroja musí byť v slovenskom jazyku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21                                                                                                        | Vstavaná batéria v prístroji s prevádzkovým časom min. 8 hodín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22                                                                                                        | Monitorované parametre: pPeak, pPiat, pMean                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23                                                                                                        | Užívateľom konfigurovateľné rozloženie parametrov na displeji s možnosťou prednastavenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24                                                                                                        | Súčasťou prístroja je systém na uchytenie prístroja k stretcheru alebo nosidlám                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25                                                                                                        | História udalostí - pamäťové médium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26                                                                                                        | Maximálna hmotnosť 4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 27                                                                                                        | Prístroj musí umožňovať v urgentných situáciách manuálne riadenie ventilácie a spustenie dychu spúšťacom umiestneným blízko pacienta s plynulým prechodom do riadenej ventilácie                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28                                                                                                        | Transportný a upevňovací systém homologizovaný držiak do vozidla s možnosťou napájania a dobíjania batérií prístroja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

12. Zmluvné strany sa dohodli, že odstránenie porúch a väd, na ktoré sa nevzťahuje záruka alebo väd vzniknutých po uplynutí záručnej doby sa bude realizovať na základe osobitných objednávok Kupujúceho.
13. V súvislosti s riešením väd podľa predchádzajúceho bodu je Predávajúci povinný vykonať kontrolu/diagnostiku zariadenia za účelom podrobného špecifikovania rozsahu opravy a potrebných náhradných dielov a vyhotoviť cenovú kalkuláciu opravy a potrebných náhradných dielov, a to do 10 dní od prijatia zariadenia.
14. Ak Predávajúci v rámci údržby zistí poruchu alebo vadu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (alebo záruka už uplynula), bezodkladne zašle Kupujúcemu odporúčania na vykonanie opravy poruchy alebo vady zariadenia zistenej počas údržby spolu s cenovou kalkuláciou opravy.
15. Predávajúci sa zaväzuje odstrániť poruchy alebo vady, na ktoré sa nevzťahuje záruka alebo poruchy alebo vady vzniknuté po uplynutí záručnej doby, do 30 pracovných dní od doručenia objednávky. V závislosti od povahy vady, dostupnosti náhradných dielov alebo aktuálnych prevádzkových potrieb Kupujúceho sa zmluvné strany môžu dohodnúť na inej lehote odstránenia vady, prípadne na zapožičaní náhradného zariadenia.
16. Predávajúci je povinný počas celého trvania zmluvy viesť záznamy o údržbe a prevedených servisných prácach.

## Príloha č. 3 zmluvy – Ceny

| Cenník zariadení |                                                                |       |                  |                            |                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------|-------|------------------|----------------------------|--------------------------|
| č. p.            | položka                                                        | počet | JC v eur bez DPH | Celková cena v eur bez DPH | Celková cena v eur s DPH |
| 1                | Transportný defibrilátor pre mobilnú intenzívnu jednotku (MIJ) | 2     | 21 929,00        | 43 858,00                  | 52 629,60                |
| 2                | Transportný defibrilátor pre rýchlu lekársku pomoc (RLP)       | 6     | 19 034,00        | 114 204,00                 | 137 044,80               |
| 3                | Ventilátor pre umelú pľúcnu ventiláciu pre RLP                 | 10    | 14 237,00        | 142 370,00                 | 170 844,00               |

| Cenník údržby - Transportný defibrilátor pre mobilnú intenzívnu jednotku (MIJ) |                                                                                                                         |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| názov položky                                                                  | Popis úkonov (predpísaných výrobcom)                                                                                    | Cena v eur bez DPH/zariadenie |
| Údržba 1. rok                                                                  | kompletná funkčná kontrola, kompletná technická kontrola, test funkčnosti, vystavenie Test reportu o vykonaných testoch | 630,00                        |
| Údržba 2. rok                                                                  | kompletná funkčná kontrola, kompletná technická kontrola, test funkčnosti, vystavenie Test reportu o vykonaných testoch | 630,00                        |
| Údržba 3. rok                                                                  | kompletná funkčná kontrola, kompletná technická kontrola, test funkčnosti, vystavenie Test reportu o vykonaných testoch | 630,00                        |
| Údržba 4. rok                                                                  | kompletná funkčná kontrola, kompletná technická kontrola, test funkčnosti, vystavenie Test reportu o vykonaných testoch | 630,00                        |

| Cenník údržby - Transportný defibrilátor pre rýchlu lekársku pomoc (RLP) |                                                                                                                         |                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| názov položky                                                            | Popis úkonov (predpísaných výrobcom)                                                                                    | Cena v eur bez DPH/zariadenie |
| Údržba 1. rok                                                            | kompletná funkčná kontrola, kompletná technická kontrola, test funkčnosti, vystavenie Test reportu o vykonaných testoch | 630,00                        |
| Údržba 2. rok                                                            | kompletná funkčná kontrola, kompletná technická kontrola, test funkčnosti, vystavenie Test reportu o vykonaných testoch | 630,00                        |
| Údržba 3. rok                                                            | kompletná funkčná kontrola, kompletná technická kontrola, test funkčnosti, vystavenie Test reportu o vykonaných testoch | 630,00                        |
| Údržba 4. rok                                                            | kompletná funkčná kontrola, kompletná technická kontrola, test funkčnosti, vystavenie Test reportu o vykonaných testoch | 630,00                        |

| Cenník údržby - Ventilátor pre umelú pľúcnu ventiláciu pre RLP |                                                                                                                                                                              |                               |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| názov položky                                                  | Popis úkonov (predpísaných výrobcom)                                                                                                                                         | Cena v eur bez DPH/zariadenie |
| Údržba 1. rok                                                  | kompletná funkčná kontrola, kompletná technická kontrola, výmena predpísaných setov podľa odporúčenia výrobcu, test funkčnosti, vystavenie Test reportu o vykonaných testoch | 390,00                        |
| Údržba 2. rok                                                  | kompletná funkčná kontrola, kompletná technická kontrola, výmena predpísaných setov podľa odporúčenia výrobcu, test funkčnosti, vystavenie Test reportu o vykonaných testoch | 390,00                        |
| Údržba 3. rok                                                  | kompletná funkčná kontrola, kompletná technická kontrola, výmena predpísaných setov podľa odporúčenia výrobcu, test funkčnosti, vystavenie Test reportu o vykonaných testoch | 390,00                        |
| Údržba 4. rok                                                  | kompletná funkčná kontrola, kompletná technická kontrola, výmena predpísaných setov podľa odporúčenia výrobcu, test funkčnosti, vystavenie Test reportu o vykonaných testoch | 390,00                        |

1

**Príloha č. 4 zmluvy – Zoznam subdodávateľov**

**Vyplní uchádzač**

| <b>Por. číslo</b> | <b>Označenie subdodávateľa (obchodné meno, IČO, sídlo)</b> | <b>Osoba/osoby oprávnené konať v mene subdodávateľa (meno a priezvisko)</b> | <b>Bydlisko osoby oprávnenej konať v mene subdodávateľa</b> | <b>Dátum narodenia osoby oprávnenej konať v mene subdodávateľa</b> |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1.                | -                                                          | -                                                                           | -                                                           | -                                                                  |
| 2.                |                                                            |                                                                             |                                                             |                                                                    |
| 3.                |                                                            |                                                                             |                                                             |                                                                    |

